



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 781

Data 03/05/2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARMED S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL MODULO A FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO PER INIEZIONE INTRAVITREALE "TOUL OPERIO" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA.**

## IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARMED S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL MODULO A FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO PER INIEZIONE INTRAVITREALE "TOUL OPERIO" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA.

**PRESO ATTO** della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

**PREMESSO** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1419 del 10/11/2020, è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di prodotti infungibili ed esclusivi ex art. 57, comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006;

**PRESO ATTO** che:

- in data 18/12/2023, il Direttore della U.O.C. di Oculistica del P.O. di Pescara, Prof. Michele Marullo, ha redatto e trasmesso presso l'apposita Commissione di valutazione, una richiesta inerente l'approvvigionamento di membrane sterili monouso dotate di filtro EPA H14 dedicate al modulo a flusso laminare focalizzato per iniezione intravitale *TOUL OPERIO* di proprietà di codesta Azienda (n. inv. 94213);
- le membrane sterili monouso con protezioni laterali distribuiscono il flusso laminare d'aria ultrapulita e garantiscono la massima sterilità;
- i materiali richiesti sono dedicati ed insostituibili, onde ricorre l'ipotesi del "vincolo tecnico" di cui all'art. 76 comma 2 lettera b) punto 2) del D.lgs. 36 del 31 Marzo 2023 e s.m.i. ("*...Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione dal bando può essere utilizzata: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... ..2) la concorrenza è assente per motivi tecnici...*");

**DATO ATTO** che:

- in data 30/01/2024, la suddetta richiesta è stata valutata dai membri della "Commissione Infungibili Beni Durevoli e Materiale Dedicato" la quale si esprime con parere favorevole all'acquisto;
- in data 16/02/2024, il verbale della suddetta Commissione d'Infungibilità è stato trasmesso presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi al fine di procedere con i successivi adempimenti amministrativi;
- è stata avviata un'indagine di mercato, pubblicata sul sito Aziendale [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it), sezione Gare e Appalti di Beni e Servizi, e descritta rispettivamente nel bando esplorativo n° 02 del 14/03/2024, che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza del sopra indicato bando, non è pervenuta nessuna candidatura da parte di operatori economici per prodotti aventi caratteristiche

tecniche equivalenti a quelle descritte;

**VERIFICATO**, pertanto, di poter avviare la procedura negoziata di acquisto essendo state accertate le condizioni di infungibilità per i dispositivi medici oggetto del richiamato bando esplorativo;

**RITENUTO** opportuno adottare la modalità dell'accordo quadro poiché tale fattispecie contrattuale prevede che:

- i quantitativi di fornitura restino dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici, entro il limite del valore dell'Accordo in parola;
- l'Amministrazione appaltante non assuma alcun impegno a raggiungere un importo prestabilito né a raggiungere alcun valore minimo;
- l'operatore economico si impegni ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

**PRESO ATTO** che la società Starmed S.r.l.:

- è il distributore autorizzato in esclusiva per la vendita e l'assistenza tecnica nella Regione Abruzzo per i dispositivi di che trattasi;
- ha presentato, tramite la Piattaforma di e-Procurement regionale "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A.)", l'offerta economica prot. n. 30/ST/AM/edf del 10/04/2024, allegata al presente atto, con la quale si confermano le quotazioni economiche e le condizioni del precedente affidamento;
- ha dichiarato la congruità dei prezzi proposti rispetto a quanto applicato ad altre ASL sul Territorio Nazionale;

**CONSIDERATO** che il contratto di fornitura avrà un valore complessivo pari ad € 84.000,00 oltre iva (22%) e una durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

**DATO ATTO** dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;  
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;  
e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico – Finanziaria;

**ACQUISITI**, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

## **DELIBERA**

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato:

- 1. DI AFFIDARE** alla società Starmed S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, la fornitura di membrane sterili monouso LAF-02 dedicate al modulo a flusso laminare focalizzato per iniezione intravitale *TOUL OPERIO* mediante la sottoscrizione di un accordo quadro per un valore complessivo di € 84.000,00 oltre iva (22%) per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;
- 2. DI NOMINARE** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, Dott.ssa Federica Faccia;
- 3. DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con Deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;




**COMMISSIONE INFUNGIBILI BENI DUREVOLI E MATERIALE DEDICATO**

**VERBALE DEL GIORNO 30 gennaio 2024**

In data odierna alle ore 11:30 presso i locali della Direzione Sanitaria dell'Azienda ASL di Pescara in Via Paolini n.45, si sono riuniti il Direttore Sanitario Aziendale Dott. Rossano Di Luzio, il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica l'Ing. Vincenzo Lo Mele e l'Ing. Claudia Di Lanzo, per discutere sui seguenti argomenti all'o.d.g.:


•

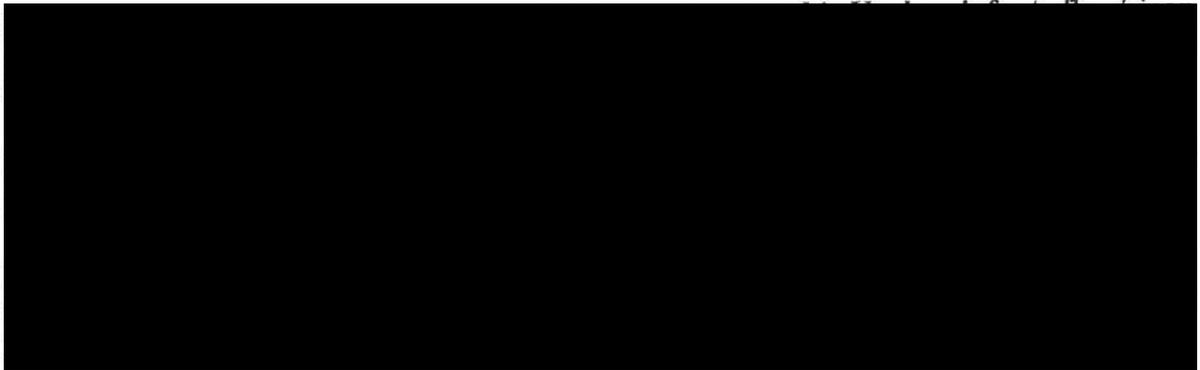

•

•


•




*RL*



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**Azienda Pubblica**

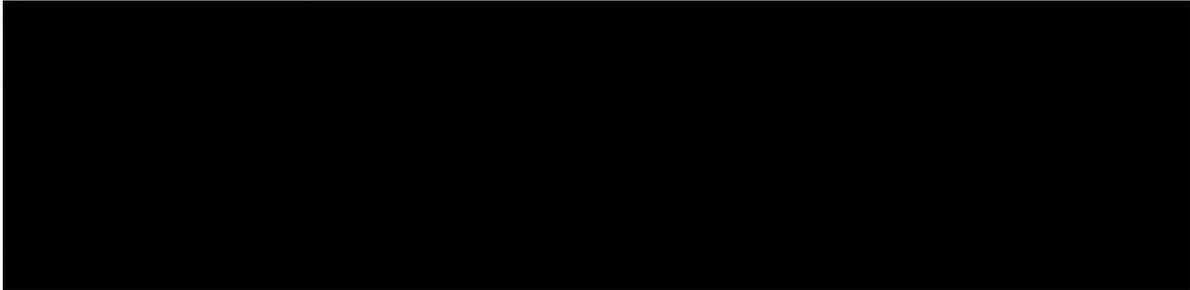

- **Punto 6: Membrana sterile monouso LAF02 dotato di filtro HEPA H14, materiale di consumo per Toul operatorio (Generatore di flusso laminare focalizzato – Fornitore TOUL MEDITECH AB – richiesta pervenuta con e-mail del 19/11/2023 UOC OCULISTICA**







**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**Azienda Pubblica**

**Varie ed eventuali**



Della riunione è redatto il presente verbale.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

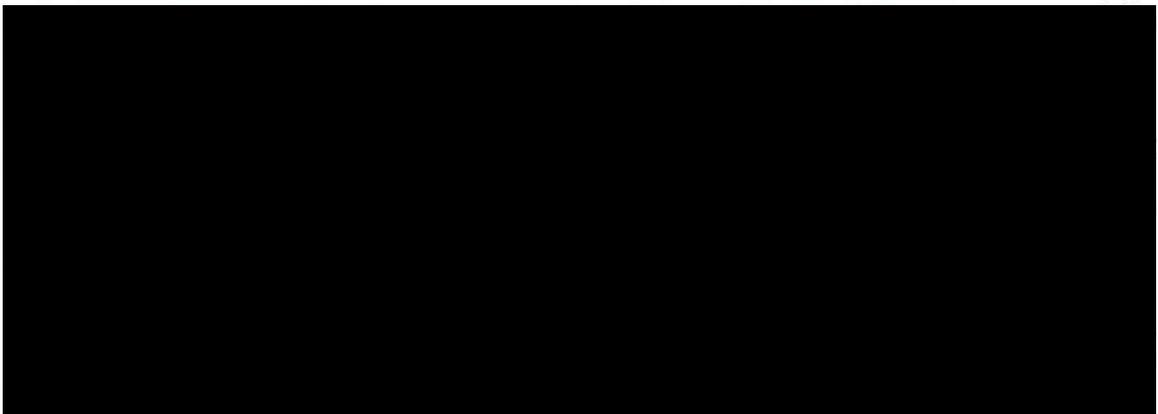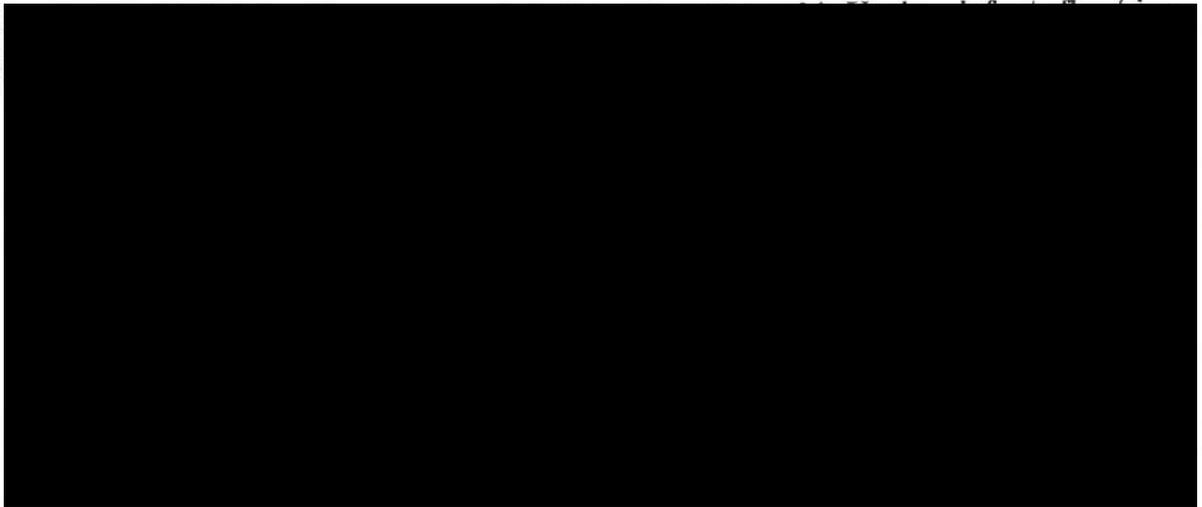



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Azienda Pubblica

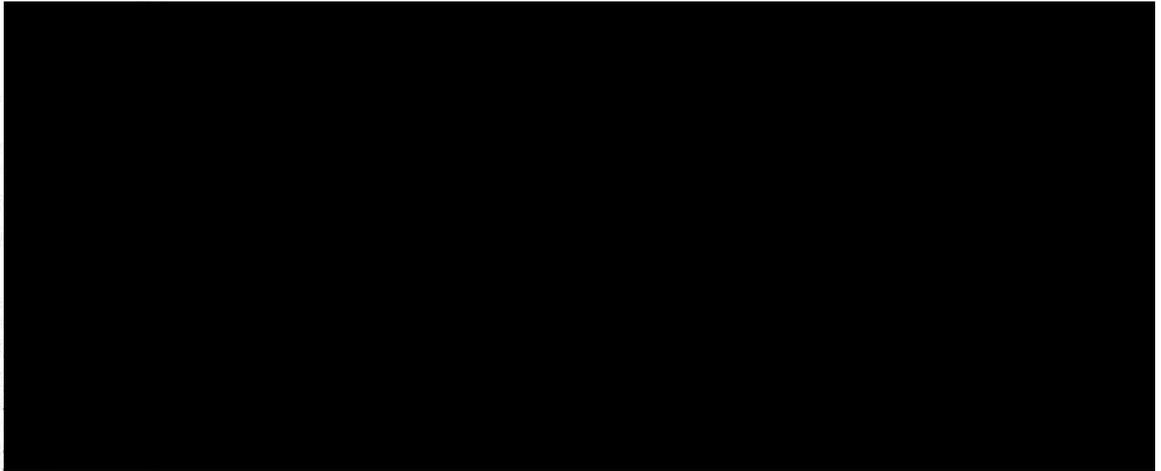

R






**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Azienda Pubblica

• **Punto 5:**

a)



b)



*RL*







**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**Azienda Pubblica**

- **Punto 6: Membrana sterile monouso LAF02 dotato di filtro HEPA H14, materiale di consumo per Toul Operio (Generatore di flusso laminare focalizzato – Fornitore TOUL MEDITECH AB – richiesta pervenuta con e-mail del 19/11/2023 UOC OCULISTICA**

L'Ing. Lo Mele prende la parola spiegando che trattasi materiale di consumo per apparecchio di proprietà della ASL denominato Toul Operio, che è un sistema che genera aria ultrapulita sotto forma di flusso laminare diretto sul sito operatorio e sugli strumenti, al fine di evitare contaminazioni.

Il Dott. Rossano Di Luzio e l'Ing. Vincenzo Lo Mele approvano la richiesta della UOC di Oculistica per Membrane sterili monouso LAF02 dotate di filtro HEPA H14, materiale di consumo per Toul Operio (Generatore di flusso laminare focalizzato).

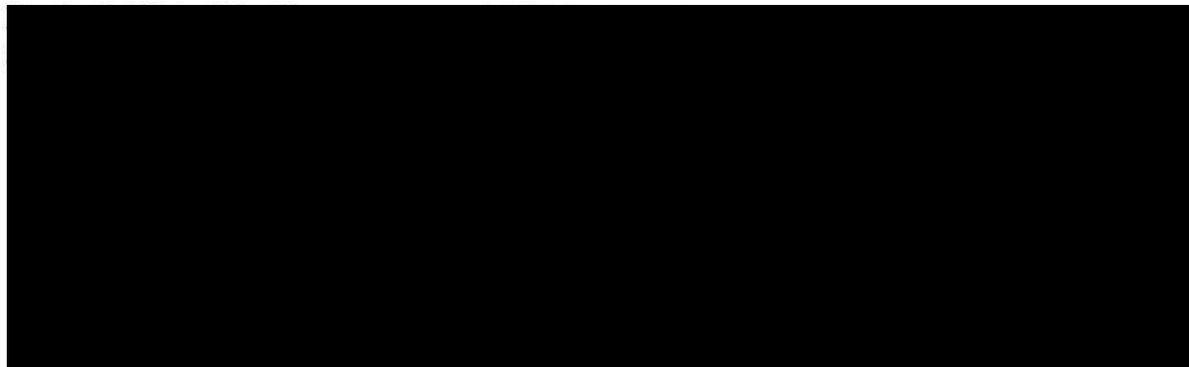



R





**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Azienda Pubblica

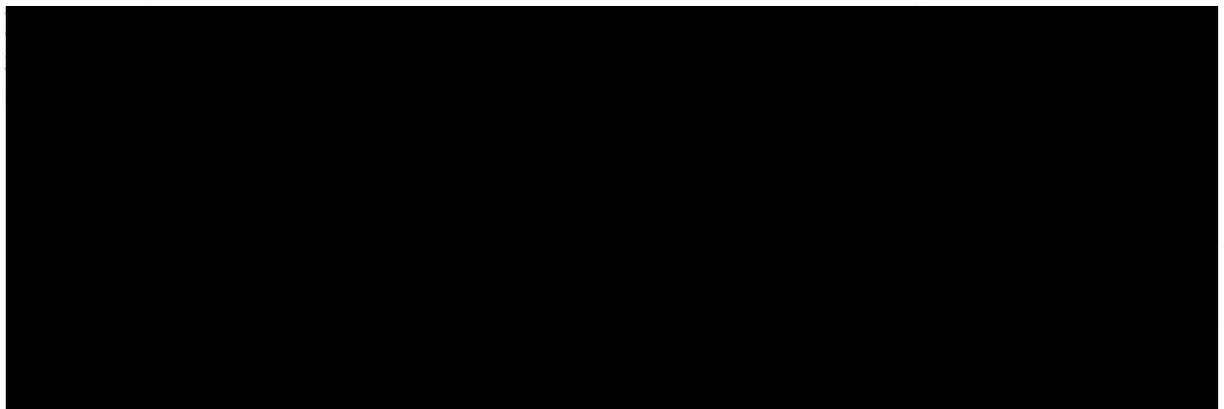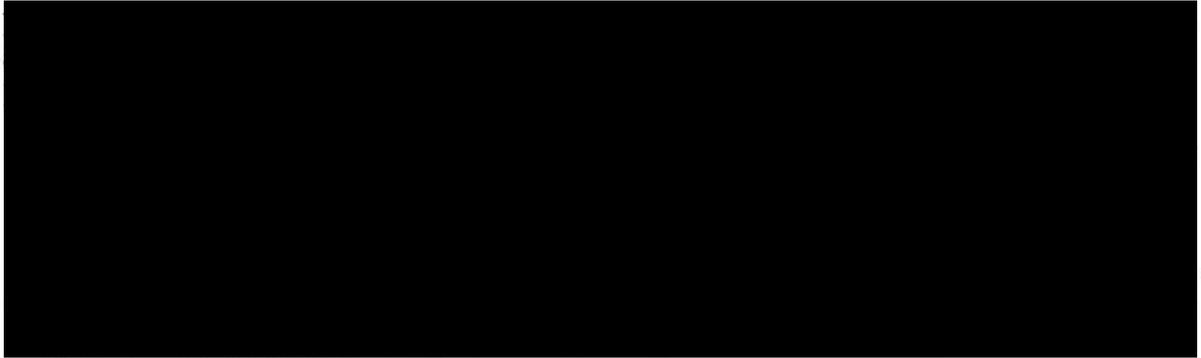


R





**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**Azienda Pubblica**



Il presente verbale viene trasmesso all'U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi per quanto di competenza per l'adozione degli atti consequenziali in rispondenza al piano triennale degli investimenti e acquisti A.E.M.

Alle 12:30 non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina.

**U.O.C.**  
IL DIRETTORE  
Ing. Clinica HTA  
Dr./Ing. Vincenzo LO MELE



**MODELLO**  
**RICHIESTA ACQUISIZIONE**  
**BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E**  
**MATERIALE DEDICATO**  
**INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI**

Mod. 4

pag. 1

di: 4

Al Direttore Sanitario Aziendale in qualità di Presidente  
della Commissione competente alla valutazione delle  
richieste di acquisizione di beni durevoli di natura sanitaria

SEDE

1. U.O. richiedente: UOC oculistico

2. Dipartimento: chirurgico

3. Tipologia di bene durevole (scegliere l'opzione di proprio interesse):

- apparecchiatura sanitaria
- componenti ed accessori di apparecchiatura sanitaria
- attrezzatura tecnico economale
- componenti ed accessori di attrezzatura tecnico economale

4. Oggetto della richiesta in configurazione completa di accessori (descrizione caratteristiche tecniche):

MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIO  
di PROPRIETA' DELLA ASL TOUL OPERIO (FLUSSO  
LAMINARE) SI TRATTA DI MEMBRANE STERILI DOTATE  
di CODICE A BARRE CND L0399 REF LAFOZ

5. Attività prevista che giustifica l'acquisto del bene:

VEDI ALLEGATO



MODELLO  
RICHIESTA ACQUISIZIONE  
BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E  
MATERIALE DEDICATO  
INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI

Mod. 4

pag. 2

di: 4

6. Specifiche di fornitura:

Fornitore: TOUL MEDITECH AIB

Spesa presunta in Euro Iva esclusa: \_\_\_\_\_

Durata proposta (da indicare solo in caso di noleggio/comodato): \_\_\_\_\_

Materiale di consumo:  NO  SI

In caso di risposta affermativa specificare:

tipologia: MEMBRANA STERILE

costo presunto annuo: NON NOTO - PT OCCORRENTI 600

se trattasi di materiale dedicato:  NO  SI

➤ [COMPILARE IL MODULO "SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI" IN FORMATO EXCEL]

Necessità di permuta:  NO  SI

In caso di risposta affermativa indicare relativamente all'apparecchiatura da permutare quanto segue:

a) N. INVENTARIO CESPITI _____
b) NOME E MODELLO _____
c) FORNITORE _____
d) UBICAZIONE _____

Necessità di disinstallazione e smaltimento dell'usato:  NO  SI

In caso di risposta affermativa, indicare relativamente all'apparecchiatura da smaltire quanto segue:

a) N. INVENTARIO CESPITI _____
b) NOME E MODELLO _____
c) FORNITORE _____
d) UBICAZIONE _____

	<b>MODELLO</b> <b>RICHIESTA ACQUISIZIONE</b> <b>BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E</b> <b>MATERIALE DEDICATO</b> <b>INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI</b>	Mod. 4	
		pag. 3	di: 4

Se la richiesta di acquisizione riguarda accessori o componenti di apparecchiatura di proprietà, indicare di quest'ultima:

a) N. INVENTARIO CESPITI	(600 PA ANNOI) N. INVENTARIO 94213
b) NOME E MODELLO	MEMBRANA STERILE (FLUSSO LAMINARE)
c) FORNITORE	TOUL MEDITECH AB
d) UBICAZIONE	SIA OPERATORIA DELL'IMICO

Informazioni aggiuntive (indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere, disponibilità mezzi di ricambio, esigenze di addestramento del personale ecc...)

---



---



---



---

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

---



---



---



---



---



---

	<b>MODELLO</b> <b>RICHIESTA ACQUISIZIONE</b> <b>BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E</b> <b>MATERIALE DEDICATO</b> <b>INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI</b>	Mod. 4	
		pag. 4	di: 4

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche sopra specificate **non sono disponibili prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali**, e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"*

Data 18/12/2013

Letto, confermato e sottoscritto (timbro e firma leggibile)

X Il Dirigente richiedente \_\_\_\_\_  
 Ospedale Civile dello Spirito Santo  
 Unità Operativa di Neurologia  
 Direttore Medico

X Il Direttore della Struttura interessata \_\_\_\_\_  
 Ospedale Civile dello Spirito Santo  
 Unità Operativa di Neurologia  
 Direttore Medico

Il Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura \_\_\_\_\_  
**ASL PESCARA**  
**U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza**  
**Dott. Massimo BASTI**  
 Dir. Med. 1° Liv. - Cod. 60812  
 Direttore Dipartimento delle Chirurgie  
 Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza

BANDO ESPLORATIVO BENI INFUNGIBILI N. 02 DEL 14.03.24

**MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL MODULO A FLUSSO LAMINARE  
FOCALIZZATO PER INIEZIONE INTRAVITREALE TOUL OPERIO**

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ TECNICA, DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE SANITARIE.**

Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara intende procedere ad una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e s.m.i., per la fornitura di **materiale di consumo dedicato al modulo a flusso laminare focalizzato per iniezione intravitreale TOUL Operio**, di proprietà di codesta Azienda e in uso presso la Sala Operatoria di Oculistica del P.O. di Pescara.

Ditta produttrice esclusivista: **STARMED S.r.l.**

**1. SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli scopi della presente consultazione preliminare sono i seguenti:

- verificare sul mercato la presenza di operatori economici in grado di fornire **materiale di consumo certificato/collaudato dalla casa produttrice** al fine di evitare incompatibilità, rilevazioni non attendibili nonché guasti durante le procedure causando l’invalidazione/decadimento della garanzia di acquisto dell’apparecchiatura elettromedicale;
- favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

In particolare, con il presente Avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, anche in relazione alle linee guida ANAC per gli affidamenti in regime di esclusività, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ASL, altri operatori economici possano fornire, in modo adeguato e legittimo, la fornitura del materiale di consumo sotto indicato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	N. PZ PER CONFEZIONE	CODICE
Membrana sterile monouso dotata di filtro EPA H14 Dimensione 47 cm x 60 cm	100	LAF02

Obiettivo della presente consultazione, pertanto, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

## **2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

L'operatore economico interessato, compreso l'operatore economico indicato come esclusivista, dovrà attestare, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo e recapiti della Ditta partecipante;
- ✓ Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- ✓ Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- ✓ Certificazione di compatibilità rilasciata dalla casa produttrice dell'apparecchiatura elettromedicale;
- ✓ Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale, esplicita e dettagliata;
- ✓ Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:

- ✓ non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- ✓ presentino documentazione manifestamente carente rispetto a quanto richiesto;
- ✓ presentino l'istanza fuori termine di scadenza.

**Non è consentito, pertanto, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.**

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare i documenti su indicati, richiesti per la partecipazione al presente avviso esplorativo, tramite PEC **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 25.03.24** al seguente indirizzo : [\*\*acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it\*\*](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:

**"Manifestazione di interesse al Bando Esplorativo n° 02 del 14.03.24 per l'acquisizione di materiale di consumo dedicato al modulo a flusso laminare focalizzato per iniezione intravitreale **TOUL Operio**".**

**Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.**

**La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.**

Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il materiale sopra riportato con i requisiti indicati.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'esclusivista della fornitura oggetto del presente avviso, codesta ASL dichiara sin da ora che avvierà, nelle forme opportune, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, negoziando pertanto il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale della ASL di Pescara ( [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it) ), sezione "Appalti e Contratti - Bandi Esplorativi Beni Infungibili".

**Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi**

*Dott.ssa Federica Faccia*



**SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI**

<b>CODICE ASL</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA (per UM)</b>	<b>FABBISOGNO 24 mesi (in UM)</b>	<b>VALORE FABBISOGNO 24 mesi</b>	<b>N. PZ PER CONFEZIONE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>CND</b>	<b>RND</b>	<b>NOMINATIVO PRODUTTORE</b>	<b>NOMINATIVO FORNITORE</b>
292424	MEMBRANA STERILE MONOUSO LAF02 DOTATA DI FILTRO EPA H14 DIM. 47 CM x 60 CM (CNF 100 PZ)	PZ	€ 70,00	1200	€ 84.000,00	100	<b>LAF 02</b>	L0399	603088	NORMEDITEC	STARMED SRL

Spett.le  
Asl Pescara  
Via R. Paolini 45  
65124 PESCARA (PE)

Teramo 10.04.2024

Prot. 30/ST/AM/edf del 10.04.2024

**OGGETTO: Offerta membrana sterile LAF-02 per Toul Operio, di nostra esclusiva distribuzione.**

La scrivente Società Starmed Srl, corrente in Teramo (TE) in Via Alberto Pepe 8, in risposta alla Vostra gentile richiesta, è lieta di trasmetterVi sua migliore offerta per il seguente prodotto:

CODICE PRODOTTO	CND	RDM	DESCRIZIONE	N. PEZZI A CONFEZIONE INDIVISIBILE	PREZZO PER UNITA' DI MISURA*	PREZZO A CONFEZIONE*	IVA
LAF-02	L0399	603088	MEMBRANA STERILE MONOUSO LAF02 DOTATA DI FILTRO EPA H14 DIM. 47 CM x 60 CM	100 pz	70,00 €	7.000,00 €	22%

(comprensivo di ogni e qualsiasi onere: trasporto, imballo, merce franco magazzino ASL)

**\*I prezzi si intendono IVA esclusa**

Modalità di fornitura:

Validità offerta:	30.04.2026
Consegna:	Verrà indicata sulla conferma d'ordine.
Resa:	Franco Vostra sede.
Imballo:	A ns. carico.
Iva:	A Vs. carico ai sensi di Legge.
Pagamento:	entro 60gg d.f. ai sensi di Legge

In fede,

L'Amministratore Unico



Starmed S.r.l.  
L'Amministratore Unico

Spett.le  
A.S.L. PESCARA  
Via Renato Paolini 45  
65124 PESCARA (PE)

Teramo 10.04.2024

**OGGETTO: FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL MODULO A FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO PER INIEZIONE INTRAVITREALE "TOUL OPERIO" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA.**

In risposta a quanto riportato in oggetto, la scrivente società STARMED SRL, con sede legale in Teramo, Via Alberto Pepe n.8, codice fiscale e partita IVA 01831720675, nella persona del suo Amministratore Unico Ing. Federico Di Domenica, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED],

**DICHIARA  
(Ai sensi del D.P.R. 445/2000)**

La congruità dei prezzi proposti rispetto a quanto applicato alle altre Asl sul Territorio Nazionale.

In fede,

L'Amministratore Unico



Starmed S.r.l.  
L'Amministratore Unico



## **NORMEDITEC S.R.L.**

Via De Gasperi, 19 - 43018 Sissa Trecasali  
Codice Fiscale e P. IVA 02479230217

Fax: 0521/37 36 31 Tel. 348 730 24 45 – PEC normeditec@pec.it

21/02/2023

### **A CHI DI COMPETENZA**

OGGETTO: ESCLUSIVA

Col la presente dichiariamo che la Società Starmed Srl - Via Alberto Pepe, 8 - 64100 Teramo (TE) è il nostro distributore autorizzato in esclusiva per la vendita e l'assistenza tecnica della Regione Abruzzo dei prodotti:

- TOUL OPERIO MOBILE
- TOUL OPERIO UNITA' A SOFFITTO
- TOUL STERISTAY UNITA' MOBILE PORTA-FERRI
- MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI

L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti.

NORMEDITEC SRL

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010316

Anno 2024-2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 781 del 03/05/2024 ad oggetto:**

AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARMED S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL MODULO A FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO PER INIEZIONE INTRAVITREALE "TOUL OPERIO" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/5/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato