

CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 1 Osp. Civile PESCARA

Data: 22/01/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

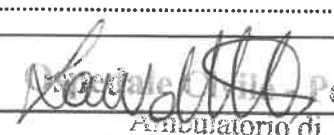
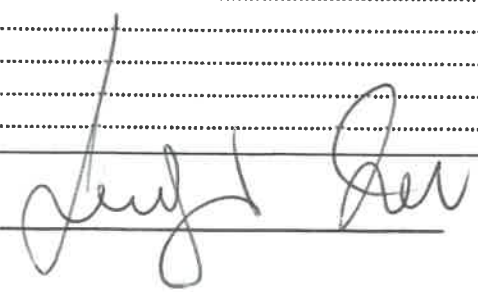
Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- | | |
|--|---|
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM <u>415</u> | ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 2 L/H <u>140</u> |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM <u>0.18</u> | ☒ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>4</u> ATM FILTRI |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM <u>0.18</u> | ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI |
| ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO | ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI |
| ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE | ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO |
| ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE | ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI |
| ☒ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE | ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE |
| ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO <u>0</u> | ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA |
| ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO | ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H <u>140</u> -S/CM <u>4.5</u> | ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H <u>140</u> -S/CM <u>3.8</u> | ☒ 2- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO |
| ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>810</u> | ☒ 2-VARIE |

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA LOOP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	<u>1</u>
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>1</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente  Pescara
Amministratore di
Nefrologia e DialisiIl Tecnico 



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data: 22/01/28

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 4,2
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,8
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0,2
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0,2
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 11,80 -S/CM 11,6
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 12,6 -S/CM 11,7
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 4,6

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 4,6
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20μ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5μ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA RETE	<u>2</u>
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>1</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente

UNITA' OPERATIVA
II DIALISI
OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Tecnico



Ora: :

☒ **PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI**

☒ **REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI**

☒ **RIGENERAZIONE ADDOLCITORI**

☒ **SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO**

☒ **SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI**

☒ **TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE**

☒ **TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA**

☒ **TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI**

☒ **VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI**

☐ **Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO**

☐ **Z-VARIE**

Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. POPOLI

Data: 30/01/25 Ora: ____: ____

Intervento Programmato N.ro _____ del _____	Prestazione: contratto _____ Contratto N.ro _____
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno, 4 20128 MILANO	Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia	
Motivazione: contratto d'opera	

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 2
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,6
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1250 S/CM 4,5
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1050 S/CM 2
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 250

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 70
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente

U.O.S. NEFR/DIAL

P.O. POPOLI AUSL PE

Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. PENNE

Data: 31/01/25 Ora: __: __

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 3
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.6
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1800 -S/CM 5
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 950 -S/CM 3
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 250

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 100
- ☒ PRESSIONE IN 3.5 ATM-OUT 3.5 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente AUSL PESCARA P.O. PENNE
U.O. di NEFROLOGIA E DIALISIIl Tecnico 



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data: 20/04/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- | | |
|--|---|
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM <u>1</u> | ☐ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>900</u> |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM <u>0,8</u> | ☒ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>5</u> ATM FILTRI |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM <u>0</u> | ☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI |
| ☐ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO | ☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI |
| ☐ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE | ☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO |
| ☐ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE | ☐ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI |
| ☐ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE | ☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE |
| ☐ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO <u>0</u> | ☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA |
| ☐ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO | ☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H <u>1480</u> S/CM <u>3</u> | ☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H <u>1300</u> S/CM <u>1</u> | ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO |
| ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>420</u> | ☐ Z-VARIE |

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà		Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒	PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>1</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>			
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>			

Comunicazioni Tecniche (note)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UNITA' OPERATIVA
IL DIALISI
OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Cliente

Il Tecnico



Data: 20/02/25 Ora: ____:

☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI

☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI

☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI

☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI

☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO

☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI

☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE

☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA

☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI

☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI

☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO

☐ Z-VARIE

Il Tecnico



Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 1 Osp. Civile PESCARA

Data:

18/03/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 2
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,8
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 490 S/CM 5
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1390 S/CM 2
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 400

- ☐ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 2 L/H 90
- ☐ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☐ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente

[Signature]
UOC NEFROLOGIA E DIALISI
COORDINATRICE INFERMIERISTICA
Dott.ssa Giovanna LA SELVA
Matr. 2270

Il Tecnico

[Signature]



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data:

18/03/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 3
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.3
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0.3
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1600 -S/CM 4
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1600 -S/CM 3
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 400

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 100
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

..... 	
---	--

Il Cliente

UNITA' OPERATIVA
II DIALISI
OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Tecnico



Data: 18/03/25 Ora: :

- ☒ **PRESSIONE IN 3 ATM-OUT 3 ATM FILTRI**
- ☒ **PRESSIONE IN 3 ATM-OUT 3 ATM FILTRI**
- ☒ **REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI**
- ☒ **RIGENERAZIONE ADDOLCITORI**
- ☒ **SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO**
- ☒ **SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI**
- ☒ **TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE**
- ☒ **TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA**
- ☒ **TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI**
- ☒ **VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI**
- ☐ **Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO**
- ☐ **Z-VARIE**

Il Tecnico

[Handwritten signature]



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com**ASL PESCARA**Rapporto di Assistenza Tecnica**Centro Dialisi P.O. PENNE**Data: 28/03/25 Ora: __: __

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 3
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.8
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 8
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 100 -S/CM 6
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 150 -S/CM 3
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 200

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 150
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20μ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5μ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

ASL PESCARA - P.O. PENNE
U.O. di NEFROLOGIA E DIALISI

Il Cliente

Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com**ASL PESCARA**Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. POPOLI

Data: 31/03/25 Ora: :

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 2
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,1
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1200 -S/CM 6
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1100 -S/CM 2
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 800

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 300
- ☒ PRESSIONE IN 3 ATM-OUT 2 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>1</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)IMPIANTO IN SERVIZI CON FUNZIONI NELLA NORMA

Il Cliente _____

Il Tecnico _____

ASL PESCARA - P.O. POPOLI
UOS NEFROLOGIA - DIALISI
Dr.ssa Valeria PALMA
Matr. 72533 c.d.c.

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data: 22/04/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
<i>Descrizione Impianto: 000115/00</i> 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| ☒ | ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM | <u>0,7</u> |
| ☒ | CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM | <u>0,7</u> |
| ☒ | CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM | <u>0</u> |
| ☒ | CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO | |
| ☒ | CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE | |
| ☒ | CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE | |
| ☒ | DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE | |
| ☒ | DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO | <u>0</u> |
| ☒ | LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO | |
| ☒ | ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H | <u>1000</u> -S/CM <u>14</u> |
| ☒ | ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H | <u>1200</u> -S/CM <u>3</u> |
| ☒ | PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H | <u>200</u> |

- ☐ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 200
- ☐ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☐ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

	Descrizione	Q.tà		Descrizione	Q.tà
☒	CARTUCCIA FILTRO 20μ	3	☒	PRELIEVO ACQUA LOUP	2
☒	CARTUCCIA FILTRO 5μ	3	☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☒	SALE RIG.ADDOLCITORE	20			
☒	IPOCLORITO	1			

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente

UNITA OPERATIVA
II DIALISI
OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Tecnico

Paul Elmer

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro U.T.I.E. OSP CIVILE PESCARA

Data: 22/04/25 Ora: ____: ____

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
<i>Descrizione Impianto: 000112/00</i> 2 ADD. HA90 + 1 FILTRO DECL. +1 OSMOSI +2 autoclave+accumulo+ FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

☒ ACQUA OSMOTIZZATA UTENZE	Mc S/CM	<u>5</u>	☐ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>4</u> ATM FILTRI
☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM	<u>0.2</u>		☒ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>4</u> ATM FILTRI
☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM	<u>0</u>		☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO			☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE			☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE			☐ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
☒ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE			☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO	<u>0</u>		☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO			☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H	<u>750</u> -S/CM	<u>5</u>	☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H	<u>270</u>		☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
			☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione		Q.tà	Descrizione		Q.tà
☒	CARTUCCIA FILTRO 20μ	2	☒	PRELIEVO ACQUA LOUP	1
☒	CARTUCCIA FILTRO 5μ	2	☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☐	SALE RIG.ADDOLCITORE	20			
☒	IPOCLORITO	1			

[illegible]

Il Cliente *Terapia Intensiva Ematologica*

Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. POPOLI

Data: 29/04/2025 Ora: __: __

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri	
☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM <u>3,6</u>	☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>200</u>
☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM <u>0,4</u>	☒ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>4</u> ATM FILTRI
☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM <u>—</u>	☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO	☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE	☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE	☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE	☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
☒ PUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO	☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO	☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H <u>140</u> S/CM <u>5,8</u>	☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H <u>1130</u> S/CM <u>1,1</u>	☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>150</u>	☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

.....

Il Cliente

U.O.S. NEFR/DIAL
P.O. POPOLI AUSL PE

Il Tecnico

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. PENNE

Data: 28/04/2025 Ora: :

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
<i>Descrizione Impianto: 000112/00</i> 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 5T
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 29
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 2
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO
- ☐ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 120 S/CM 11
- ☐ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 2100 S/CM 5T
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 1200

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 180
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

	Descrizione	Q.tà		Descrizione	Q.tà
☒	CARTUCCIA FILTRO 20μ	2	☒	PRELIEVO ACQUA LOUP	2
☒	CARTUCCIA FILTRO 5μ	2	☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☒	SALE RIG.ADDOLCITORE	20			
☒	IPOCLORITO	1			

Comunicazioni Tecniche (note)	
AUSL PERUGIA - 30 PENNE U.O. di NEFROLOGIA E DIALISI	

Il Cliente

Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data: 28/05/25

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 25
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.6
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1000 S/CM 3
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1100 S/CM 2.5
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 400

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 600
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☐ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20μ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>1</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5μ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

UNITA' OPERATIVA

II DIALISI

OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Cliente

Il Tecnico



Il Tecnico



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. POPOLI

Data: 09/05/23 Ora: __: __

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri


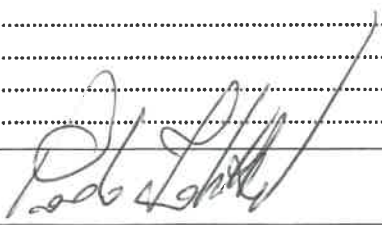
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 2
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,7
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0,7
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 0
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 1200 -S/CM 5
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 1300 -S/CM 2
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 300


- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 200
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

U.O.S. NEFR/DIAL
P.O. POPOLI AUSL PEIl Cliente Il Tecnico 



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. PENNE

Data: 29/05/2025 Ora: ____: ____

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 0.7
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.7
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 1
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASH LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 100 S/CM 11.8
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 100 S/CM 5.6
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 100

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 100
- ☒ PRESSIONE IN 1 ATM-OUT 1 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20µ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5µ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

AUSL PESCARA - P.O. PENNE

U.O. di NEFROLOGIA E DIALISI

Il Cliente

Il Tecnico



24, 06, 2025

☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 80

☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI

☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI

☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI

☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO

☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI

☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE

☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA

☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI

☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI

☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO

☐ Z-VARIE

Il Tecnico

Jeff Quast



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi 2 Osp. Civile PESCARA

Data: 24/06/2015

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000115/00 2 ADD. + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + POMPA DOSATRICE CLORO + FILTRI cartuccia + SANITIZZAZIONE TERMICA			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 3.8
 - ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0.1
 - ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 1
 - ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
 - ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
 - ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
 - ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
 - ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 2
 - ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
 - ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 118 S/CM 57
 - ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 118 S/CM 26
 - ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 410

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 400
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20μ	<u>1</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5μ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

Il Cliente

UNITA' OPERATIVA
IDIALISI
OSPEDALE CIVILE
PESCARA

Il Tecnico

[Signature]

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro U.T.I.E. OSP CIVILE PESCARA

Data: 06/06/2025 Ora: :

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
<i>Descrizione Impianto: 000112/00</i> 2 ADD. HA90 + 1 FILTRO DECL. +1 OSMOSI +2 autoclave+accumulo+ FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- | | | |
|--|---------|------|
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA UTENZE | Mc S/CM | 19,2 |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO | PPM | 0,8 |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE | PPM | — |
| ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO | | |
| ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE | | |
| ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE | | |
| ☒ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE | | |
| ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO | | |
| ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO | | |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H | — S/CM | 19,8 |
| ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H | | 15 |

☒ PRESSIONE IN	h	ATM-OUT	h	ATM FILTRI
☒ PRESSIONE IN	9	ATM-OUT	h	ATM FILTRI
☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI				
☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI				
☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO				
☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI				
☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE				
☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA				
☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI				
☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI				
☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO				
☒ Z-VARIE				

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

	Descrizione	Q.tà		Descrizione	Q.tà
☒	CARTUCCIA FILTRO 20μ	2	☐	PRELIEVO ACQUA LOUP	
☒	CARTUCCIA FILTRO 5μ	20	☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☒	SALE RIG.ADDOLCITORE				
☒	IPOCLORITO	1			

Comunicazioni Tecniche (note)

ASL PESCARA

ASL PESCARA
Dipartimento Oncologico Ematologico
U.O.S.D.

Il Cliente

U.S.D.
Terapia Intensiva Ematologica

Il Tecnico

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. POPOLI

Data: 27/06/2025 Ora: :

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Pipiteno , 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM 3,5
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM 0,1
- ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM 0,1
- ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO
- ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE
- ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE
- ☒ DISINCRUSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE
- ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO 8
- ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H 118 S/CM 1,6
- ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H 118 S/CM 2,4
- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 103

- ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H 180
- ☒ PRESSIONE IN 4 ATM-OUT 4 ATM FILTRI
- ☒ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI
- ☒ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI
- ☒ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO
- ☒ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI
- ☒ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE
- ☒ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA
- ☒ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI
- ☒ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI
- ☒ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO
- ☒ Z-VARIE

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione		Q.tà	Descrizione		Q.tà
☒	CARTUCCIA FILTRO 20μ	3	☒	PRELIEVO ACQUA LOUP	1
☒	CARTUCCIA FILTRO 5μ		☐	PRELIEVO ACQUA RETE	
☒	SALE RIG.ADDOLCITORE	20			
☒	IPOCLORITO	1			

[illegible]

Il Cliente *106 11*

Il Tecnico _____
P.O. POPOLI AUSL PE



CENTRO ASSISTENZA E VENDITA

Culligan

AQUATEC S.r.l.

Corso Gabriele Manthonè 52/54 - 65127 PESCARA

TEL. 085 8420663 Fax 085 2013998

P.IVA-COD.FISCALE 02072830686

Email: aquatec.srl@hotmail.com

ASL PESCARA

Rapporto di Assistenza Tecnica

Centro Dialisi P.O. PENNE

Data: 27/06/2015 Ora: ____: ____

Intervento Programmato N.ro	del	Prestazione: contratto	Contratto N.ro
Cliente: SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Richiedente: RIF.TO VS. CONTRATTO DI APPALTO Recapiti Telefonici: Tel.: 0858420663 Fax: 0852013998 e-mail: aquatec.srl@hotmail.com	
Descrizione Impianto: 000112/00 2 ADD. HA90 + 2 FILTRI DECL. B-OSMOSI + FEEDER PROP + FILTRI cartuccia			
Motivazione: contratto d'opera			

Servizi relativi all'intervento: A- base Cambio filtri

- | | |
|--|--|
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA AI RENI MICRO S/CM <u>5.8</u> | ☐ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>180</u> |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA ADDOLCIMENTO PPM <u>0.1</u> | ☐ PRESSIONE IN <u>4</u> ATM-OUT <u>4</u> ATM FILTRI |
| ☒ CLORO RESIDUO USCITA DECLORAZIONE PPM <u>1</u> | ☐ REINTEGRO PROD. RIGENERANTI, REATTIVI, SANITIZZANTI |
| ☒ CONTR. CHIMICO FISICO ACQUA CON FOTOMETRO | ☐ RIGENERAZIONE ADDOLCITORI |
| ☒ CONTROLLO FASI DI RIGENERAZIONE E SANITIZZAZIONE | ☐ SANITIZZAZIONE TECNICA IMPIANTO |
| ☒ CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE | ☐ SOST. CARTUCCE FILTRANTI E SANIT. CONTENITORI |
| ☒ DISINCROSTAZIONE E CONTROLLO POMPA DOSATRICE | ☐ TARAT. PARTI ELETTRIC-ELETTRONICHE E IDRAULICHE |
| ☒ DUREZZA ACQUA USCITA ADDOLCIMENTO | ☐ TARATURA FLUSSI OSMOSI INVERSA |
| ☒ LAVAGGIO FILTRI UR E CONTROLLO FASI LAVAGGIO | ☐ TARATURA LUBRIFICAZIONE PRESSOSTATI DISSALATORI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 1 L/H <u>180</u> S/CM <u>14.8</u> | ☐ VERIFICA EFFICIENZA ELETTROVALVOLE E ALLARMI |
| ☒ ACQUA OSMOTIZZATA OSMOSI 2 L/H <u>180</u> S/CM <u>5.7</u> | ☐ Z- SOSTITUZIONE MATERIALE SOTTO DESCRITTO |
| ☒ PORTATA ACQUA SCARICO OSMOSI 1 L/H <u>180</u> | ☐ Z-VARIE |

Materiali forniti e/o Parti di Ricambio utilizzati

Descrizione	Q.tà	Descrizione	Q.tà
☒ CARTUCCIA FILTRO 20μ	<u>2</u>	☒ PRELIEVO ACQUA LOUP	<u>2</u>
☒ CARTUCCIA FILTRO 5μ	<u>2</u>	☐ PRELIEVO ACQUA RETE	
☒ SALE RIG.ADDOLCITORE	<u>20</u>		
☒ IPOCLORITO	<u>1</u>		

Comunicazioni Tecniche (note)

ASL PESCARA P.O. PENNE U.O. di NEFROLOGIA E DIALISI
--

Il Cliente

Il Tecnico