



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA  
Azienda Pubblica

**RELAZIONE FINALE GARA SONDE E CATETERI PER LE ESIGENZE DELLA  
ASL DI PESCARA.**

In data 27/03/2024 alle ore 9.00 presso l'Ufficio ABS del P.O. di Pescara, si è riunito il Collegio Tecnico per la valutazione della gara inerente la fornitura di sonde e cateteri per le esigenze di varie UU.OO. della ASL di Pescara, istituito con D.D.G. n. 1859 del 7 dicembre 2023 e composto dai seguenti membri:

Presidente Dr.ssa Maria Pia Musa – Dirigente Farmacista ASL Pescara;

Componente Dr.ssa Sara Colangelo – Collaboratore San. Infer, UOC Urologia ASL Pescara;

Componente Dr. Antonio Potere Refern. Infermieristico T.A.M.A. ASL Pescara.

Il Collegio Tecnico ha iniziato la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte in relazione al rispetto dei requisiti minimi previsti dall'allegato tecnico del capitolato di gara per i lotti dal numero 1 al numero 28

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dell'analisi delle offerte tecniche per ciascuno dei suddetti lotti:

**LOTTO 1 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)**

**Misure monolume 3 Fr lunghezza da 40 a 80 cm**

| <b>Operatore<br/>Economico</b>        | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>PLAN 1 HEALTH<br/>101.60.11.13</b> | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato. |
| <b>VIGON<br/>APM03160N03</b>          | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato. |
| <b>SEDA<br/>MR17033105,</b>           | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato. |

**LOTTO 2 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)**

**Misure bilume 4 Fr lunghezza da 40 a -80 cm**

| <b>Operatore<br/>Economico</b>        | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>PLAN 1 HEALTH<br/>101.60.12.24</b> | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato.  |
| <b>VIGON<br/>APM04260N03</b>          | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato.  |
| <b>INNOVAMEDICA<br/>A1404260N</b>     | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato.<br>Inoltre non è specificata la compatibilità con i taxani e non risulta presente il cavetto per ECG intracavitario. |


**LOTTO 3 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)**

**Misure bilume 4 Fr lunghezza da 45 a 80 cm**

| <b>Operatore<br/>Economico</b>        | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>PLAN 1 HEALTH<br/>101.60.11.14</b> | SI                                   | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>VIGON<br/>APM04160N03</b>          | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: relativamente alla presenza del secondo ago tagliente che non è presente nella campionatura pur essendo stato dichiarato in scheda tecnica. |
| <b>SEDA<br/>MR41MCAFST</b>            | SI                                   | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |



| CRITERI DI QUALITÀ'<br>LOTTO 3   | TIPO | PLAN IHEALTH                                  | SEDA   | PUNTEGGIO<br>MAX |
|--|------|---|--|------------------|
| Finitura dei materiali   | D    | 10X1=10                                       | 10X1=10  | 10               |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza                                 | D    | 10X1=10                                       | 10X1=10  | 10               |
| Qualità del kit di microintroduzione   | D    | 15X1=15                                       | 15X0,80=12<br>il KIT di microintroduzione presenta una rastrematura meno performante. Inoltre, risulta assente lo spingiguide. | 15               |
| Visibilità della marcatura per tutta la lunghezza del catetere, ogni centimetro nella parte prossimale | D    | 10X1=10                                       | 10X1=10  | 10               |
| Sistema sutureless per bloccaggio/fissaggio nella confezione, applicabile sulle alette del catetere    | D    | 5X1=5   | 5X1=5  | 5                |
| Qualità del sistema In comodato d'uso:   | :    |   |  |                  |
| semplicità di utilizzo   | D    | 2x1=2   | 2x1=2  | 2                |
| stabilità del segnale Ecg del sistema intracavatorio proposto  | D    | 6x1=6   | 6x1=6  | 6                |
| esportabilità della traccia Ecg in PDF   | T    | 4   | 4  | 4                |
| funzioni Wireless  | T    | 3   | 3  | 3                |
| Qualità della sonda proposta:  | :    |   |  |                  |
| qualità dell 'immagine (da demo/visione)   | D    | 10X1=10                                       | 10X1=10  | 10               |
| Portabilità in termini di maneggevolezza e minor peso  | D    | 5X0,6=3<br>La sonda risulta meno maneggevole. | 5X1=5  | 5                |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>  |      | <b>78</b>                                     | <b>77</b>  | <b>80</b>        |

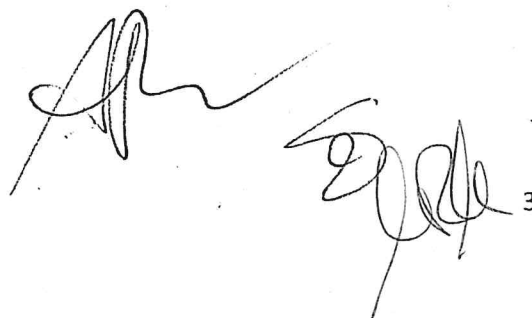

Handwritten signature and initials, possibly representing the evaluator or the company, located at the bottom right of the page.

**LOTTO 4 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)**

**Misure monolume 5 Fr, bilume 5 Fr lunghezza da 45 a 80 cm**

| <b>Operatore Economico</b>                  | <b>Rispetto requisiti minimi</b> |   |
|---|----------------------------------|---|
| <b>SEDA<br/>MR51MCAF2ST<br/>MR52MCAF2ST</b> | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: relativamente alla presenza del cavetto per ECG intracavitario che non è presente nella campionatura inviata pur essendo dichiarato in scheda tecnica. |
| <b>VIGON<br/>APM0516N03<br/>APM0526N03</b>  | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: relativamente alla presenza del secondo ago dichiarato in scheda tecnica e non presente nella campionatura.  |

**LOTTO 5 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)**

**Misure Trilume 5 o 6 Fr, lunghezza da 40 a 80 cm**

| <b>Operatore Economico</b>                     | <b>Rispetto requisiti minimi</b> |  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>INNOVAMEDICA<br/>A1406360N<br/>A1406360</b> | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico:<br>le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato; il cavetto per ECG intracavitario che non risulta presente nella campionatura inviata pur essendo dichiarato in scheda tecnica.  |
| <b>VIGON<br/>APM06360N03</b>                   | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico il secondo ago che risulta assente.   |
| <b>SEDA<br/>MR63MCAF3ST</b>                    | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico:<br>le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato; il cavetto per ECG intracavitario che non risulta presente nella campionatura inviata pur essendo dichiarato in scheda tecnica. |



 

**LOTTO 6 CATETERE VENOSO CENTRALE A LUNGO TERMINE TUNNELLIZZATO CUFFIATO**

Misure 5-6 Fr monolume lunghezza da 40 a 80 cm con cuffia.

| <b>Operatore Economico</b>  | <b>Rispetto requisiti minimi</b> |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>SEDA<br/>MR28035101-MCA<br/>MR28036101-MCA<br/>MR28035121-MCAS<br/>MR28036121-MCAS</b> | Si                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |
| <b>SBM<br/>6700515</b>  | Si                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |

| <b>CRITERI DI QUALITÀ' LOTTO 6</b>  | <b>TIPO</b> | <b>SBM</b> | <b>SEDA</b> | <b>PUNTEGGIO MAX</b> |
|---|-------------|------------|-------------|----------------------|
| <b>Finitura dei materiali</b>   | D           | 25x1=25    | 25x1=25     | 25                   |
| <b>Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</b> | D           | 20x1=20    | 20x1=20     | 20                   |
| <b>Qualità del kit di microintroduzione</b>                                   | D           | 10x1=10    | 10x1=10     | 10                   |
| <b>Qualità della cuffia</b>   | D           | 15x1=15    | 15x1=15     | 15                   |
| <b>Presenza tunnellizzatore metallico aggiuntivo</b>                          | T           | 5X1=5      | 5X1=5       | 10                   |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>   |             | <b>80</b>  | <b>80</b>   | <b>80</b>            |

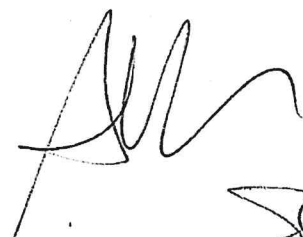  
 5

**LOTTO 7 CATETERE VENOSO CENTRALE A LUNGO TERMINE TUNNELIZZATO CUFFIATO**

misure 5-6Fr bilume lunghezza da 40 a 80cm con cuffia.

| <b>Operatore<br/>Economico</b>   | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |   |
|--|--------------------------------------|---|
| SEDA<br>DM ref MR28035201-MCA<br>DM ref MR28036201-MCA<br>DM ref MR28036221-MCAS | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico:<br>relativamente alla presenza del cavetto per ECG intracavitario che non risulta nella campionatura inviata pur essendo stato dichiarato in scheda tecnica |
| SBM<br>DM ref 6720515<br>DM ref 6700610<br>DM ref 67200615                       | NO                                   | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico:<br>relativamente alla presenza del cavetto per ECG intracavitario che non risulta nella campionatura inviata pur essendo stato dichiarato in scheda tecnica |

**LOTTO 8 PICC CON TRIMMING PROSSIMALE**

**CATETERE VENOSO CENTRALE A INSERIMENTO PERIFERICO**


Monolume Misure 3-4-5 Fr lunghezza da 45 a 80 cm.

| <b>Operatore<br/>Economico</b>               | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |  |
|--|--------------------------------------|--|
| VIGON<br>A1295.310<br>A1295.410<br>A1295.510 | NO                                   | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico, relativamente alla Direttiva 32/2010 come da capitolato tecnico. |

**LOTTO 9 CATETERE VENOSO MIDLINE**

Misure richieste Monolume 3-4-5 Fr, lunghezza compresa tra 16-25 cm

| <b>Operatore<br/>Economico</b>                           | <b>Rispetto<br/>requisiti minimi</b> |  |
|--|--------------------------------------|--|
| DELTAMED<br>333251302122<br>334251302122<br>335251302122 | SI                                   | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |
| PL1 HEALTH<br>101.67.08.13<br>101.6708.14                | Si                                   | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |

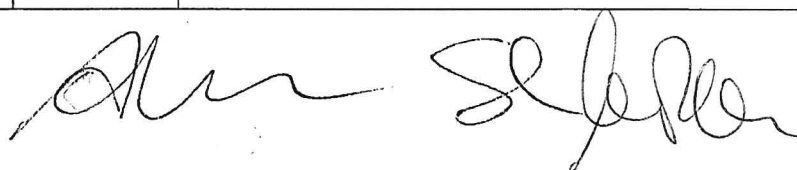

|   |    |   |
|---|----|---|
| 101.67.08.15<br>101.67.07.13<br>101.67.07.14<br>101.67.07.15      |    |   |
| SEDA<br>MLCT3S15<br>MLCT4S205<br>MLCT5S20                         | SI | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico              |
| VIGON<br>A128.132006<br>A128.142006<br>A128.152006<br>A128.142506 | SI | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico              |
| SBM<br>P6153118<br>P6154118                                       | NO | Non presenta il monolume da 5 Fr come richiesto da capitolato tecnico |

| CRITERI DI QUALITA' LOTTO 9   | TIPO | DELTAMED  | PLI HEALTH | SEDA  | VIGON   | Punteggio massimo |
|---|------|---|------------|---|---|-------------------|
| Finitura dei materiali  | D    | 20x1=20   | 20x1=20    | 20x1=20   | 20x1=20   | 20                |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza  | D    | 20x1=20   | 20x1=20    | 20x1=20   | 20x1=20   | 20                |
| Qualità del kit di microintroduzione  | D    | 25x0,9=22,5<br>il KIT di microintroduzione presenta una rastrematura che rende l'inserimento meno performante. Nel contempo risulta, però, dotato di uno spinguida che consente una migliore maneggevolezza durante l'utilizzo. | 25x1=25    | 25x0,8=20<br>il KIT di microintroduzione presenta: una rastrematura che risulta meno performante durante l'inserimento, inoltre non presenta uno spinguida. | 25x0,8=20<br>il KIT di microintroduzione presenta: una rastrematura che risulta meno performante durante l'inserimento, inoltre non presenta uno spinguida. | 25                |
| Visibilità della Marcatura per tutta la lunghezza del catetere, ogni centimetro nella parte distale/ tacca visiva | D    | 10x1=10   | 10x1=10    | 10x1=10   | 10x1=10   | 10                |
| Facilità di apertura della confezione in sterilità  | D    | 5x1=5   | 5x1=5      | 5x1=5   | 5x1=5   | 5                 |

*[Handwritten signature]*

|                  |  |      |    |    |    |    |
|------------------|--|------|----|----|----|----|
| PUNTEGGIO TOTALE |  | 77,5 | 80 | 75 | 75 | 80 |
|------------------|--|------|----|----|----|----|

**LOTTO 10 CATETERE VENOSO MIDLINE**

Misure richieste bilume 4 e/o 5 Fr, lunghezza compresa tra 16-25 cm

| Operatore Economico  | Rispetto requisiti minimi |  |
|--|---------------------------|--|
| PL1 HEALTH<br>101.67.09.24<br>101.67.09.25<br>101.67.10.24<br>101.67.10.25 | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| SEDA<br>MLCT5D20-S   | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| TELEFLEX<br>EU32052  | NO                        | Non risponde ai requisiti previsti da capitolato tecnico in merito alla Direttiva 32/2010 per ago con meccanismo di sicurezza. |

| CRITERI DI QUALITA' LOTTO 10  | TIPO | PL1 HEALTH | SEDA  | PUNTEGGIO MAX |
|---|------|------------|---|---------------|
| Finitura dei materiali  | D    | 20x1=20    | 20x1=20   | 20            |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia/maneggevolezza  | D    | 20x1=20    | 20x1=20   | 20            |
| Qualità del kit di microintroduzione  | D    | 25x1=25    | 25x0,8=20<br>il KIT di microintroduzione presenta: una rastrematura che risulta meno performante durante l'inserimento, inoltre non presenta uno spinguida. | 25            |
| Visibilità della Marcatura per tutta la lunghezza del catetere, ogni centimetro nella parte distale/ tacca visiva | D    | 10x1=10    | 10x1=10   | 10            |
| Facilità di apertura della confezione in sterilità  | D    | 5x1=5      | 5x1=5   | 5             |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>   |      | <b>80</b>  | <b>75</b>   | <b>80</b>     |



**LOTTO 11 KIT PROCEDURALI**


| Operatore Economico       | Rispetto requisiti minimi | Requisiti minimi   |
|---------------------------|---------------------------|--|
| HARTMANN<br>Combiset      | NO                        | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico:<br>a) incongruenza tra dimensione aghi tra campionatura e scheda tecnica;<br>b) dichiarata in scheda tecnica la presenza di ago ipodermico 23Gx32mm anziché 22Gx30;<br>c) medicazione trasparente adesiva di dimensioni diverse rispetto a quanto dichiarato in scheda tecnica.  |
| MEDIBERG<br>800411AHGSMEB | NO                        | Incongruenza tra campionatura presentata e scheda tecnica, in merito alla lunghezza dell'ago ipodermico da 22G che risulta di 40 mm anziché 30mm. Inoltre non è possibile valutare le caratteristiche della medicazione trasparente in quanto non possibile risalire alla tipologia del dispositivo, attesa l'assenza del ref o codice identificativo del prodotto sull'involucro/etichetta descrittiva oltre che da scheda tecnica      |
| VIGON<br>A8019915824      | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| BETATEX<br>SE0992SE       | NO                        | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito alla composizione del coprisonda ecografico richiesto in polietilene (PE) e non in poliuretano, come dichiarato in scheda tecnica.  |
| Artro<br>Ref 01-001-01    | NO                        | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in quanto il coprisonda presenta una lunghezza di 60 cm e non di 120 come dichiarato in scheda tecnica. Inoltre, la medicazione richiesta non è trasparente.  |
| DELTAMED<br>10.18681.00   | NO                        | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito alla composizione del coprisonda ecografico richiesto in polietilene (PE) e non in poliuretano come dichiarato in scheda tecnica.<br>Inoltre, la campionatura presentata non consente una corretta procedura sterile poiché cuffia e mascherina non sono d prima presa ,in quanto allocate all'interno del kit e non nella parte superiore del custom pack. |

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| medline<br>1502049-3 | NO | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico, in quanto dalla documentazione allegata non è possibile risalire alla composizione del coprisonda ecografico. |
|----------------------|----|---|

| CRITERI DI QUALITA' LOTTO 11  | TIPO | VIGON   | PUNTEGGIO MAX |
|---|------|---------|---------------|
| Qualità dei dispositivi contenuti nel kit:  |      |         |               |
| dispositivi indossabili dall'operatore (confort, qualità del materiale, resistenza,... )  | D    | 20X1=20 | 20            |
| dispositivi per la preparazione del campo sterile (assorbenza, tenuta termica, adesività nei punti di accesso, facilità di posa,... ) | D    | 30X1=30 | 30            |
| altri dispositivi contenuti nel kit   | D    | 10X1=10 | 20            |
| Facilità di apertura della confezione   | D    | 10x1=10 | 10            |
| PUNTEGGIO TOTALE  |      | 80      | 80            |

**LOTTO 12 KIT COPRISONDA TUBULARE PER SONDA ECOGRAFICA PER L'IMPIANTO DI CATETERI PICC E MIDLINE**

| Operatore Economico           | Rispetto requisiti minimi | Requisiti minimi   |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| MEDLINE<br>ICE5920<br>ICE5900 | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |
| VYGON<br>80199.541            | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |
| BETATEX<br>REF. MTK0602/MD    | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |
| CARBINI<br>PC1290EU           | SI                        | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico |

**LOTTO 13 NEEDLE CONNECTOR**

| <b>Operatore Economico</b> | <b>Rispetto requisiti minimi</b> | <b>Requisiti minimi</b>  |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| BD<br>MZ1000               | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| CAIR<br>EL 200             | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| CODAN<br>A1010N            | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| FASE<br>TD-48              | NO                               | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito al numero di attivazioni richiesto.                               |
| TAU<br>Ref. A1010N         | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| BENEFIS<br>FL 0527 N       | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| CLINILAB<br>PROMNIA LOCK   | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| DELTAMED<br>3003315        | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| FRESENIUS<br>M79400849Y    | NO                               | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico, in quanto la camera non è trasparente come richiesto da capitolato tecnico |

Handwritten signatures and a page number '11'.

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| POLYMED          | NO | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito al numero di attivazioni richiesto. |
| VYGON<br>898.038 | NO | Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito allo spazio morto.                  |

| Criteri di qualità lotto 13   | TIPO | CAIR    | CODAN   | BD   | TAU MEDICA  | BENEFIS  | CLINILAB   | DELTAMED   | PUNTEGGIO MAX |
|---|------|---------|---|--|---|--|--|--|---------------|
| Finitura dei materiali  | D    | 20X1=20 | 20X1=20   | 20X1=20  | 20X1=20   | 20X1=20  | 20X1=20  | 20X1=20  | 20            |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia maneggevolezza (aggancio e sgancio) | D    | 25x1=25 | 25X0,6=15<br>La filettatura rende più difficile la connessione alle linee infusionali | 25   | 25X0,6=15<br>La filettatura rende più difficile la connessione alle linee infusionali | 25x1=25  | 25x1=25  | O<br>Non è stato possibile effettuare la valutazione in quanto il campione non è pervenuto | 25            |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di confort per il paziente                       | D    | 15x1=15 | 15x0,8=12<br>Il maggiore ingombro non consente un confort ottimale per il paziente    | 15x0,8=12<br>Il maggiore ingombro non consente un confort ottimale per il paziente | 15x0,8=12<br>Il maggiore ingombro non consente un confort ottimale per il paziente    | 15x1=15  | 15x0,8=12<br>Il maggiore ingombro non consente un confort ottimale per il paziente | O<br>Non è stato possibile effettuare la valutazione in quanto il campione non è pervenuto | 15            |
| Superficie esterna facilmente disinfettabile  | D    | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5  | 5x1=5   | 5x0,6=3<br>presenta uno scalino marcato che non consente una ottimale disinfezione | 5x1=5  | O<br>Non è stato possibile effettuare la valutazione in quanto il campione non è pervenuto | 5             |
| Minimo spazio morto interno   | P    | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5  | 5x1=5   | 5x1=5  | 5x1=5  | 5x1=5  | 5             |

*Am* *Se*

|                       |   |         |      |        |      |      |    |      |    |
|-----------------------|---|---------|------|--------|------|------|----|------|----|
| Numero di attivazioni | P | 10X1=10 | 7,5  | 8,125  | 7,5  | 7,5  | 5  | 7,5  | 10 |
| PUNTEGGIO TOTALE      |   | 80      | 64,5 | 75,125 | 64,5 | 75,5 | 72 | 32,5 | 80 |

**LOTTO 14 COLLA PER DISPOSITIVI**

|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>JOHONSON &amp; JOHONSON<br/>DERMABOND</b> | NO | Il quantitativo per singola dose è > anche considerando la tolleranza di o, 1 ; il tempo di polimerizzazione è > di quanto richiesto da capitolato tecnico. |
| <b>MEDIVAL<br/>Liquiband ref AMOPT00XVA</b>  | SI | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato  |
| <b>PLAIN 1 HEALT<br/>MERIGLUTM</b>           | NO | Non viene dichiarato il tempo di polimerizzazione come richiesto da capitolato ed il quantitativo è > di quanto richiesto da capitolato tecnico             |

**LOTTO 15 TAUROLIDINA 2% FL da 3 ml**

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>MEDIVAL<br/>NUTRILOCK TLPT 07.3</b> | SI | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato |
|--|----|--|


**LOTTO 16 TAUROLIDINA 2% FL da 6 ml -DESERTO**

**LOTTO 17 TAUROLIDINA 1.35% + CITRATO al 4%FL da 3 ml –**

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>MEDIVAL<br/>TAUROLOCK TLPT 01.3</b> | SI | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato |
|--|----|--|

**LOTTO 18 CAVO ECG UNIVERSALE**

|                                     |    |   |
|-------------------------------------|----|---|
| <b>SEDA CAVO PER ECG<br/>F7835C</b> | NO | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: il prodotto offerto non presenta un idoneo sistema di collegamento al catetere port ed inoltre non è idoneo nei CVC esterni per valutazione post impianto. Non adattabile a tutti i monitor. |
|-------------------------------------|----|---|

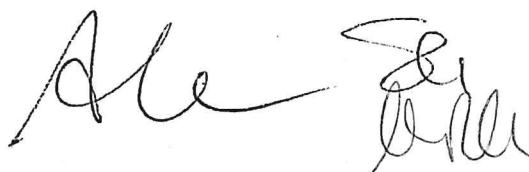

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| <b>TELEFLEX</b><br><b>CAVO PER ECG</b><br><b>EK-04730-BA</b> | <b>NO</b> | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: il prodotto offerto non presenta un idoneo sistema di collegamento al catetere port ed inoltre non è idoneo nei CVC esterni per valutazione post impianto. Non adattabile a tutti i monitor. |
|--|-----------|---|

**LOTTO19 SONDAVESCICALE FOLEY DUE VIE IN LATT. SILICONATO 12-14-16-18-20-22Fr**

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| <b>FASE</b><br><b>CFNL-2D-12-10-P</b><br><b>CFNL-2D-14-10-P</b><br><b>CFNL-2D-16-10-P</b><br><b>CFNL-2D-18-10-P</b><br><b>CFNL-2D-20-10-P</b><br><b>CFNL-2D-22-10-P</b> | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>CARBINI</b><br>11601322121<br>11601322141<br>11601322161<br>11601322181<br>11601322201<br>11601322221<br>11601322241   | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>CLINI LAB</b><br>FF01A021208 (CH12)<br>FF01A021408 (CH14)<br>FF01A021608 (CH16)<br>FF01A021808 (CH18)<br>FF01A022008 (CH20)<br>FF01A022208 (CH22)                    | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>FARMAC-ZABBAN</b><br>2803131001<br>2803131002<br>2803131003<br>2803131004<br>2803131005<br>2803131006  | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>MEDLINE</b><br>662012<br>662014<br>662016<br>662018<br>662020<br>662022  | <b>NO</b> | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico: il prodotto non è completamente in lattice siliconato |
| <b>TELEFLEX</b><br>189205<br>189305   | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico   |

| CRITERI DI QUALITA' lotto 19   | TIPO | FASE  | CARBINI   | CLINILAB  | FARMAC ZABBAN   | TELEFL EX | PUNTEGGI O MAX |
|--|------|---|---|---|---|-----------|----------------|
| Qualità e finitura del materiale e della manifattura   | D    | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23             |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza   | D    | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23x1=23   | 23             |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente (tenuta della connettività e facilità di introduzione) | D    | 24X0,6=14,4 presenta un involucro esterno che protegge la valvola di facile rimozione | 24X0,6=14,4 presenta un involucro esterno che protegge la valvola di facile rimozione | 24X0,6=14,4 presenta un involucro esterno che protegge la valvola di facile rimozione | 24X0,6=14,4 presenta un involucro esterno che protegge la valvola di facile rimozione | 24        | 24             |
| Completezza e leggibilità dell'etichetta   | D    | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5     | 5              |
| Ampiezza della gamma di misure   | P    | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5     | 5              |
| PUNTEGGIO TOTALE   |      | 70,4  | 70,4  | 70,4  | 70,4  | 80        | 80             |

**LOTTO 20 SONDAVESCICALE FOLEY A DUE VIE IN LATTICE SILICONATO 6 Fr**

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| FASE<br>CFNL-2D-06-03-P     | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
| CARBINI<br>11601312061      | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
| FARMAC-ZABBAN<br>2803130901 | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
| MEDLINE<br>661006           | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |

| CRITERI DI QUALITA' lotto 20 | TIPO | FASE | CARBINI | FARMAC ZABBAN | MEDLINE | PUNTEGGIO MAX |
|------------------------------|------|------|---------|---------------|---------|---------------|
|------------------------------|------|------|---------|---------------|---------|---------------|

|  |   |           |   |   |   |           |
|--|---|-----------|---|---|---|-----------|
| Qualità e finitura del materiale e della manifattura   | D | 23x1=23   | 23X1=23   | 23x1=23   | 23X1=23   | 23        |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza   | D | 23x1=23   | 23X0,6=13,8<br>il mandrino morbido e flessibile non garantisce la rigidità del catetere durante l'inserimento | 23X0,6=13,8<br>il mandrino morbido e flessibile non garantisce la rigidità del catetere durante l'inserimento | 23X0,6=13,8<br>il mandrino morbido e flessibile non garantisce la rigidità del catetere durante l'inserimento | 23        |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente (tenuta della connettività e facilità di introduzione) | D | 24x1=24   | 24x1=24   | 24x1=24   | 24x1=24   | 24        |
| Completezza e leggibilità dell'etichetta   | D | 5x1=5     | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5         |
| Ampiezza della gamma di misure   | P | 5x1=5     | 5x1=5   | 5x1=5   | 5x1=5   | 5         |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>  |   | <b>80</b> | <b>70,8</b>   | <b>70,8</b>   | <b>70,8</b>   | <b>80</b> |

**LOTTO 21 SONDA PETZER IN LATTICE 10-12-14-16-18-20-22-24-16-30-32-34-36 Fr Aggiudicazione 80%**

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>FASE</b><br>CP-12-40<br>CP-14-40<br>CP-16-40<br>CP-18-40<br>CP-20-40<br>CP-22-40<br>CP-24-40<br>CP-26-40<br>CP-28-40<br>CP-30-40<br>CP-32-40<br>CP-34-40<br>CP-36-40 | si | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
|---|----|---|





**LOTTO 22 –DESERTO SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO DELLA VESCICA PEDIATRICO  
SET DI SOSTITUZIONE DRENAGGIO**

**LOTTO 23 SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA TIPO NEONATALE**

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| TELEFLEX<br>340012-000060 | NO | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico |
|---------------------------|----|--|

**LOTTO 24 SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA TIPO PEDIATRICO**


|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| TELEFLEX<br>340012-000080 | No | Mancanza di caratteristiche di minima richieste dal capitolato tecnico |
|---------------------------|----|--|

**LOTTO 25 TAPPO UNIVERSALE PER CATETERE VESCICALE**

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| FASE                        | NO | Non soddisfa le necessità aziendale Non è dotato di una impugnatura che facilita le manovre di introduzione e rimozione dello stesso |
| CARBINI<br>11201102001      | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico  |
| FARMAC-ZABBAN<br>2803490100 | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico  |
| BENEFIS<br>23800111         | NO | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico  |

**LOTTO 26 SISTEMA PRECONNESSO PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A MEDIA/LUNGA PERMANENZA E SACCHE SATELLITE misure 14-16-18-20**

|   |    |   |
|---|----|---|
| TELEFLEX<br>851086-000140<br>851086-000160<br>851086-000180<br>851086-000200<br>673045-002000 | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
| CARBINI<br>0100112E21CA<br>0100112E21CB<br>0100112E21CC                                       | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |

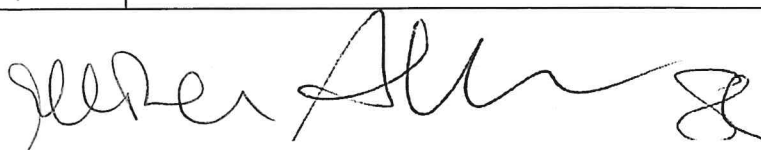

|   |    |   |
|---|----|---|
| 0100112E21CD<br>0100112E21CE<br>008019017107                                  |    |   |
| MEDITREND<br>F04B031410<br>F04B031610<br>F04B031810<br>F04B032010<br>2260B003 | SI | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |
| CLINILAB<br>F04B031410<br>F04B031610<br>F04B031810<br>F04B032010<br>SS010.C   | Si | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico |

| CRITERI DI QUALITA' lotto 26  | TIPO | TELEFLEX   | CARBINI  | MEDITREND | CLINILAB | PUNTEGGIO MAX |
|---|------|------------|----------|-----------|----------|---------------|
| Finitura dei materiali costituenti il catetere  | D    | 20x1=1     | 20x1=1   | 20x1=1    | 20x1=1   | 20            |
| Ergonomia e maneggevolezza del dispositivo  | D    | 20x1=1     | 20x1=1   | 20x1=1    | 20x1=1   | 20            |
| Tenuta della connessione catetere-sacca   | D    | 10x1=1     | 10x0,6=6 | 10x1=10   | 10x0,7=7 | 10            |
| Disponibilità di misure aggiuntive del calibro del catetere (ulteriori rispetto a quelle richieste)   | T    | 0          | 5        | 5         | 5        | 5             |
| Lunghezza del tubo antingnocchiamento (massimo punteggio all'offerta con lunghezza del tubo maggiore) | P    | 5          | 3,75     | 3,75      | 5        | 5             |
| Modalità di confezionamento delle sacche satellite  | D    | 5x1=5      | 5x1=5    | 5x1=5     | 5x1=5    | 5             |
| Tenuta del sistema di aggancio al letto del paziente  | D    | 5x1=55x1=5 | 5x1=5    | 5x1=5     | 5x1=5    | 5             |

*Alu* *Se* *Ille*

|                                   |   |       |       |       |       |    |
|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|----|
| Scala di graduazione sacca:       |   |       |       |       |       |    |
| Chiarezza e leggibilità           | D | 5x1=5 | 5x1=5 | 5x1=5 | 5x1=5 | 5  |
| Presenza di doppia scala graduata | T | 5x1=5 | 5x1=5 | 5x1=5 | 5x1=5 | 5  |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>           |   | 75    | 74,75 | 78,75 | 77    | 80 |

**LOTTO 27 SISTEMA PRECONNESSO PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A BREVE PERMANENZA misure 14-16-18-20**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>MEDITREND</b><br>F04B033610<br>F04B033810<br>F04B034210<br>F04B034410<br>2260B003                           | <b>NO</b> | Non rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico, per mancanza della camera gocciolamento, mancanza della valvola antireflusso nel catetere e del filtro antibatterico.   |
| <b>CARBINI</b><br>0100111C22BA<br>0100111C22BB<br>0100111C22BC<br>0100111C22BD<br>0100111C22BE<br>008019017107 | <b>NO</b> | Non rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico per la mancanza del filtro antibatterico.  |
| <b>CLINI LAB</b><br>F04B033410<br>F04B033610<br>F04B034010<br>F04B034210<br>SS010.C                            | <b>SI</b> | Rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico. Non disponibile il numero di repertorio in quanto in fase di registrazione.   |
| <b>TELEFLEX</b><br>181100-000140<br>181100-000160<br>181100-000180<br>181100-000200<br>673045-002000           | <b>NO</b> | Non rispondenza ai requisiti minimi richiesti da capitolato tecnico nello specifico: punto di prelievo senz'ago, clamp fissaggio e piastrina stringitubo, camera di gocciolamento e valvola antireflusso. Inoltre manca il sistema di aggancio letto che risulta dichiarato in scheda tecnica. |

| <b>CRITERI DI QUALITA' lotto 27</b>            | <b>TIPO</b> | <b>CLINILAB</b> | <b>PUNTEGGIO MAX</b> |
|--|-------------|-----------------|----------------------|
| Finitura dei materiali costituenti il catetere | D           | 20              | 20                   |
| Ergonomia e maneggevolezza del dispositivo     | D           | 20              | 20                   |



|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| Tenuta della connessione catetere-sacca  | D | 10x1=10   | 10x1=10   |
| Disponibilità di misure aggiuntive del calibro del catetere (ulteriori rispetto a quelle richieste)  | T | 5         | 5         |
| Lunghezza del tubo antingocchiamento (massimo punteggio all'offerta con lunghezza del tubo maggiore) | P | 5x1=5     | 5x1=5     |
| Modalità di confezionamento delle sacche satellite   | D | 5x1=5     | 5x1=5     |
| Tenuta del sistema di aggancio al letto del paziente   | D | 5x1=5     | 5x1=5     |
| Scala di graduazione sacca:  | : |           |           |
| Chiarezza e leggibilità  | D | 5x1=5     | 5x1=5     |
| Presenza di doppia scala graduata  | T | 5         | 5         |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>  |   | <b>80</b> | <b>80</b> |

**LOTTO 28 KIT MEDICAZIONE STERILE PER INSERIMENTO CATETERE VESCICALE**

| <b>Operatore Economico</b>          | <b>Rispetto requisiti minimi</b> |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>MEDIBERG<br/>712002AHGNMED</b>   | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico   |
| <b>TELEFLEX<br/>MET 850450</b>      | NO                               | Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico. Il gel lubrificante è contenuto in una bustina che non consente l'introduzione del gel lubrificante in uretra, come richiesto da capitolato tecnico, anche se presenta una siringa vuota. |
| <b>FARMAC ZABBAN<br/>1412000134</b> | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| <b>CAM HOSPITAL<br/>ME-UR-058</b>   | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |
| <b>PAUL HARTMANN<br/>ME-UR-005</b>  | SI                               | Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico.  |

Letto, confermato e sottoscritto

Dr.ssa Maria Pia Musa

Dr. Antonio Potere

Dr.ssa sara Colangelo

*Maria Pia Musa*  
*Antonio Potere*  
*Sara Colangelo*

Pescara 29/10/2024

18/12/2024

*[Signature]*