



Azienda Sanitaria Locale **PESCARA**
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – HTA
Via Renato Paolini, 47 – 65126 PESCARA (PE)
Tel. 085.4253109 – ingegneriaclinica@asl.pe.it
Direttore: Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Mod. 01/IC
Rev. 01 del 17/10/2024
"Verbale di Accettazione e Collaudo
di Apparecchiatura Elettromedicale"

VERBALE DI COLLAUDO

ID COLLAUDO IC114/25 DATA 23/06/2025

RIF. PRATICA

PRESIDIO: PESCARA U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
N° DETERMINA/DELIBERA: 1428 HTA del 16/04/25 N° ORDINE 20-2025-64 del 08/04/25
Ditta Fornitrice : DRAGER ITALIA SPA Rif. DDT : 0176651173 DEL 09/05/25
Note: _____

ID. APPARECCHIATURA/E E ACCESSORI/COMPONENTI

TIPOLOGIA	MARCA	MODELLO	NUMERO DI SERIE	CODICE AEM
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0075	E015539
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0076	E015540
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0077	E015541
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0078	E015542

Note: _____

CAUSALE ACQUISIZIONE: ACQUISTO SERVICE NOLEGGIO COMODATO DONAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Durata Periodo di Garanzia: 12 mesi Data Scadenza Garanzia : 22 / 06 / 2026
Durata Service Noleggio Comodato: _____ Data Scadenza : _____
Importo complessivo della fornitura IVA INCLUSA: € 63.000,00 (corrispondente all' Ordinativo Economico ASL)

VERIFICHE VISIVE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative effettuate, si dichiara che la fornitura e pertanto le relative apparecchiature/strumenti/dispositivi ed eventuali accessori e/o componenti risulta/risultano:

- CONFORMITÀ BOLLA DI CONSEGNA CON ORDINATIVO ECONOMICO SI NO
- CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO CON IL DDT SI NO
- ASSENZA DANNI ESTERNI DELL'APPARECCHIATURA E/O ACCESSORI-COMPONENTI SI NO
- CORRISPONDENZA ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SI NO
- FUNZIONANTE/I ED IDONEA/E ALL'USO PREVISTO SI NO
- VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SUPERATA (CEI EN 62353) SI NO
- PRESENZA MANUALI D'USO IN LINGUA ITALIANA (depositato presso U.O. di ubicazione) SI NO
- PRESENZA CERTIFICATI CE E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' SI NO
- PERSONALE SANITARIO/TECNICO ADDESTRATO E FORMATO ALL'UTILIZZO SI NO

Note: _____

ESITO COLLAUDO

L'ESITO DEL COLLAUDO È DA RITENERSI

- POSITIVO POSITIVO CON RISERVA NEGATIVO

Note: _____

Per accettazione e conferma

Il Responsabile della U.O. assegnataria o delegato

ERANUO BRONNI [Firma] 18/06/25
Name e Cognome Timbro e Firma Data di convalida

Il Referente Ditta Fornitrice e/o Specialist

MAURIZIO MANUCCI [Firma] 18/06/25
Name e Cognome Firma Data di convalida

Il Referente S.I.C.E. (Servizio Ingegneria Clinica Esterno)

ALFONSO BASILAMO [Firma] 18/06/25
Name e Cognome Firma Data di convalida
SIEMENS H.C. HOSPITAL CONSULTING INFARMASMA SPA
ING. P. U. S. L. PESCARA
Via Paolvi, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Il Resp. Impianto Radiologico e/o _____

[Firma] 1/1/1
Name e Cognome Firma Data di convalida

L'Esperto Specialista (EQ-ER-ASL-altro)

[Firma] 1/1/1
Name e Cognome Firma Data di convalida

Altra figura:

[Firma] 1/1/1
Name e Cognome Firma Data di convalida

Il DEC o Assistente al DEC (Direttore Esecuzione Contratto)

[Firma] 1/1/1
Name e Cognome Firma Data di convalida

Validazione definitiva esito procedura di collaudo con conferma data di inizio accettazione del bene

Il Collaudatore U.O.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA

DI LANZO CLAUDIA [Firma] 23/06/2025
Name e Cognome Firma Data di convalida
ASL PESCARA
UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA
IL COLLAUDATORE
Ing. Claudia DI LANZO

Allegati: Scheda Collaudo SICE Rapporto Tec. Ditta Fornitrice Ddt Ordinativo Economico Documentazione Tecnica
 Certificati CE/Dich. Conformità Verifiche Sicurezza Elettrica _____

Note: _____

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE Draeger Italia S.p.a. Non disponibile

OFFERTA/RDO N° _____ DEL: _____ Non disponibile

ORDINE N° HTA 20-2025-04 DEL: 08.04.2025 Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° DETERMINA HTA 1428 DEL: 18.04.2025 Non disponibile

DDT N° 0170651173 DEL: 09.05.25 Non disponibile

N° _____ DEL: _____ Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 60.000,00 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; AGGIORNAMENTO TRAMITE REPAIR EXCHANGE

STRUTTURA: PO DI PESCARA **REPARTO:** GRUPPO OPERATORIO ANESTESIA E RIAN.

PADIGLIONE: PE **PIANO:** TERRA **STANZA:** DEGENZA

CDC: C08C01C00 **DESCRIZIONE CDC:** UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGICA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E015539	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0075		€ 15.000,00
	E015540	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0076		€ 15.000,00
	E015541	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0077		€ 15.000,00
	E015542	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	V600	ASUD-0078		€ 15.000,00

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID: _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID: _____ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 18.06.25 [OK] [KO] [NA] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 4 - SCHEDA APPARECCHIO

DA E015539 A E015542

ID (tabella sezione 2): _____ Codice Apparecchio: _____ Key number: _____
 Configurazione: Singolo; [] A sistema: alimentato da altro apparecchio; [] A sistema: alimentato dalla rete Codice padre: _____
 Importo delibera di acquisto: 60.000,00 + IVA Importo singolo apparecchio [NA]
 Anno di fabbricazione: 2015 Numero repertorio: _____ [NA]
 Effettuata Fotografia: [NA] CND: _____ [NV]

Accessori forniti con l'apparecchio:

N°	Descrizione	Quantità	Part number	S/N-Lotto
1				
2				
3				
4				

Manuale Utente: Rev _____ Data: _____ Lingua: [] Italiano; [KO]
 Manuale Service: Rev _____ Data: _____ Lingua: [OK] [KO] [NA]

Dichiarazione di conformità: MDD 93/42; [] MDR 2017/745; [] IVDD 98/79; [] IVDR 2017/746; [] si allega
 Classe di rischio apparecchio: _____ [NA] Certificato CE (MD/IVD): [OK] [KO] [NA] si allega
 UDI: _____ [NA]

Release Software e data: _____ [NA] Lingua interfaccia software: _____
 Indirizzo IP: _____ Gateway: _____ Server address: _____ MAC address: _____
 Fornite password specifiche: _____ [OK] [NA] [NV]

Normativa/e di riferimento: _____

Check list manutenzione preventiva: _____ [OK] [KO] [NA] [] si allega
 Periodicità manutenzione preventiva: _____ [] si allega
 Altra documentazione: _____

Installazione del bene in accordo alle prescrizioni del fabbricante: _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Adeguatezza alimentazione (elettrica (TN, IT-M), idraulica, pneumatica etc): _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Assenza di adattatori, prese multiple e prolunghe: _____ [OK] [KO] [NA]
 Locale in cui è stato eseguito il collaudo (se diverso dal campo stanza): _____

Allegata Lista parti di ricambio (Spare Parts): _____ [OK] [NA] [NV]

(Se diverso per ogni apparecchio, altrimenti vedi sezione 6)
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 18.05.25 Data fine garanzia: 17.06.26
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk _____
 [] Kit Manutenzione _____
 [] Materiale di consumo _____; [NA]

SEZIONE 5 - VERIFICHE TECNICHE

Verifica di sicurezza elettrica effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; [] fabbrica [KO] [NA] [] si allega
 Verifica funzionale effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; [] fabbrica [KO] [KO] [NA] [] si allega
 Verifica sicurezza elettrica (eventuale PP) effettuata da IIC: sul luogo di installazione; [] laboratorio [KO] [NA] [] si allega
 Codice richiesta VSE: _____ Altri controlli: _____

Note

Questo pacchetto di 4 nuovi ventilatori polmonari sostituiscono nella forma quanto nella sostanza altri 4 ventilatori polmonari, ormai obsoleti,
 i cui inventari sono lo seguenti: 43588,43592,43590,43598, che nei prossimi giorni o settimane la Draeger si incaricherà di ritirare o smaltire.

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione _____
 Data: 18.06.25
 Nome Cognome: _____ Firma: _____
 Nome Cognome: Enrico Baccani Firma: _____
 Nome Cognome: _____ Firma: _____
 Note: _____

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: N. TAMMONE Data: 18.06.25 Firma: _____
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 18.06.25 Data fine garanzia: 18.06.26
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [x] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk
 [] Kit Manutenzione
 [] Materiale di consumo _____ :[NA]

Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO ALFONSO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: BALZANO Data: 18.06.25

A.T.I.
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 U.S.L. PESCARA
 Via Padova, 47 - 66124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

VSE ESEGUITA DAL MS FEDERICA GIULIANI

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]

Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____ [OK] [KO] [] si allega

Note: _____

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 [] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 [] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 [x] Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alle specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO – Nome Cognome: _____ Data: 18.06.25 Timbro e Firma: _____
 NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

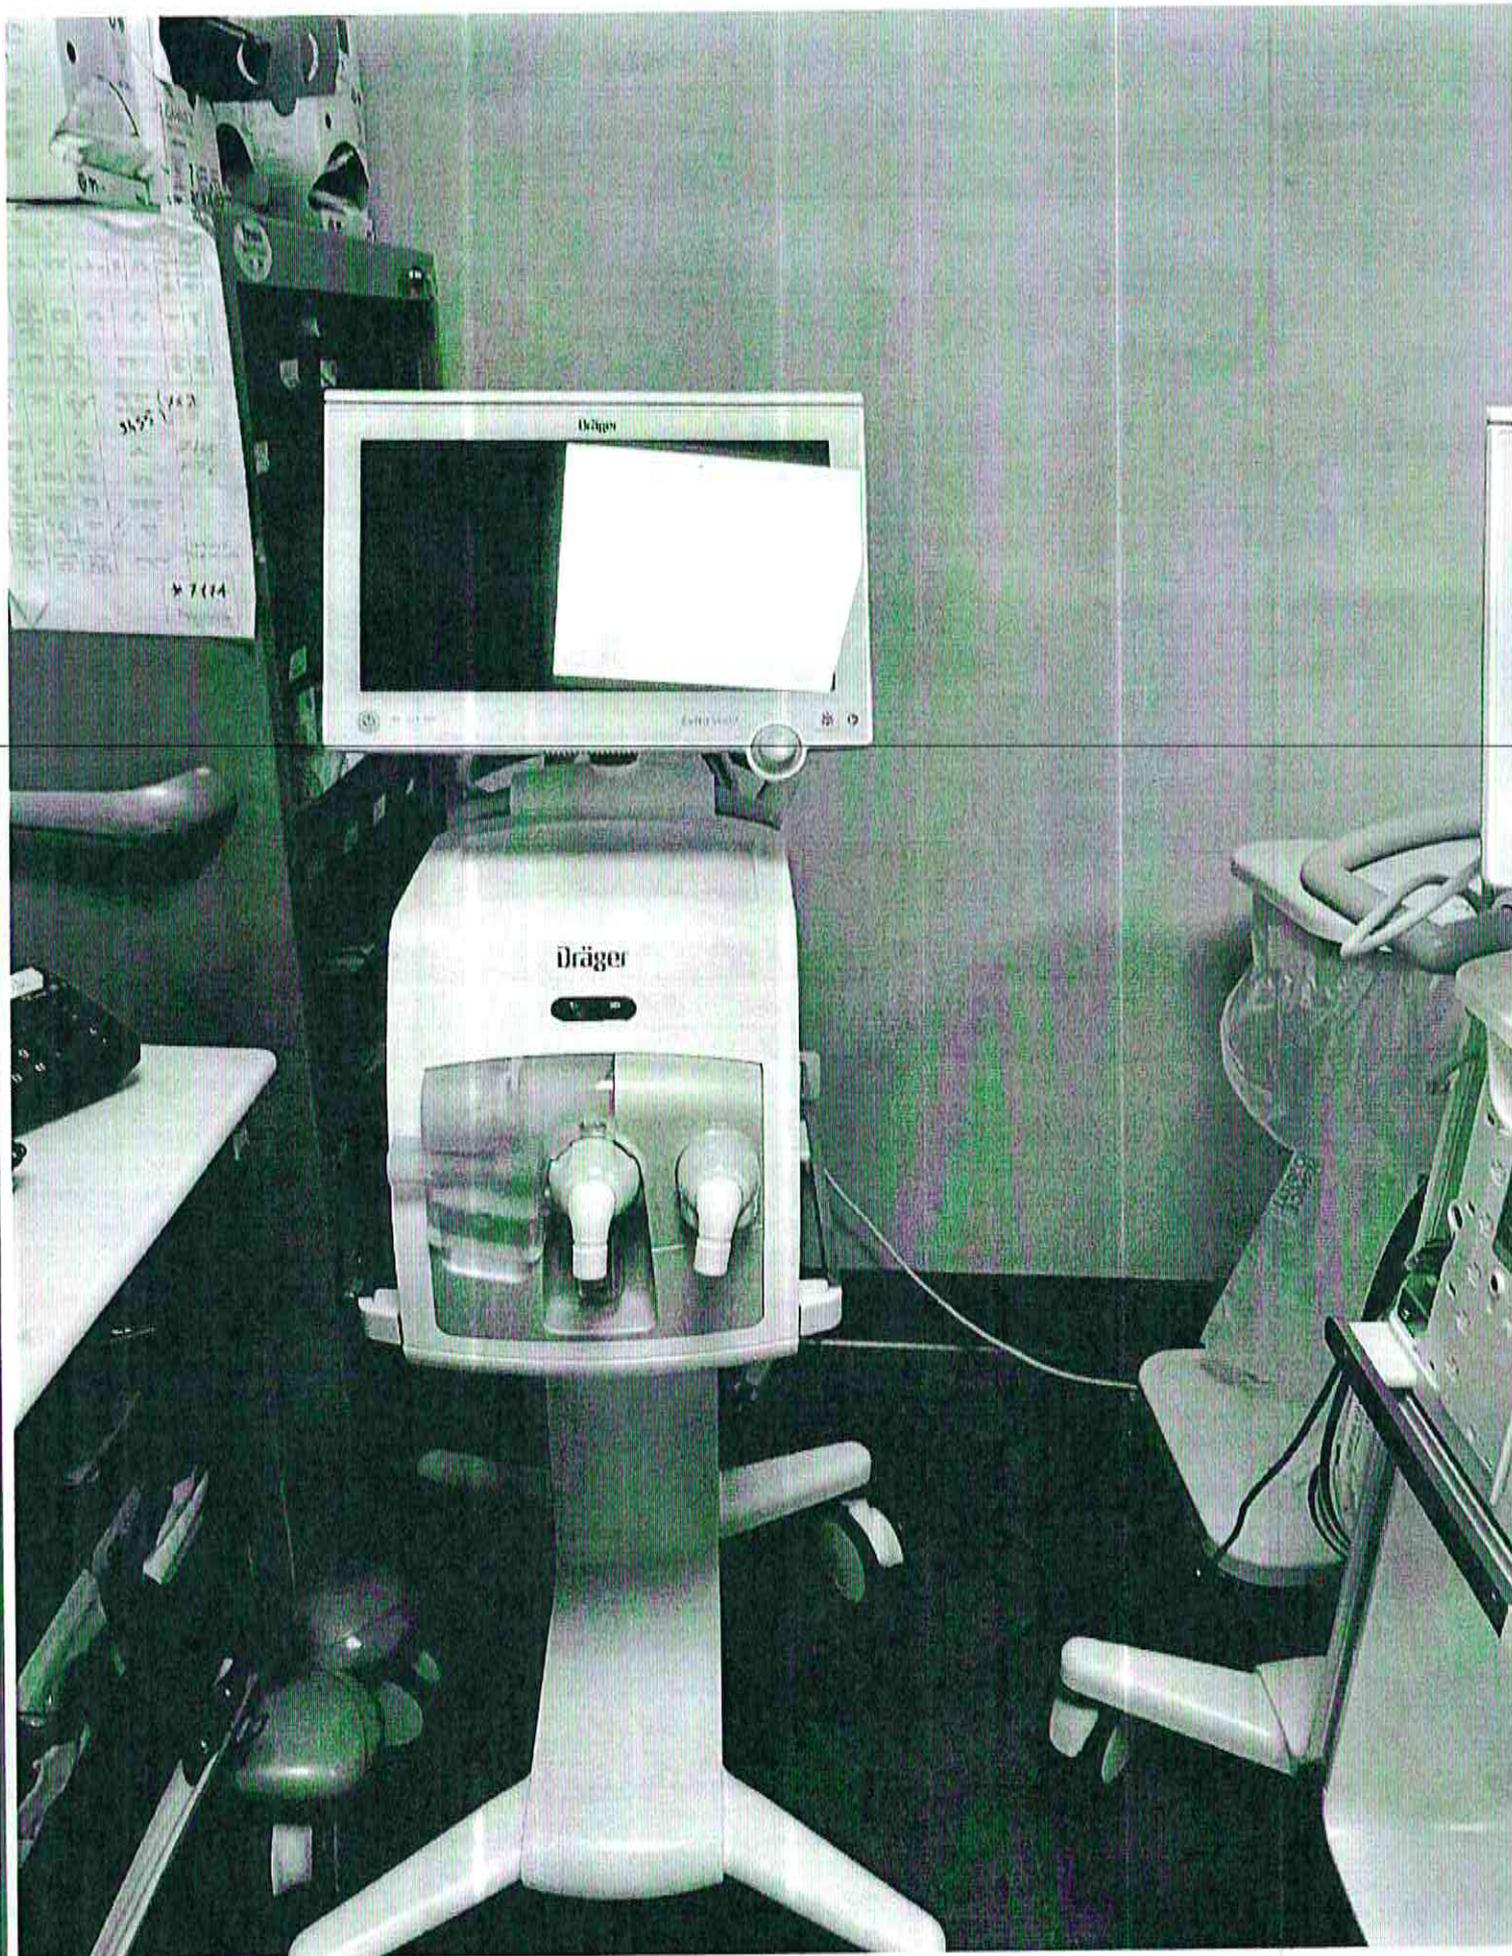
ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: DI LANZO C. Data: 23/06/2025 Timbro e Firma: _____

ASL PESCARA
UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA
IL COLLAUDATORE
Ing. Claudia Di LANZO

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli più significativi che è stato possibile effettuare



Installazione

Codice Cliente no. 0091038936 Contratto

Chiamata no. T00950377

Data intervento 18/06/2025

Intervento effettuato presso (0091036554)

Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata

20-2025-64 (GAR. 12 MESI)

Contatto:

Cliente Indirizzo (0091038936)

AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Referente tecnico

Maurizio Marinucci

Tel.:

Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Pos.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Motivo della chiamata
010	Evita V600 Software: 02.01.00	- ASUD-0075 8422300		Installation
		Data di esecuzione: 18/06/2025 INSTALLAZIONE E COLLAUDO ACQUISTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI N°1 EVITA XL. GARANZIA 12 MESI.		
010-1		Quant. 1,00 Ora	Articolo no. S001	Descrizione Installazione (18/06/2025)
010-2		1,00 Pezzo	M35417	010-2 Tubo Connessione O2 AFNOR (18/06/2025)
010-3		1,00 Pezzo	M35421	010-3 Tubo Aria 3m NIST EN NF (18/06/2025)

L'esito positivo del presente verbale riconnesso alle attività descritte e riportate, attesta/certifica ad ogni effetto di ragione e di legge in base alla miglior pratica tecnico/scientifica richiesta nel settore specifico di intervento che l'attrezzatura in argomento è stata installata a regola d'arte e deve ritenersi -conseguentemente- efficiente ed idonea a garantire il funzionamento in modo conforme alla propria destinazione d'uso.

L'utilizzazione dell'apparecchiatura oggetto di verifica e collaudo deve ritenersi riservato e consentito a personale medico abilitato e dotato delle conoscenze, delle abilità e delle capacità riconnesse/collegate alla formazione ricevuta nell'ambito di attività organizzate dalla struttura di Draeger Italia S.p.A. (corsi e sessioni istruttive e formative).

Posto che Draeger Italia S.p.A. riserva piena disponibilità a dette attività, quest'ultimo non assumerà e non potrà essere soggetto passivo di ogni forma di responsabilità per qualsivoglia danno e/o pregiudizio cagionato e/o causato dall'utilizzazione impropria, scorretta e/o imperita delle apparecchiature, ovvero dall'utilizzazione da parte di personale non abilitato e/o privo della formazione e delle conoscenze derivanti dalle attività formative assicurate da Draeger Italia S.p.A. e dalla sua struttura.

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48002404

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg. Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0802000003729
Reg. P.I.E. IT09060P00001299

Installazione

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950377

Data intervento
18/06/2025

La Draeger Italia S.p.A. garantisce e precisa altresì che:

- il personale utilizzatore è stato informato in merito ad ogni condotta/comportamento necessario ad assicurare la corretta utilizzazione della strumentazione consegnata, con espressa inclusione degli accessori;
- è stato regolarmente consegnato il manuale d'uso contenente la descrizione delle modalità e delle procedure operative necessarie per garantire ed assicurare l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura/della strumentazione in oggetto.

Resta inteso che qualsivoglia forma di garanzia dovrà considerarsi irrimediabilmente decaduta ed inefficace, qualora all'apparecchiatura/alla strumentazione siano apportate modifiche o manomissioni, o comunque eseguite riparazioni od interventi tecnicamente intesi effettuati da soggetti -comunque individuati- non autorizzati.

Eguale, dovranno considerarsi espressamente esclusi da ogni forma di garanzia riferibile alla sottoscritta dichiarante tutti ed ogni ciascun danno provocato da incuria o da uso improprio dell'apparecchiatura/della strumentazione;

Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data: 18/06/2025

Formazione di base per dispositivi Draeger

Illustrazione generale del dispositivo

Allacciamento agli impianti della struttura

Collegamento degli accessori di base

Procedura di accensione e spegnimento

Esecuzione ed interpretazione del test di verifica della funzionalità prima dell'uso

Procedura di calibrazione dei sensori

Utilizzo dei sistemi di comando relativi a:

- Impostazioni parametri
- Limiti di allarme
- Visualizzazione dati

Collegamento al paziente

Letture ed identificazione dei parametri monitorati

Riconoscimento ed identificazione degli allarmi funzionali e tecnici


Modalità di utilizzo e funzioni basilari

Modalità di pulizia e sterilizzazione


Introduzione agli accessori complementari

Training effettuato in presenza del personale utilizzatore

Data, Firma del Tecnico


Firmato da Maurizio Marinucci
18/06/2025 16:02:51
Maurizio Marinucci
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente


Firmato da SIG.RA LAURA CHIAVAROLI
18/06/2025 16:03:12
SIG.RA LAURA CHIAVAROLI

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel: +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0802000003729
Reg. PILE IT09060P00001299

Installazione

Codice Cliente no. 0091038936 Contratto

Chiamata no. T00950378

Data intervento 18/06/2025

La Draeger Italia S.p.A. garantisce e precisa altresì che:

- il personale utilizzatore è stato informato in merito ad ogni condotta/comportamento necessario ad assicurare la corretta utilizzazione della strumentazione consegnata, con espressa inclusione degli accessori;
- è stato regolarmente consegnato il manuale d'uso contenente la descrizione delle modalità e delle procedure operative necessarie per garantire ed assicurare l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura/della strumentazione in oggetto.

Resta inteso che qualsivoglia forma di garanzia dovrà considerarsi irrimediabilmente decaduta ed inefficace, qualora all'apparecchiatura/alla strumentazione siano apportate modifiche o manomissioni, o comunque eseguite riparazioni od interventi tecnicamente intesi effettuati da soggetti -comunque individuati- non autorizzati.

Eguale, dovranno considerarsi espressamente esclusi da ogni forma di garanzia riferibile alla sottoscritta dichiarante tutti ed ogni ciascun danno provocato da incuria o da uso improprio dell'apparecchiatura/della strumentazione;

Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data: 18/06/2025

Formazione di base per dispositivi Draeger

Illustrazione generale del dispositivo

Allacciamento agli impianti della struttura

Collegamento degli accessori di base

Procedura di accensione e spegnimento

Esecuzione ed interpretazione del test di verifica della funzionalità prima dell'uso

Procedura di calibrazione dei sensori

Utilizzo dei sistemi di comando relativi a:

- Impostazioni parametri
- Limiti di allarme
- Visualizzazione dati

Collegamento al paziente

Lettura ed identificazione dei parametri monitorati

Riconoscimento ed identificazione degli allarmi funzionali e tecnici

Modalità di utilizzo e funzioni basilari

Modalità di pulizia e sterilizzazione


Introduzione agli accessori complementari

Training effettuato in presenza del personale utilizzatore

Data, Firma del Tecnico


Firmato da Mannucci, Maurizio
OK
18/06/2025 16:08:11
Maurizio Mannucci
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente


Firmato da SIG.RA LAURA CHIAVAROLI
OK
18/06/2025 16:08:28
SIG.RA LAURA CHIAVAROLI

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0802000003729
Reg. PILE IT09060P00001299

Installazione

Codice Cliente no. 0091038936 Contratto

Chiamata no. T00950379

Data Intervento 18/06/2025

Intervento effettuato presso (0091036554)
Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata

20-2025-64 (GAR. 12 MESI)
Contatto:

Cliente indirizzo (0091038936)

AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Referente tecnico

Maurizio Marinucci
Tel.:
Maurizio.Marinucci@draeger.com

Nota

Pos.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Motivo della chiamata
010	Evita V600 Software: 02.01.00	- ASUD-0077 8422300		Installation
		Data di esecuzione: 18/06/2025 INSTALLAZIONE E COLLAUDO ACQUISTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI N°1 EVITA XL. GARANZIA 12 MESI.		
		Quant.	Articolo no.	Descrizione
010-1		1,00 Ora	S001	Installazione (18/06/2025)
010-2		1,00 Pezzo	M35417	Tube Connessione O2 AFNOR (18/06/2025)
010-3		1,00 Pezzo	M35421	Tube Aria 3m NIST EN NF (18/06/2025)

L'esito positivo del presente verbale riconnesso alle attività descritte e riportate, attesta/certifica ad ogni effetto di ragione e di legge in base alla miglior pratica tecnico/scientifica richiesta nel settore specifico di intervento che l'attrezzatura in argomento è stata installata a regola d'arte e deve ritenersi -conseguentemente- efficiente ed idonea a garantire il funzionamento in modo conforme alla propria destinazione d'uso.

L'utilizzazione dell'apparecchiatura oggetto di verifica e collaudo deve ritenersi riservato e consentito a personale medico abilitato e dotato delle conoscenze, delle abilità e delle capacità riconnesse/collegate alla formazione ricevuta nell'ambito di attività organizzate dalla struttura di Draeger Italia S.p.A. (corsi e sessioni istruttive e formative).

Posto che Draeger Italia S.p.A. riserva piena disponibilità a dette attività, quest'ultimo non assumerà e non potrà essere soggetto passivo di ogni forma di responsabilità per qualsivoglia danno e/o pregiudizio cagionato e/o causato dall'utilizzazione impropria, scorretta e/o imperita delle apparecchiature, ovvero dall'utilizzazione da parte di personale non abilitato e/o privo della formazione e delle conoscenze derivanti dalle attività formative assicurate da Draeger Italia S.p.A. e dalla sua struttura.

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1260913
Reg. Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0602000003729
Reg. PILE IT090560P00001299

Installazione

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950379

Data intervento
18/06/2025

La Draeger Italia S.p.A. garantisce e precisa altresì che:

- il personale utilizzatore è stato informato in merito ad ogni condotta/comportamento necessario ad assicurare la corretta utilizzazione della strumentazione consegnata, con espressa inclusione degli accessori;
- è stato regolarmente consegnato il manuale d'uso contenente la descrizione delle modalità e delle procedure operative necessarie per garantire ed assicurare l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura/della strumentazione in oggetto.

Resta inteso che qualsivoglia forma di garanzia dovrà considerarsi irrimediabilmente decaduta ed inefficace, qualora all'apparecchiatura/alla strumentazione siano apportate modifiche o manomissioni, o comunque eseguite riparazioni od interventi tecnicamente intesi effettuati da soggetti -comunque individuati- non autorizzati.

Eguale, dovranno considerarsi espressamente esclusi da ogni forma di garanzia riferibile alla sottoscritta dichiarante tutti ed ogni ciascun danno provocato da incuria o da uso improprio dell'apparecchiatura/della strumentazione;

Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data: 18/06/2025

Formazione di base per dispositivi Draeger

Illustrazione generale del dispositivo

Allacciamento agli impianti della struttura

Collegamento degli accessori di base

Procedura di accensione e spegnimento

Esecuzione ed interpretazione del test di verifica della funzionalità prima dell'uso

Procedura di calibrazione dei sensori

Utilizzo dei sistemi di comando relativi a:

- Impostazioni parametri
- Limiti di allarme
- Visualizzazione dati

Collegamento al paziente

Lettura ed identificazione dei parametri monitorati

Riconoscimento ed identificazione degli allarmi funzionali e tecnici

Modalità di utilizzo e funzioni basilari

Modalità di pulizia e sterilizzazione

Introduzione agli accessori complementari

Training effettuato in presenza del personale utilizzatore

Data, Firma del Tecnico

Firmato da Maurizio Maijucchi
OK
18/06/2025 16:06:40
Maurizio Maijucchi
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente

Firmato da SIG.RA CHIAVAROLI LAURA
OK
18/06/2025 16:06:57
SIG.RA CHIAVAROLI LAURA

Installazione

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950380

Data intervento
18/06/2025

Intervento effettuato presso (0091036554)
Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata

20-2025-64 (GAR. 12 MESI)
Contatto:

Cliente indirizzo (0091038936)

AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Referente tecnico

Maurizio Marinucci

Tel.:

Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Pos.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Motivo della chiamata
010	Evita V600 Software: 02.01.00	ASUD-0078 8422300		Installation
		Data di esecuzione: 18/06/2025 INSTALLAZIONE E COLLAUDO ACQUISTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI N°1 EVITA XL. GARANZIA 12 MESI.		
		Quant.	Articolo no.	Descrizione
010-1		1,00 Ora	S001	Installazione (18/06/2025)
010-2		2,00 Ora	T041	Area viaggio - small (18/06/2025)
010-3		1,00 Pezzo	M35417	Tube Connessione O2 AFNOR (18/06/2025)
010-4		1,00 Pezzo	M35421	Tube Aria 3m NIST EN NF (18/06/2025)

L'esito positivo del presente verbale riconnesso alle attività descritte e riportate, attesta/certifica ad ogni effetto di ragione e di legge in base alla miglior pratica tecnico/scientifica richiesta nel settore specifico di intervento che l'attrezzatura in argomento è stata installata a regola d'arte e deve ritenersi -conseguentemente- efficiente ed idonea a garantire il funzionamento in modo conforme alla propria destinazione d'uso.

L'utilizzazione dell'apparecchiatura oggetto di verifica e collaudo deve ritenersi riservato e consentito a personale medico abilitato e dotato delle conoscenze, delle abilità e delle capacità riconnesse/collegate alla formazione ricevuta nell'ambito di attività organizzate dalla struttura di Draeger Italia S.p.A. (corsi e sessioni istruttive e formative).

Posto che Draeger Italia S.p.A. riserva piena disponibilità a dette attività, quest'ultimo non assumerà e non potrà essere soggetto passivo di ogni forma di responsabilità per qualsivoglia danno e/o pregiudizio cagionato e/o causato dall'utilizzazione impropria, scorretta e/o imperita delle apparecchiature, ovvero dall'utilizzazione da parte di personale non abilitato e/o privo della formazione e delle conoscenze derivanti dalle attività formative assicurate da Draeger Italia S.p.A. e dalla sua struttura.

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale a sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
R.AEE IT 0802000003729
Reg. PILE IT09050FD0001299

Installazione

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950380

Data intervento
18/06/2025

La Draeger Italia S.p.A. garantisce e precisa altresì che:

- il personale utilizzatore è stato informato in merito ad ogni condotta/comportamento necessario ad assicurare la corretta utilizzazione della strumentazione consegnata, con espressa inclusione degli accessori;
- è stato regolarmente consegnato il manuale d'uso contenente la descrizione delle modalità e delle procedure operative necessarie per garantire ed assicurare l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura/della strumentazione in oggetto.

Resta inteso che qualsivoglia forma di garanzia dovrà considerarsi irrimediabilmente decaduta ed inefficace, qualora all'apparecchiatura/alla strumentazione siano apportate modifiche o manomissioni, o comunque eseguite riparazioni od interventi tecnicamente intesi effettuati da soggetti -comunque individuati- non autorizzati. Egualmente, dovranno considerarsi espressamente esclusi da ogni forma di garanzia riferibile alla sottoscritta dichiarante tutti ed ogni ciascun danno provocato da incuria o da uso improprio dell'apparecchiatura/della strumentazione;

Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data: 18/06/2025

Formazione di base per dispositivi Draeger

Illustrazione generale del dispositivo
Allacciamento agli impianti della struttura
Collegamento degli accessori di base
Procedura di accensione e spegnimento
Esecuzione ed interpretazione del test di verifica della funzionalità prima dell'uso
Procedura di calibrazione dei sensori
Utilizzo dei sistemi di comando relativi a:

- Impostazioni parametri
- Limiti di allarme
- Visualizzazione dati

Collegamento al paziente
Lettura ed identificazione dei parametri monitorati
Riconoscimento ed identificazione degli allarmi funzionali e tecnici
Modalità di utilizzo e funzioni basilari
Modalità di pulizia e sterilizzazione
Introduzione agli accessori complementari

Training effettuato in presenza del personale utilizzatore

Data, Firma del Tecnico

Firmato da Maurizio Marzocchi
OK
18/06/2025 16:05:06
Maurizio Marzocchi
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente

Firmato da SIG.RA CHIAVAROLI LAURA
OK
18/06/2025 16:05:24
SIG.RA CHIAVAROLI LAURA

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45072.1 Fax +39 02 4564515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0802000003729
Reg. FILE IT09080P00001299

Dräger

DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91038936
Order no.: 220521412

Consignee:
AZIENDA USL PESCARA
Reparto Rianimazione/Terapia Intens
Rif. Caposala Irene Rosini 32845960
Piano Terra
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Your order dated:
08.04.2025
20-2025-64

Your contact person

Notaristefano Rosangela
Tel.: 3895917717
Mail: rosangela.notaristefano@draeger.com



Delivery receipt no.: 0176651173
Delivery receipt date: 09.05.2025

Please reference on inquiries

Contract Partner 91038936

AZIENDA USL PESCARA

VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Customer no.:

AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Incoterms

CIP
PESCARA

Pos.	Quant.	Part no.	Description
000010	4 PZ	8422300	Evita V600
			Traceability Serial/Lot No/s.:
			ASUD-0075
			ASUD-0076
			ASUD-0077
			ASUD-0078
			ASUD-0075;Evita V600
			Consist of:
			8416189 ASUD-0042;Trolley2, 90cm
			ASUD-0076;Evita V600
			Consist of:
			8416189 ASUD-0060;Trolley2, 90cm
			ASUD-0077;Evita V600
			Consist of:
			8416189 ASUC-0636;Trolley2, 90cm
			ASUD-0078;Evita V600
			Consist of:
			8416189 ASUD-0065;Trolley2, 90cm

Drägerwerk AG & Co.KGaa
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
postal address: 23542 Lübeck
Phone +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT Reg.No. DE135082211
Tax number 22/291/13004

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBADEFFXXX

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
Commercial Register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner:
Drägerwerk Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Register of Companies:
Local Court HRB 7395 HL
Chairman of the Supervisory Board
Stefan Lauer

Chairwoman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co.KGaa:
Maria Dietz
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow

Dr. Reiner Piske
Anton Schrafner

DELIVERY RECEIPT



0176651173

Customer No.: 91038936
Order no.: 220521412

Delivery receipt no.: 0176651173
Delivery receipt date: 09.05.2025

Please reference on inquiries

Contract Partner
91038936

Page 2 / 3

Pos.	Quant.	Part no.	Description
			CND: Z1203010502 RDM: 1841832
			<p>** Car. specifiche Paese** Paese di destinazione Italia 220 V St. DIN 49441, 49441 R2, CEI</p> <p>***Informazioni di base*** #####</p>
	4 PZ	OPC6713	Evita V600 con nebulizzatore Valvola esp. riutilizzabile Spirolog Flow sensor (5x)
	4 PZ	OPC6728	Compensazione del tubo
	4 PZ	OPC6731	Airway Pressure Release Vent.
	4 PZ	OPC6730	Mandatory Minute Ventilation
	4 PZ	OPC6741	Loop PV flusso lento
	4 PZ	OPC6733	Ventilazione non invasiva
	4 PZ	OPC6734	Pressione assistita variabile
	4 PZ	OPC6729	AutoFlow/Volume Garantito
	4 PZ	OPC6042	Carrello
	4 PZ	8422538	Cavo di sistema 2,8 m
			<p>***Support d'appareil*** Carrello Cavo di sistema 2,8 m</p> <p>*** Telaio di supporto *** Guida DIN telaio di supporto</p> <p>*** Tubi CS *** Tubi CS</p> <p>Accessori ventilazione 8421000 * Selez. del mater. terminata*</p> <p>*** Selezione tubi *** Sistema EC x connett. UNI Lunghezza Tubo EC 3,0m O2 Tubo EC 3m NIST EN Unifor AIR Tubo EC 3m NIST EN Unifor</p>
	4 PZ	M35408	O2 Tubo EC 3m NIST EN Unifor
	4 PZ	M35412	AIR Tubo EC 3m NIST EN Unifor
	1 PZ	Stock-No.:	1014561789
	1 PZ	Stock-No.:	1014561790
	1 PZ	Stock-No.:	1014561791
	1 PZ	Stock-No.:	1014561792

DELIVERY RECEIPT



Customer No.: 91038936
Order no.: 220521412

Delivery receipt no.: 0176651173
Delivery receipt date: 09.05.2025

Please reference on inquiries

Contract Partner
91038936

Page 3/3

Pos.	Quant.	Part no.	Description	
			Number of packages	+-----+ 004 +-----+
			Total weight	336 KG
<p><i>Per waeruta</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Pe 18.06.25</i></p>				

 0123	EC Declaration of Conformity <i>EG Konformitätserklärung</i>	Date / Datum 2020-03-26
	European Directive 93/42/EEC, Annex II European Directive 2011/65/EC <i>Europäische Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II</i> <i>Europäische Richtlinie 2011/65/EG</i>	Document ID / Dokument Nr. MD104-022-2003-010-0

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23542 Lübeck
 Germany

hereby declares under its sole responsibility that the / erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product name / Produktbezeichnung	Medical device / Medizinprodukt	Device Class	UMDNS Code / GMDN Code
Evita V800	Intensive care ventilator	IIb	17-429 / 42411
Evita V600	Intensive care ventilator	IIb	17-429 / 42411

meets the provisions of the following European Directives:

- 93/42/EEC on medical devices. An examination of the quality management system has been carried out following Annex II.3 of the directive by the notified body TÜV Süd Product Service, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, EC No. 0123. The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485.
 - 2011/65/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the medical device not authorized by Draeger Medical will invalidate this declaration.

mit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien übereinstimmt:

- 93/42/EWG über Medizinprodukte Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang II.3 der Richtlinie beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle TÜV Süd Product Service, Ridlerstrasse 65, 80339 München, EU Kennnummer 0123, vorgenommen. Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
- 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Draeger Medical autorisierte Modifikation an dem Medizinprodukt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

President
 Business Unit Therapy
 Medical Division

Stephan Kruse



Senior Regulatory Affairs
 Development
 Intensive & Neonatal Care
 Business Unit Therapy

Holger Nadler

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Germany
 Postal address:
 23542 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 802-0
 Fax +49 451 802-2080
 info@draeger.com
 www.draeger.com

Bank details:
 Commerzbank AG, Lübeck
 IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
 Swift Code: COBA DE 33
 Sparkasse zu Lübeck
 IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
 Swift Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
 Commercial register:
 Local court Lübeck HRB 7903 HL
 General partner: Drägerwerk
 Verwaltungs AG
 Registered office: Lübeck
 Commercial register:
 Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
 Drägerwerk AG & Co. KGaA and
 Drägerwerk Verwaltungs AG:
 Stefan Lauer
 Executive Board
 Stefan Dräger (chairman)
 Rainer Klug
 Gert-Hartwig Leschow
 Dr. Reiner Piske

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2025-64
 DEL : 08/04/2025
 DATA CONSEGNA :
 DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spett.le
 (96094) DRAEGER ITALIA S.P.A.
 P.I.: 09058160152
 VIA GALVANI, 7
 20094 CORSICO, MI
 Telefono : 02/45872.1
 FAX : 02/4584515

Budget di Spesa : UAUT-2025-18/3

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
354173	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL MATRICOLA "ARMN-0142"	NUM	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5,00

CIG: B6329565FA - TRATTATIVA DIRETTA RDO NR. 5156126 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL IN DOTAZIONE PRESSO UOC TERAPIA INTENSIVA P.O. DI PESCARA

Cdc: C08C01C00 UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA Q.tà 1,00

354174	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL MATRICOLA "ARRK-0030"	NUM	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5,00
--------	---	-----	------	-----------	------	-----------	------

CIG: B6329565FA - TRATTATIVA DIRETTA RDO NR. 5156126 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL IN DOTAZIONE PRESSO UOC TERAPIA INTENSIVA P.O. DI PESCARA

Cdc: C08C01C00 UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA Q.tà 1,00

354193	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL MATRICOLA "ARRK-0031"	NUM	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5,00
--------	---	-----	------	-----------	------	-----------	------

CIG: B6329565FA - TRATTATIVA DIRETTA RDO NR. 5156126 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL IN DOTAZIONE PRESSO UOC TERAPIA INTENSIVA P.O. DI PESCARA

Cdc: C08C01C00 UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA Q.tà 1,00

ORDINE : 20 - 2025 - 64

Budget di Spesa : UAUT-2025-18/3

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
354175		NUM	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5,00
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO R/E VENTILATORI					0,00		
POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL MATRICOLA "ARRK-0032"							

CIG: B6329565FA - TRATTATIVA DIRETTA RDO
NR. 5156126 AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO R/E VENTILATORI
POLMONARI DRAEGER MOD. EVITA XL IN
DOTAZIONE PRESSO UOC TERAPIA
INTENSIVA P.O. DI PESCARA

Cdc: C08C01C00 UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA Q.tà 1,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
105	5,00	60 000,00	3 000,00
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
60 000,00		3 000,00	63 000,00

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA

VIA R. PAOLINI, 47

PESCARA, 65100



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1428

DEL 16/04/2025

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. "EVITA XL" IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6329565FA;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. "EVITA XL" IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- ai sensi dell'Art. 50 comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023- CIG: B6329565FA;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA (DDG n°602/2019);

DATO ATTO che l'intervento in oggetto non è incluso nel servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ASL di Pescara, affidato alla RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 e pertanto di competenza diretta dell'UOC Ingegneria Clinica della ASL di Pescara;

ATTESO che con verbale del 04/03/2022 il Direttore nella persona della dott.ssa R.Z. della UOC di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del Dolore esprimeva la necessità di sostituire/aggiornare nr. 16 ventilatori polmonari Draeger mod. Evita XL, in virtù dell'obsolescenza naturale delle apparecchiature;

PREMESSO che sul Piano Investimenti 2025-2027 approvato con Delibera nr. 1481 del 30/09/2024 sono previsti nr. 16 ventilatori polmonari per un totale di € 420.000,00 oltre iva e che la somma a disposizione per l'anno corrente è pari ad € 60.000,00 oltre iva;

DATO ATTO che in data 07/02/2025 la società Draeger Italia spa comunica che è ancora attiva l'offerta economica promozionale per la sostituzione/aggiornamento dei ventilatori polmonari mod.Evita XL con il nuovo modello Evita V600 per un importo straordinario e promozionale pari ad € 15.000,00 oltre iva 5% cadauno;

VALUTATA la necessità, di concerto con la UOC Terapia Intensiva, di procedere all'aggiornamento di nr. 4 ventilatori polmonari adulti/pediatrici le cui matricole sono ARMN-0142 INV.43588; ARRK-0030 INV. 43592; ARRK-0031 INV. 43590; ARRK-0032 INV. 43598;

PRESO ATTO che i restanti nr. 12 ventilatori polmonari previsti nel Piano Investimenti saranno acquisiti tramite procedura di gara con collegio tecnico già costituito;

ATTESO che la UOC Ingegneria Clinica ha pubblicato sulla piattaforma Me.Pa una Rdo nr.5156126 in data 04/03/2025, per l'aggiornamento tecnologico in formula repair exchange di nr. 4 ventilatori Polmonari marca Draeger mod. Evita identificata quale "Trattativa Diretta" avente base d'asta pari ad €60.000,00 oltre iva 5% con l'operatore economico Draeger Italia spa;

DATO ATTO che in data 11/03/2025 la ditta Draeger Italia spa faceva pervenire la propria offerta economica inerente l'aggiornamento tecnologico in formula repair exchange di n° 4 Ventilatori Polmonari per un importo pari ad € 60.000,00 oltre iva 5%;

RITENUTO che la Rdo in oggetto, identificata quale "Trattativa Diretta", ha evidenziato l'operatore economico Draeger Italia spa, con un importo complessivo di € 60.000,00 oltre iva 5%;

idonea per l'affidamento della procedura in parola in applicazione dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. nr. 36/2023;

PRESO ATTO del benessere tecnico-clinico da parte del Direttore UOC Terapia Intensiva del P.O. di Pescara relativo alla proposta commerciale della società Draeger Italia Spa;

DATO ATTO che in data 28/03/2025, si è proceduto alla stipula del contratto, tramite portale Me.PA. con l'operatore economico Draeger Italia spa per l'intervento in oggetto per un importo complessivo di €60.000,00 oltre iva 5%;

ACQUISITO il codice CIG: B6329565FA;

PRESO ATTO che la ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A.

VISTO il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO L'art.50, comma 1- lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire l'aggiornamento tecnologico in formula repair exchange di nr.4 ventilatori Polmonari marca Draeger mod. Evita XL con il nuovo modello Evita V600 aventi le seguenti matricole: ARMN-0142 INV.43588; ARRK-0030 INV. 43592; ARRK-0031 INV. 43590; ARRK-0032 INV.43598 in uso presso la UOC Terapia Intensiva del P.O. di Pescara;
- 3. DI APPROVARE** l'offerta economica presentata sul Me.Pa con Rdo nr. 5156126 dalla ditta Draeger Italia spa ed approvata dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele al prezzo complessivo di €60.000,00 oltre iva 5%;
- 4. DI AFFIDARE** l'intervento in argomento, alla ditta Draeger Italia spa - ai sensi dell'Art. 50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo di € 60.000,00 oltre iva 5%;
- 5. DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 73.200,00 iva 5% compresa, relativa all'attività in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2025 come segue alla voce di conto 01.01.02.05.02 – Aut. 18/3;
- 6. DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it link "Amministrazione Trasparente" – settore 11 – bandi di gara e contratti – ai sensi e per gli effetti dell'Art. 37 comma 2 del D.Lgs nr.33/2013;

7. DI DARE ATTO che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica - HTA dell'Azienda Sanitaria di Pescara;

8. DI CONFERIRE al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.05.02 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/04/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
