



**ORIGINALE**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI PESCARA**

Il giorno 14 OTT, 2019 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Antonio Caponetti, in qualità di facente funzioni ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs. N. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C. A.B.S.:

**11214**  
N.           

**OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione della gara indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018**

## IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- vista la relazione di cui all'allegato A;
- giudicata corretta e regolare l'istruttoria condotta dall'U.O.C. ABS;
- acquisiti i pareri espressi nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto,

### DELIBERA

1. di **APPROVARE** la proposta di aggiudicazione della gara indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018 e, per l'effetto, di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, alle Ditte sotto elencate e di sottoscrivere con le stesse, un accordo quadro, ai sensi dell'art. dell'art. 54, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL, per i gruppi a fianco di ciascuna riportati :

| ditte prime classificate  | Gruppi di gara |
|---------------------------|----------------|
| FASE Srl                  | 22             |
| VYGON ITALIA Srl          | 13,15          |
| MOVI SpA                  | 12             |
| SANIC Srl                 | 1, 2, 3 e 5    |
| MEDTRONIC ITALIA SpA      | 6, 14 e 26     |
| SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | 7, 29          |
| TAU-MEDICA Srl            | 10             |

2. di **DARE ATTO** che:

- gruppi 4, 8, 9, 11, dal 16 al 21, 23, 24, 27, 28 – per i quali non è pervenuta alcuna offerta - onde gli stessi sono stati dichiarati deserti;
- L'accordo quadro che dovrà essere sottoscritto con le Ditte aggiudicatarie, rideterminato per tener conto del valore dei lotti deserti, è pari ad € 247.429,92, oltre iva;
- La fornitura del materiale avverrà secondo le modalità della somministrazione, secondo le specifiche ed esclusive esigenze della UO utilizzatrice, senza possibilità di imposizione di minimi d'ordine e spese di spedizione.
- l'accordo quadro:
  - non fissa, per ciascun prodotto oggetto di gara, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascuno di essi, il loro prezzo e tipologia.
  - avrà durata quadriennale, fatta salva la possibilità di proroga tecnica semestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore;

- è stato ascritto alla tipologia di cui al comma 4, lettera b) del predetto articolo 54, in considerazione del fatto che il prezzo sia “fisso” per una durata non superiore ad un anno, decorso il quale viene espressamente prevista la possibilità di riapertura del confronto competitivo su tale elemento, con le seguenti modalità. Al termine di ciascun anno contrattuale, la ASL effettuerà, per ciascun lotto di gara, un rilancio competitivo per tutti i prodotti facenti parte dell’accordo quadro, riservato alle aziende sottoscrittrici dell’accordo quadro, aggiudicatarie dei singoli lotti. La procedura di rilancio sarà finalizzata ad ottenere una riduzione dei prezzi di aggiudicazione.
- L’Amministrazione si è riservata:
  - la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l’importo presunto di cui sopra, relativamente a ciascun Gruppo merceologico di ciascun lotto di aggiudicazione, nella misura di un quinto del valore originario dell’accordo quadro,
  - la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all’accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a quello previsto per la ASL di Pescara;
- l’art.32, c.9 del D.Lgs.50 del 2016 dispone che “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
- ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016, (e fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4 del D. Lgs 50/2016) , gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

### 3. di AUTORIZZARE la UOC ABS:

- ad avviare e aggiudicare, con propri atti e d’intesa con la UOC Farmacia ospedaliera - procedure negoziate, per l’aggiudicazione dei gruppi andati deserti ;
- a prorogare i contratti di fornitura corrispondenti , sino all’avvio d effettivo delle nuove forniture;
- ad esercitare, con propri atti, le opzioni (proroga tecnica, estensione di un quinto) che si rendessero necessarie in fase di esecuzione contrattuale;
- ad imputare le spese recate dal presente atto, nelle pertinenti voci di conto degli esercizi 2019 e successivi.

ALLEGATO A

**IL DIRETTORE DELLA UOC ABS**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018-, di indire una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro , ai sensi dell'art. dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL, suddivisi in n. 27 gruppi merceologici ad aggiudicazioni distinte e separate, descritti nell'Allegato "Elenco fabbisogno",
- La Commissione giudicatrice è stata nominata con DD n. 18 del 18 gennaio 2019;

**PRESO ATTO** che in esito alle condotte valutazioni – descritte negli allegato verbali del 20 dicembre 2018, 11 gennaio e 4 giugno 2019, oltre che nella relazione della commissione giudicatrice, gli esiti sono i seguenti:

| <b>ditte prime classificate</b> | <b>Gruppi di gara</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| FASE Srl                        | 22                    |
| VYGON ITALIA Srl                | 13, 15                |
| MOVI SpA                        | 12                    |
| SANIC Srl                       | 1, 2, 3 e 5           |
| MEDTRONIC ITALIA SpA            | 6, 14 e 26            |
| SMITHS MEDICAL ITALIA Srl       | 7, 29                 |
| TAU-MEDICA Srl                  | 10                    |

- Per i gruppi 4, 8, 9, 11, dal 16 al 21, 23, 24, 27, 28 non è pervenuta alcuna offerta, onde gli stessi sono stati dichiarati deserti;

**ATTESO** che, dal capitolato predisposto dalla UO richiedente, emergono quali punti qualificanti, i seguenti:

- L'accordo quadro che dovrà essere sottoscritto con le Ditte aggiudicatarie, rideterminato per tener conto del valore dei lotti deserti, è pari ad € 247.429,92, oltre iva;
- La fornitura del materiale avverrà secondo le modalità della somministrazione, secondo le specifiche ed esclusive esigenze della UO utilizzatrice, senza possibilità di imposizione di minimi d'ordine e spese di spedizione.

**ATTESO** che l'accordo quadro:

- non fissa, per ciascun prodotto oggetto di gara, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascuno di essi, il loro prezzo e tipologia.
- avrà durata quadriennale, fatta salva la possibilità di proroga tecnica semestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore;
- L'Accordo quadro è stato ascritto alla tipologia di cui al comma 4, lettera b) del predetto articolo 54, in considerazione del fatto che il prezzo sia "fisso" per una durata non superiore ad un anno, decorso il quale viene espressamente prevista la possibilità di riapertura del confronto competitivo su tale elemento, con le seguenti modalità. Al termine di ciascun anno contrattuale, la ASL effettuerà, per ciascun lotto di gara, un rilancio competitivo per tutti i prodotti facenti parte dell'accordo quadro, riservato alle aziende sottoscrittrici dell'accordo quadro, aggiudicatarie dei singoli lotti. La procedura di rilancio sarà finalizzata ad ottenere una riduzione dei prezzi di aggiudicazione.
- L'Amministrazione si è riservata:
  - la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, relativamente a ciascun Gruppo merceologico di ciascun lotto di aggiudicazione, nella misura di un quinto del valore originario dell'accordo quadro,
  - la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a quello previsto per la ASL di Pescara;

**ATTESO CHE** l'art.32, c.9 del D.Lgs.50 del 2016 dispone che "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016, (e fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D. Lgs 50/2016) , gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione,

### **PROPONE**

Per tutto quanto esposto in premessa :

1. di **APPROVARE** la proposta di aggiudicazione della gara indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018 e, per l'effetto, di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, alle Ditte sotto elencate e di sottoscrivere con le stesse, un accordo quadro, ai sensi dell'art. dell'art. 54, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL, per i gruppi a fianco di ciascuna riportati :

| <b>ditte prime classificate</b> | <b>Gruppi di gara</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| FASE Srl                        | 22                    |
| VYGON ITALIA Srl                | 13,15                 |
| MOVI SpA                        | 12                    |
| SANIC Srl                       | 1, 2, 3 e 5           |
| MEDTRONIC ITALIA SpA            | 6, 14 e 26            |
| SMITHS MEDICAL ITALIA Srl       | 7, 29                 |
| TAU-MEDICA Srl                  | 10                    |

2. di **DARE ATTO** che:

- gruppi 4, 8, 9, 11, dal 16 al 21, 23, 24, 27, 28 – per i quali non è pervenuta alcuna offerta - onde gli stessi sono stati dichiarati deserti;
- L'accordo quadro che dovrà essere sottoscritto con le Ditte aggiudicatarie, rideterminato per tener conto del valore dei lotti deserti, è pari ad € 247.429,92, oltre iva;
- La fornitura del materiale avverrà secondo le modalità della somministrazione, secondo le specifiche ed esclusive esigenze della UO utilizzatrice, senza possibilità di imposizione di minimi d'ordine e spese di spedizione.
- l'accordo quadro:
  - non fissa, per ciascun prodotto oggetto di gara, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascuno di essi, il loro prezzo e tipologia.
  - avrà durata quadriennale, fatta salva la possibilità di proroga tecnica semestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore;
  - è stato ascritto alla tipologia di cui al comma 4, lettera b) del predetto articolo 54, in considerazione del fatto che il prezzo sia "fisso" per una durata non superiore ad un anno, decorso il quale viene espressamente prevista la possibilità di riapertura del confronto competitivo su tale elemento, con le seguenti modalità. Al termine di ciascun anno contrattuale, la ASL effettuerà, per ciascun lotto di gara, un rilancio competitivo per tutti i prodotti facenti parte dell'accordo quadro, riservato alle aziende sottoscrittrici dell'accordo quadro, aggiudicatarie dei singoli lotti. La procedura di rilancio sarà finalizzata ad ottenere una riduzione dei prezzi di aggiudicazione.
- L'Amministrazione si è riservata:
  - la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, relativamente a ciascun Gruppo merceologico di ciascun lotto di aggiudicazione, nella misura di un quinto del valore originario dell'accordo quadro,
  - la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini



della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a quello previsto per la ASL di Pescara;

- l'art.32, c.9 del D.Lgs.50 del 2016 dispone che "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";
- ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016, (e fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D. Lgs 50/2016) , gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**3. di AUTORIZZARE la UOC ABS:**

- ad avviare e aggiudicare, con propri atti e d'intesa con la UOC Farmacia ospedaliera - procedure negoziate, per l'aggiudicazione dei gruppi andati deserti ;
- a prorogare i contratti di fornitura corrispondenti , sino all'avvio d effettivo delle nuove forniture;
- ad esercitare, con propri atti, le opzioni (proroga tecnica, estensione di un quinto) che si rendessero necessarie in fase di esecuzione contrattuale;
- ad imputare le spese recate dal presente atto, nelle pertinenti voci di conto degli esercizi 2019 e successivi.

**Il Direttore dell'UOC ABS  
TIZIANA PETRELLA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiziana Petrella', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 20/12/2018

In data 20 dicembre 2018, alle ore 12,00, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, Presidente del seggio di gara, assistita dal sig. Andrea Pallini, della procedura aperta indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018-, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, suddivisi in 27 "gruppi merceologici", ad aggiudicazioni distinte e separate, pur all'interno di un unico lotto, come descritte nell'allegata scheda fabbisogno (Allegato A1) e secondo la disciplina contenuta nei documenti di gara, procede all'apertura della presente seduta pubblica, volta a:

- verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti,
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata,
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio,
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte,
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara relativa alla gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.


Tutto ciò premesso, la Autorità di gara rammenta e dà atto che:

- il bando di gara è stato pubblicato su:
- GURI n. 131 del 9/11/2018,
- GUUE n. 2018/S 207 – 489993 del 7/11/2018,
- OSS REG. codice intervento n. 2351 del 20/11/2018
- N. 4 quotidiani, meglio descritti nella DD n. 496 del 13/1/2018,
- la fornitura è suddivisa in numero 27 gruppi merceologici
- Il numero CIG è il seguente: CIG 7679945B18;
- Il termine di scadenza è stato fissato al 18/12/2018,
- La presente seduta è stata con nota n. 0103825/18 del 18/12/2018, , notificata a tutte le Ditte partecipanti, a mezzo PEC.

L'Autorità di Gara constata pubblicamente che:

- entro il termine di scadenza sono pervenuti i plichi offerta e le relative campionature, come sotto riepilogato:

|   | ditte concorrenti   | estremi protocollo offerta         | CAMPIONATURA    |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Medica Valeggia SpA | prot. n. 0102998/18 del 17/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 2 | DASER Srl           | prot. n. 0102414/18 del 14/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 3 | VIP MEDICAL Srl     | prot. n. 0102334/18 del 14/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |

*Andrea Pallini*  


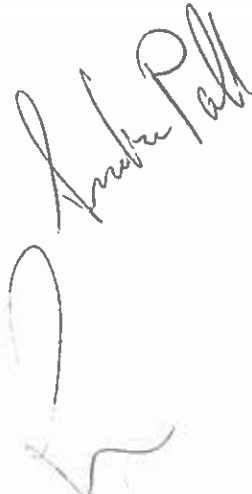


|    |                                  |                                       |                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4  | FASE Srl                         | prot. n. 0102324/18 del<br>14/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 5  | VYGON ITALIA Srl                 | prot. n. 0102192/18 del<br>14/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 6  | OLYMPUS ITALIA Srl               | prot. n. 0102198/18 del<br>14/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 7  | MOVI SpA                         | prot. n. 0102914/18 del<br>17/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 8  | SANIC Srl                        | prot. n. 0102986/18 del<br>17/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 9  | CARDINAL HEALTH<br>ITALY 509 Srl | prot. n. 0103098/18 del<br>17/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 10 | DEAS Srl                         | prot. n. 0103115/18 del<br>17/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 11 | MEDTRONIC ITALIA SpA             | prot. n. 0103315/18 del<br>18/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 12 | SMITHS MEDICAL ITALIA<br>Srl     | prot. n. 0103427/18 del<br>18/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |
| 13 | TAU-MEDICA Srl                   | prot. n. 0103445/18 del<br>18/12/2018 | SI (N. 1 COLLO) |

- il plico della Ditta teleflex è pervenuto oltre il termine di scadenza e, pertanto, non viene ammesso alla procedura;
- è presente il rappresentante della Ditta Cardinal Health , sig. Angelo Scaudone, il quale abbandona la seduta dopo l'apertura del plico della Ditta rappresentata, esaminata per seconda dopo la Medica Valeggia.

Tutto ciò premesso, l'Autorità di gara passa all'esame dei plichi pervenuti, e del loro contenuto e di seguito se ne riportano gli esiti:

|   | ditte-<br>concorrenti  | plico<br>correttamente<br>confezionato<br>e completo | Documen-<br>amm.va<br>regolare e<br>completa | soccorso<br>istruttorio | gruppi di<br>partecipazione | ammessa /<br>esclusa |
|---|------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Medica<br>Valeggia SpA | si   | si   |                         | 22                          | AMMESSA              |
| 2 | DASER Srl              | si   | si   |                         | 22                          | AMMESSA              |
| 3 | VIP MEDICAL<br>Srl     | si   | si   |                         | 13                          | AMMESSA              |
| 4 | FASE Srl               | si   | si   |                         | 6, 22                       | AMMESSA              |
| 5 | VYGON ITALIA<br>Srl    | si   | si   |                         | 12, 13, 15                  | AMMESSA              |
| 6 | OLYMPUS<br>ITALIA Srl  | si   | si   |                         | 25                          | AMMESSA              |
| 7 | MOVI SpA               | si   | si   |                         | 12, 13                      | AMMESSA              |

*Angelo Scaudone*  


|    |                               |    |    |   |                      |                     |
|----|-------------------------------|----|----|---|----------------------|---------------------|
| 8  | SANIC Srl                     | si | si |   |                      | AMMESSA             |
| 9  | CARDINAL HEALTH ITALY 509 Srl | si | si |   | 1, 5                 | AMMESSA             |
| 10 | DEAS Srl                      | si | si |   | 6, 7, 10, 11         | AMMESSA             |
| 11 | MEDTRONIC ITALIA SpA          | si | si |   | 6, 7, 10, 14, 25, 26 | AMMESSA             |
| 12 | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl     | si |    | <i>chiarire poteri del sottoscrittore, sig. ALBERTO VALENTI NIN, NON EVIDENTI DALLA VISURA CAMERALE</i> | 7, 8, 9, 29          | AMMESSA CON RISERVA |
| 13 | TAU-MEDICA Srl                | si | si |   | 1, 2, 10             | AMMESSA             |

L'Autorità di gara verifica e dà atto che per i gruppi 4, dal 16 al 21, 23, 24, 27, 28 non è pervenuta alcuna offerta, onde gli stessi vengono dichiarati deserti,

A questo punto, l'Autorità di gara rammenta come, secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, non appena questa sarà nominata.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

L'Autorità di gara, procede, quindi, ad inserire le buste contenenti le offerte economiche all'interno di una scatola che viene pubblicamente riposta all'interno dell'armadio chiuso a chiave posto nella stanza del Direttore della UOC ABS, la cui chiave è detenuta esclusivamente dalla medesima e da questa custodita.

I plichi contenenti le offerte tecniche vengono, riposti all'interno di numero due scatole e prese in custodia dal RUP, per essere consegnate alla Commissione giudicatrice non appena sarà nominata.

Al presente verbale viene allegato l'elenco dei nominativi dei rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta, e relative sottoscrizioni.

La seduta si chiude alle ore 13,45.

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Tiziana Petrella

Sig. Andrea Pallini



## VERBALE SEDUTA STRAORDINARIA

In data 11 gennaio 2019, alle ore 10,00, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, Presidente del seggio di gara, assistita dal sig. Andrea Pallini, della procedura aperta indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, suddivisi in 27 "gruppi merceologici", ad aggiudicazioni distinte e separate, pur all'interno di un unico lotto, come descritte nell'allegata scheda fabbisogno (Allegato A1) e secondo la disciplina contenuta nei documenti di gara, procede all'apertura di una seduta straordinaria, volta all'esame della documentazione trasmessa dalla Ditta Smiths Medical srl, ditta partecipante alla procedura in argomento ed ammessa con riserva in esito alle valutazioni compiute nel corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2018.

In quella seduta, l'Autorità di gara riteneva non comprovati i poteri del sottoscrittore della documentazione e di gara, sig. sig. ALBERTO VALENTI NIN, e, pertanto, disponeva l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio, cui la Ditta ottemperava trasmettendo, entro il termine perentorio in dicato, la documentazione (il verbale del consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2018, da cui risulta il conferimento dei poteri necessari.

Verificata, pertanto, la regolarità della documentazione, l'Autorità di gara ammette definitivamente la Ditta Smiths Medical srl alla gara in argomento.


La seduta si chiude alle ore 10,30.

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Tiziana Petrella

Sig. Andrea Pallini

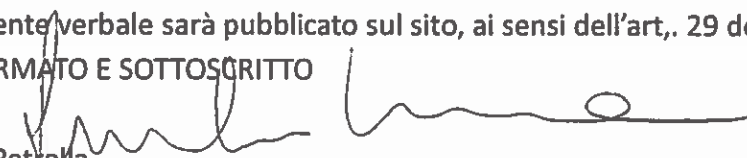

## VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 4 giugno 2019

In data 4 giugno 2019, alle ore 12,00, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, Presidente del seggio di gara, assistita dal sig. Andrea Pallini, della procedura aperta indetta con deliberazione a contrarre n. 994 del 25/9/2018-, per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, suddivisi in 27 "gruppi merceologici", ad aggiudicazioni distinte e separate, pur all'interno di un unico lotto, come descritte nell'allegata scheda fabbisogno (Allegato A1) e secondo la disciplina contenuta nei documenti di gara, procede all'apertura della presente seduta pubblica, volta a:

- Dare lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche,
- Dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, per mancato superamento della soglia di sbarramento,
- Apertura delle buste contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 del disciplinare di gara.
- La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
- Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

Tutto ciò premesso, la Autorità di gara rammenta e dà atto che:

- La presente seduta è stata convocata con nota n. 67161 del 28 maggio 2019, regolarmente notificata a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti, non già escluse.
- La Commissione giudicatrice è stata nominata con DD n. 18vd del 18 gennaio 2019;
- La Commissione ha concluso le proprie valutazioni e trasmesso il relativo verbale in data 17 maggio 2019;
- Il predetto verbale è stato pubblicato sul sito committente, in corrispondenza della presente gara;
- Sono state escluse dall'aggiudicazione le offerte che non hanno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 42/70, ante riparametrazione;
- laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si è proceduto alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali,
- Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.
- Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la formula "LINEARE "SPEZZATA" SULLA MEDIA come segue:



per ciascun Gruppo di gara, 30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la formula bilineare.

L'Autorità di Gara constata pubblicamente che:

- Sono presenti i rappresentanti delle Ditte riportate nell'elenco allegato al presente verbale,
- le buste contenenti le offerte economiche – riposte all'interno di una scatola che è stata e pubblicamente riposta all'interno dell'armadio chiuso a chiave posto nella stanza del Direttore della UOC ABS, la cui chiave è rimasta detenuta esclusivamente dalla medesima e da questa custodita – è integro ed inviolato

Tutto ciò premesso, l'Autorità di gara passa all'apertura ed alla lettura delle offerte delle sole Ditte ammesse, per ciascun dei gruppi di gara non andati deserti, ed al calcolo dei punteggi – economici e complessivi.

Gli esiti sono rappresentati nelle tabelle allegate e di seguito riepilogati esame dei plichi pervenuti, e del loro contenuto e di seguito se ne riportano gli esiti:

| ditte prime classificate  | Gruppi di gara |
|---------------------------|----------------|
| FASE Srl                  | 22             |
| VYGON ITALIA Srl          | 13,15          |
| MOVI SpA                  | 12             |
| SANIC Srl                 | 1, 2, 3 e 5    |
| MEDTRONIC ITALIA SpA      | 6, 14 e 26     |
| SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | 7, 29          |
| TAU-MEDICA Srl            | 10             |

L'Autorità di gara rammenta che per i gruppi 4, , 8, 9, 11, dal 16 al 21, 23, 24, 27, 28 non è pervenuta alcuna offerta, onde gli stessi vengono dichiarati deserti,

Al presente verbale viene allegato:

- la tabella riepilogativa dei punteggi,
- l'elenco dei nominativi dei rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta, e relative sottoscrizioni.

La seduta si chiude alle ore 13,15.

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito, ai sensi dell'art., 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Tiziana Petrella

**Valutazione tecnica gara "DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO DELL'ASL PESCARA -(Chir. Toracica, Neonatale ORL)**

**LOTTO 1 CATETERE TORACICO CON TROCAR**

Catetere toracico in PVC con mandrino introduttore in materiale metallico. Deve essere retto, deve avere punta conica chiusa, assolutamente atraumatica, fori lisci nella parte distale, linea radiopaca, indicatori di profondità, parete trasparente. Misure richieste: 12Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr.

Presentano offerta e campionatura le seguenti Ditte: **Cardinal Health Italy, Sanic e Tau Medica.**

I DM campionati dalla Ditta **Cardinal Health Italy** (ref 211-12, ref 211-16, ref 211-20, ref 211-24 e ref 211-28) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, per la presenza di filati (come dichiarato in etichetta). Inoltre la Ditta in essere non dispone del DM da 18Fr come si evince da scheda tecnica.

I DM campionati dalla **Tau Medica** (ref 9009/12, ref 9009/16, ref 9009/18, ref 9009/20, ref 9009/24 e ref 9009/28) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti la ditta campiona un DM dotato di punta metallica e non conica come richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta **Sanic** (ref 21112, ref 21116, ref 21116, ref 21118, ref 21120 e ref 21124, ref 211289) e risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Ai DM campionati viene attribuito il seguente punteggio.

| <b>Parametri di valutazione</b>   | <b>Punteggio max</b> | <b>Sanic</b>   |
|---|----------------------|--|
| <b>Finitura dei materiali</b>   | <b>25 punti</b>      | <b>(1x25)=25 punti</b><br>Eccellente la finitura dei materiali   |
| <b>Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</b>                        | <b>20 punti</b>      | <b>(1x20)= 20 punti</b><br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| <b>maneggevolezza</b>   | <b>20 punti</b>      | <b>(1x20)= 20 punti</b><br>punti   |
| <b>Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione)</b> | <b>5 punti</b>       | <b>1x5)=5 punti</b><br>Eccellente la qualità dei materiali, garanzia di sterilità                              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>70 punti</b>      | <b>Ditta Sanic 70 punti</b>  |



## LOTTO 2 CATETERE TORACICO CON TROCAR

Catetere toracico in PVC con mandrino introduttore in materiale metallico. Deve essere retto, deve avere punta conica chiusa, assolutamente atraumatica, fori lisci nella parte distale, linea radiopaca, indicatori di profondità, parete trasparente. Misure richieste: 8Fr, 10Fr.

Presentano offerta e campionatura le seguenti Ditte: Tau Medica e Sanic.

I DM campionati dalla Ditta Tau Medica ( ref 2009/08 e ref 9009/10) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico , difatti la ditta campiona un DM dotato di punta metallica e non conica come richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Sanic (ref 21108 e ref 21110) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Ai DM campionati viene attribuito il seguente punteggio.


| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Sanic  |
|--|-----------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti        | (1x25)=25 punti<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20 punti<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20punti<br>Eccellente la maneggevolezza.  |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5punti<br>Eccellente la qualità dei materiali, garanzia di sterilità                             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Ditta Sanic 70 punti</b>  |

## LOTTO 3 VALVOLA DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH

Per eliminare il pneumotorace e per effettuare il drenaggio senza ritorno di aria nella pleura del paziente. Sul dispositivo devono essere riportati graficamente i lati recipiente e paziente.

Presenta offerta la Ditta Vygon che campiona un DM (ref 668.00) di cui non viene presentata documentazione tecnica per cui non è possibile procedere alla valutazione.

Presenta offerta e campionatura la Ditta Sanic.

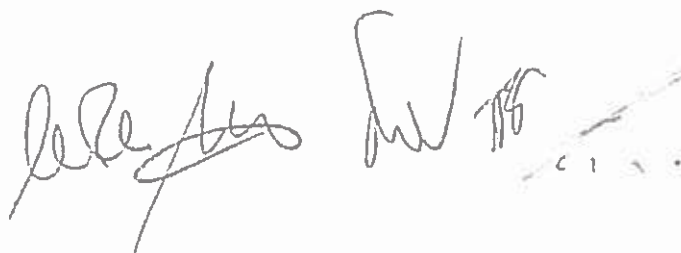Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be 'S. S. S.'. To the right of the signature is a rectangular stamp with some illegible text and a date '11/11'.

I DM campionati dalla Ditta Sanic (ref 10530) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Ai DM campionati viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Sanic  |
|--|-----------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti        | (1x25)=25 punti<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20 punti<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20 punti<br>Eccellente la maneggevolezza.   |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5 punti<br>Eccellente la qualità dei materiali, garanzia di sterilità                            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Ditta Sanic 70 punti</b>  |

#### LOTTO 4 KIT PER PARACENTESI/TORACENTESI

Costituito da tre aghi in acciaio 14-16-18/19G con cappuccio di protezione, lunghezza mm 80, siringa 50/60ml attacco luer lock, sacca di raccolta da 2000ml almeno, con valvola antireflusso, rubinetto a tre vie, prolunga in PVC con raccordo luer lock maschio, raccordo per sacca raccogli-urina. Rispondenza alla Direttiva 32/2010 sulle ferite da taglio

Per il lotto 4 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione.

#### LOTTO 4 bis KIT PER PARACENTESI/TORACENTESI

Costituito da tre aghi in acciaio 14-16-18/19G con cappuccio di protezione, lunghezza mm 80, siringa 50/60ml attacco luer lock, sacca di raccolta da 2000ml almeno con valvola antireflusso, rubinetto a tre vie, prolunga in PVC con raccordo luer lock maschio, raccordo per sacca raccogli-urina.

NOTA BENE: si procederà con l'aggiudicazione di tale lotto in caso di offerte non rispondenti a quanto richiesto inerentemente il lotto 4, ossia kit rispondente alla Direttiva sulle ferite da taglio.

Per il lotto 4 bis non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione.

#### LOTTO 5 KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI, TIPO TURKEL

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Deve essere costituito da catetere in poliuretano radiopaco, almeno 8CH, con rubinetto a tre vie in linea, ago in acciaio inox con mandrino atraumatico e retrattile, dotato di sistema in grado di informare l'operatore dell'ingresso dell'ago nello spazio pleurico nonché di sistema per verificare la corretta posizione nella cavità pleurica. Deve essere dotato di siringa luer lock da 50/60 cc e di sacca di raccolta del drenato da 2000ml.

Presentano offerta le seguenti Ditte: Cardinal Health Italy, e Sanic

Il DM campionato dalla Ditta Cardinal Health Italy (ref 8888566067) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti il DM campionato contiene ftalati (come evidenziato sulla etichetta) e pertanto non in linea con la normativa vigente.

Il DM campionato dalla Ditta Sanic (ref 10802) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico. Al DM campionato viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Sanic  |
|--|-----------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti        | (1x25)=25 punti<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20 punti<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20 punti<br>Eccellente la maneggevolezza.   |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5 punti<br>Eccellente la qualità dei materiali, garanzia di sterilità                            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Ditta Sanic 70 punti</b>  |

#### LOTTO 5 bis\_KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI, TIPO TURKEL

Deve essere costituito da catetere in poliuretano radiopaco, almeno 8CH, con rubinetto a tre vie in linea, ago in acciaio inox con mandrino atraumatico e retrattile, dotato di sistema in grado di informare l'operatore dell'ingresso dell'ago nello spazio pleurico nonché di sistema per verificare la corretta posizione nella cavità pleurica. Deve essere dotato di siringa luer lock da 50/60 cc e di sacca di raccolta del drenato da 2000ml.

NOTA BENE: si procederà con l'aggiudicazione di tale lotto in caso di offerte non rispondenti a quanto richiesto inerentemente il lotto 5, ossia kit rispondente alla Direttiva sulle ferite da taglio

Per il lotto 5 bis non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione.

4 

## LOTTO 6 INCENTIVATORE RESPIRATORIO TIPO RESPIFLO

Deve avere corpo trasparente con tre palline in tre camere ognuna delle quali corrisponde ad un diverso livello progressivo di inspirazione. Deve essere in materiale plastico, resistente agli urti, deve essere maneggevole, deve essere dotato di filtro per evitare l'inspirazione di particelle di polvere, deve essere dotato di tubo e boccaglio. Su ogni camera deve essere stampato il minimo flusso. Flusso da 600 a 1200cc/secondo. Il dispositivo deve essere monopaziente, in confezione singola.

Presentano offerta le seguenti Ditte: Deas, Medtronic e Fase

Il DM campionato dalla Ditta Deas (01020NS) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Il DM campionato dalla Ditta Fase (0180101) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Il DM campionato dalla Ditta Medtronic (8884717395) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Ai DM campionati dalle Ditte Deas, Medtronic e Fase viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione  | Punteggio max | Deas   | Fase  | Medtronic  |
|---|---------------|--|---|--|
| Finitura dei materiali  | 25 punti      | $(0,25 \times 25) = 6,25$<br>Una volta apposto il boccaglio nell'apposito alloggiamento, la base dello strumento è meno stabile con rischio di caduta. | $(0,50 \times 25) = 12,50$<br>La connessione del tubo al corpo del dispositivo risulta poco resistente e pertanto la sua validità viene valutata come sufficiente | $(1 \times 25) = 25$<br>Eccellente la finitura dei materiali   |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | 25 punti      | $(0,25 \times 25) = 6,25$<br>il DM campionato appare facilmente smontabile con fuoriuscita delle palline e perdita della sua funzionalità.             | $(1 \times 25) = 25$<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente   | $(1 \times 25) = 25$<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente. |
| maneggevolezza  | 20 punti      | $(0,25 \times 20) = 5$<br>Il boccaglio risulta di difficile posizionamento nell'apposito alloggiamento.  | $(0,25 \times 20) = 5$<br>Il boccaglio risulta di difficile posizionamento nell'apposito alloggiamento.   | $(1 \times 20) = 20$<br>Eccellente la maneggevolezza.  |

|               |                 |                         |                        |                           |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
|               |                 |                         |                        |                           |
| <b>TOTALE</b> | <b>70 punti</b> | <b>Deas 17,50 punti</b> | <b>Fase 42,5 punti</b> | <b>Medtronic 70 punti</b> |

**LOTTO 7 INCENTIVATORE RESPIRATORIO VOLUMETRICO TIPO COACH**

Deve avere una porta per l'erogazione di ossigeno supplementare.

Il dispositivo deve garantire l'espansione toracica combinando l'incentivazione volumetrica al flusso costante di aria ventilata, volumi di misure da almeno 500 ml a 4000 ml. Deve avere un tubo facilmente regolabile e lavabile per eseguire gli esercizi, contenere caratteristiche visibili per garantire un facile apprendimento dell'esercizio, poter essere appeso sul letto del paziente e tenuto facilmente in mano, deve essere leggero, deve essere in materiale plastico e resistente agli urti, deve essere dotato di filtro per evitare l'inspirazione di particelle in polvere.

Presentano offerta le seguenti Ditte: **Deas, Medtronic e Smiths Medical Italia**

Il DM campionato dalla Ditta **Deas (01030)** non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti la Ditta campiona un DM privo di porta per l'erogazione dell'ossigeno supplementare. Inoltre il DM non può essere appeso a letto del paziente.

Il DM campionato dalla Ditta **Medtronic (8884719041B)** non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti la Ditta campiona un DM privo di porta per l'erogazione dell'ossigeno supplementare, con un esercitatore volumetrico per ispirazioni profonde fino a 2500 ml e pertanto non rispondente ai volumi richiesti dal capitolato. Inoltre il DM non può essere appeso a letto del paziente.

Il DM campionato dalla Ditta **Smiths Medical Italia (22-4000)** risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Al DM campionato dalla Ditta **Smiths Medical Italia** viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione | Punteggio max | Smiths Medical Italia                             |
|--------------------------|---------------|---|
| Finitura dei materiali   | 25 punti      | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | 25 punti        | (1x25)=25<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza  | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la maneggevolezza  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>70 punti</b> | <b>Ditta Smiths Medical Italia 70 punti</b>  |

#### **LOTTO 8 DISPOSITIVO PER GINNASTICA RESPIRATORIA (TIPO THRESHOLD IMT)**

Deve essere dotato di valvola unidirezionale indipendente dal flusso, pressione costante (indipendente dal flusso) che elimina la necessità di un indicatore di pressione, facilità di impostazione (incrementi di 2 cmH<sub>2</sub>O), efficacia di terapia in ogni posizione, possibilità di utilizzo con boccaglio e maschera resistenza e facilità di pulizia. I dispositivi devono essere mono paziente.

Presenta offerta la Ditta Smiths Medical Italia.

Il DM campionato dalla Ditta Smiths Medical Italia (20-1112) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, perché non corrisponde all'incentivazione dei muscoli inspiratori.

#### **LOTTO 9 DISPOSITIVO PER GINNASTICA RESPIRATORIA (TIPO THRESHOLD PEP)**

Deve essere dotato di valvola unidirezionale indipendente dal flusso, pressione costante (indipendente dal flusso) che elimina la necessità di un indicatore di pressione, facilità di impostazione (incremento PEP di 1 cm H<sub>2</sub>O, incremento IMT di 2 cm H<sub>2</sub>O), efficacia di terapia in ogni posizione, possibilità di utilizzo con boccaglio e maschera e resistenza e facilità di pulizia dispositivi devono essere mono paziente.

Presenta offerta la Ditta Smiths Medical Italia

Il DM campionato dalla Ditta Smiths Medical Italia (20-1112) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti il Dm campionato non presenta scala di incrementi tarata a 2 cmH<sub>2</sub>O come richiesto da capitolato.

#### **LOTTO 10 OCCHIALE PER OSSIGENOTERAPIA NASALE PER PAZIENTI ADULTI**

Deve avere cannula soffice e confortevole, deve avere tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa.

Presentano offerta le seguenti Ditte: Deas, Medtronic e Tau Medica.

I DM campionato dalla Ditta Deas (TR0C01NS) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti il dispositivo risulta non sterile. Inoltre viene presentata la scheda tecnica



relativa ad un prodotto sterile che però ha un ref diverso dal prodotto inviato come campione e di cui vengono forniti i relati CND e NRDM.

I DM campionati dalla Ditta Medtronic (13300) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti viene campionato un DM non sterile.

I DM campionati dalla Ditta Tau Medica (TB01) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

AL DM risultato rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Tau Medica.  |
|--|-----------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti        | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la maneggevolezza  |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Ditta Tau medica 70 punti</b>   |


#### LOTTO 11 OCCHIALE PER OSSIGENOTERAPIA NASALE PER PAZIENTI PEDIATRICI

Deve avere cannula soffice e confortevole, deve avere tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa.

Presenta offerta la Ditta Deas

I DM campionati dalla Ditta Deas (TR0C02NS) non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti il dispositivo risulta non sterile. Inoltre viene presentata la scheda tecnica relativa ad un prodotto sterile che però ha un ref diverso dal prodotto inviato come campione e di cui vengono forniti i relati CND e NRDM.

Non esistono, pertanto offerte rispondenti per il lotto in questione.

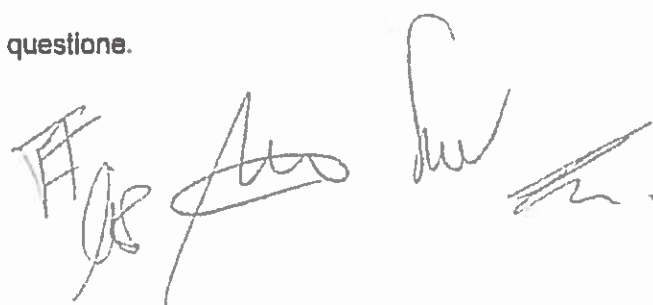

## LOTTO 12 SISTEMA PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO TIPO ASPISAFE 2

Deve avere sonda di introduzione della lunghezza di cm90 circa, diametro 1.5mm circa, catetere interno della lunghezza di cm95 circa, diametro interno 1mm circa. Deve poter essere utilizzato con il fibro-broncoscopio OLYMPUS in dotazione presso l'U.O. Di CHIRURGIA TORACICA del P.O. Pescara.

Presentano offerta le seguenti Ditte: Movi e Vygon

I DM campionato dalla Ditta Movi (58229-19) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Vygon (538.34) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.


Ai DM risultati rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Movi   | Vygon  |
|--|-----------------|--|--|
| Finitura del materiall   | 25 punti        | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la maneggevolezza<br>20 punti  | (0,25x20)=5<br>5 punti<br>Presenta difficoltà durante le manovre di                              |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali   | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Movi 70 punti</b>   | <b>Vygon 55 punti</b>  |

## DISPOSITIVI PATOLOGIA NEONATALE

### LOTTO 13 CATETERE OMBELICALE

Deve essere in poliuretano, resistente ai lipidi, deve avere punta aperta, atraumatica, indicatori di profondità, linea radiopaca, attacco luer.lock. Il dispositivo deve essere monouso, sterile, latex-

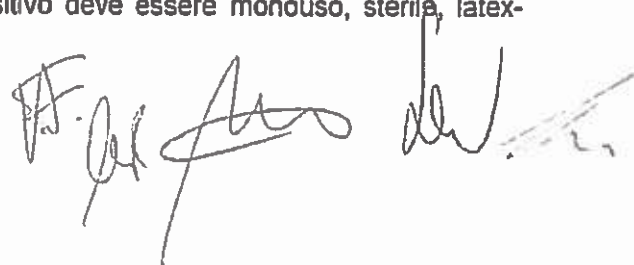

free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola. Devono essere confezionati in modo che il Dispositivo una volta estratto dalla confezione sia privo di memoria. Misure richieste: 3.5Fr, 5Fr.

Presentano offerte le seguenti Ditte: Movi, Vip Medical e Vygon Italia

I DM campionati dalla Ditta Movi (1183.12 e 1183.17) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, in quanto una volta estratto dalla confezione il DM non è privo di memoria.

I DM campionati dalla Ditta Vip Medical (4183505 e 4185005) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico in quanto manca la specifica resistenza ai lipidi.

I DM campionati dalla Ditta Vygon Italia (1270.03 e 1270.05) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Ai DM viene attribuito il seguente punteggio.

| Parametri di valutazione   | Punteggio max   | Vygon Italia   |
|--|-----------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti        | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti        | (1x20)=20<br>Eccellente la maneggevolezza  |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 punti</b> | <b>Vygon 70 punti</b>  |

#### LOTTO 14 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE A CIRCUITO CHIUSO

Da utilizzarsi ai fini di permettere aspirazioni endotracheali senza deconnettere il circuito respiratorio riducendo quindi i rischi di contaminazione. Deve avere spazio morto ridotto. Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola. Misure richieste: 5Fr, 6Fr, 8Fr.

Presenta offerta la Ditta la Ditta Medtronic

I DM campionati dalla Ditta Medtronic (444S02605-444S02606-444S02608) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Il punteggio attribuito è il seguente

| Parametri di valutazione  | Punteggio max   | Medtronic   |
|---|-----------------|---|
| Finitura dei materiali  | 25 punti        | (0,9x25)= 22,5<br>ottima la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                         | 20 punti        | (1x20)= 20<br>eccellente qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                  |
| maneggevolezza  | 20 punti        | (0,5x20)=10<br>il raccordo fra tubo e catetere è funzionale ma risulta avere un ottima tenuta solo se innestato |
| Confezionamento (qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti         | (1x5)= 5<br>eccellente garanzia di sterilità nell'apertura della confezione                                     |
| <b>TOTALE</b>   | <b>70 punti</b> | <b>Medtronic 57,5 punti</b>   |

#### LOTTO 15 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO CON VIA ACCESSORIA

Per intubazione endotracheale pediatrica o neonatale. Deve essere in PVC e deve avere via accessoria per consentire irrigazione e somministrazione di farmaci direttamente nel ramo tracheo-bronchiale dotata di raccordo luer lock femmina. Deve avere adattatore con attacco maschio per la connessione ai respiratori artificiali. Deve avere marcatura centimetrata e linee radiopache, estremità distale inclinata. Misure richieste: diametro interno 2.0mm-diametro interno 2.5mm-diametro interno 3.0mm-diametro interno 3.5mm

Presenta offerta la Ditta Vygon

I DM campionati dalla Ditta Vygon (5516.20, 5516.25, 5516.30, 5516.35) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Il punteggio attribuito è il seguente:

| Parametri di valutazione  | Punteggio max | Vygon  |
|---|---------------|--|
| Finitura dei materiali  | 25 punti      | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | 20 punti      | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza  | 20 punti      | (1x20)=20  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  |          | Eccellente la maneggevolezza                   |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti  | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali |
| <b>TOTALE</b>  | 70 punti | <b>Vygon 70 punti</b>                          |

#### LOTTO 16 SONDINI PER ALIMENTAZIONE NASO-GASTRICA TIPO K31-K32

Devono essere in PVC, devono essere dotati di punta distale morbida e arrotondata, trasparenti, devono avere 2 fori laterali asimmetrici. Devono essere dotati di linea radiopaca e di un connettore luer femmina con tappo di chiusura.

Per il lotto 16 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione.

#### LOTTO 17 SET PER ASPIRAZIONE TRACHEALE

Dispositivo per l'aspirazione tracheale di secrezioni bronchiali in modo sterile costituito da provetta di campionamento della capacità di 20cc circa, con cono e connettore. Il dispositivo deve essere dotato di tappo supplementare per il trasporto in laboratorio nonché di etichetta adesiva.

Per il lotto 17 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

#### LOTTO 18 SET ASPIRAZIONE MUCOSITA' CON CONNETTORE

Da utilizzarsi per l'aspirazione delle secrezioni bronchiali e per la raccolta di muco. Deve essere a camera singola, deve essere dotato di contenitore resistente e trasparente della capacità di 20cc circa con coperchio che collega i due tubi in PVC di grado medicale. I tubi devono essere privi di fori laterali. Deve essere dotato di connettore. Misura 14Ch.

Per il lotto 18 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

#### LOTTO 19 SET ASPIRAZIONE MUCOSITA'

Stesse caratteristiche del lotto precedente ma privo di connettore.

Per il lotto 19 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

#### LOTTO 20 KIT PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE INTRADDOMINALE TIPO ABDO PRESSURE

Il kit deve poter essere connesso a qualunque tipologia di catetere vescicale Foley, deve presentare un circuito chiuso ed al suo interno un sistema di misurazione che non necessita di altre apparecchiature. Deve poter essere utilizzato su pazienti neonatali, pediatrici, adulti.

Per il lotto 20 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

#### LOTTO 21 ASPIRATORE DI MECONIO

Deve avere una estremità collegabile ad un aspiratore e l'altra estremità collegabile ad un qualsiasi tubo endotracheale. Deve permettere la regolazione dell'aspirazione e deve poter permettere la visualizzazione del meconio durante l'aspirazione. Deve essere monopaziente.

Per il lotto 21 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

#### LOTTO 22 IMMOBILIZZATORI PER ARTI

Dispositivi monopaziente per immobilizzare e sostenere gli arti superiori o inferiori dei pazienti durante le infusioni. Devono essere costituiti da base di appoggio per l'arto e devono essere dotati di sistema di chiusura a velcro. Devono essere lavabili Misure richieste: Neonatale, Pediatrico (varie misure) e Adulto

Presentano offerta le seguenti ditte: Daser, Fase e Medical

I DM campionati dalla Ditta Daser (VI001#MN, VI001#XN, VI001#11, VI001#N, VI001#P e VI001#A) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Il punteggio attribuito è il seguente:

- Finitura dei materiali: (0,5x25)=12,5 il velcro presenta sporgenze di tessuto che appare rigido con spigoli potenzialmente lesivi per la cute dei pazienti per la fascia pediatrica e neonatale.
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il sicurezza per il pz(0,5x25)=12,5 il velcro presenta sporgenze di tessuto che appare rigido con spigoli potenzialmente lesivi per la cute dei pazienti per la fascia pediatrica e neonatale.
- Maneggevolezza: (1x20)=20 eccellente la maneggevolezza


I DM campionati dalla Ditta Fase (1060100,1060120,106125,1060130) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Il punteggio attribuito è il seguente:

- Finitura dei materiali: (0,5x25)=12,5 Difatti il velcro presenta sporgenze di tessuto che appare rigido con spigoli potenzialmente lesivo per la cute dei pazienti per la fascia pediatrica e neonatale.
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il sicurezza per il pz: (0,5x25)=12,5 Difatti il velcro presenta sporgenze di tessuto che appare rigido con spigoli potenzialmente lesivo per la cute dei pazienti per la fascia pediatrica e neonatale.
- Maneggevolezza: (1x20)=20 eccellente la maneggevolezza

I DM campionati dalla Ditta Medival (290000065000, 290000065100, 290000065200) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Il punteggio attribuito è il seguente:

- Finitura dei materiali: (1X25)= 25 eccellente la finitura dei materiali
- Qualità costruttiva: (1X25)= 25 eccellente la qualità dei materiali
- Maneggevolezza: (1X20)= 20 eccellente la maneggevolezza

Il punteggio attribuito è il seguente.

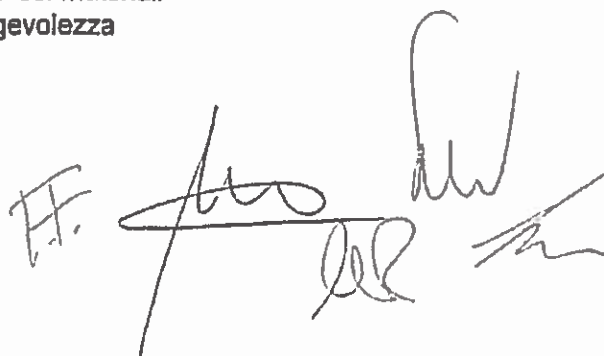



| Parametri di valutazione  | Punteggi o max  | Daser           | Fase            | Medical         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finitura del materiali  | 25 punti        | 12,5            | 12,5            | 25              |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | 25 punti        | 12,5            | 12,5            | 25              |
| maneggevolezza  | 20 punti        | 20              | 20              | 20              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>70 punti</b> | <b>45 punti</b> | <b>45 punti</b> | <b>70 punti</b> |

## DISPOSITIVI ORL

### LOTTO 23-CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO BIESALSKY

Deve essere in PVC, deve essere dotata di tappo antitosse, valvola di fonazione, raccordo 15 mm, 2 controcanule, fascia di fissaggio, flangia di fissaggio. Misure richieste: diametro interno mm 6,7,8,9,10,11,12,13.

Per il lotto 23 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

### LOTTO 23 bis CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO BIESALSKY

Deve essere in PVC, deve essere dotata di tappo antitosse, valvola di fonazione, raccordo 15 mm, 2 controcanule, fascia di fissaggio, flangia di fissaggio. Misure richieste: diametro interno mm 6,7,8,9,10,11,12,13.

**NOTA BENE:** Il presente lotto verrà aggiudicato in caso di mancata aggiudicazione del lotto 23 per offerte con rispondenti a quanto richiesto, ossia cannule senza rilascio di ftalati.

Per il lotto 23 bis non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

### LOTTO 24 CANNULE DI ASPIRAZIONE MONOUSO PER USO OTOLOGICO

Devono essere di metallo, con angolo di curvatura e connettore per una facile sostituzione. Misure richieste: diametro esterno 0.4mm – 0.7 mm - 1.4 mm – 2 mm, lunghezza cannula 70mm +/-10mm **MANIPOLO DI CONNESSIONE ALLE CANNULE CON CONTROLLO DELL'ASPIRAZIONE** Si deve connettere alle cannule.

Per il lotto 24 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

### LOTTO 25 SPLINT NASALE AL SILICONE

Splint intranasale bivalve al silicone con via d'aria integrale per setto nasale per permettere al paziente la respirazione nasale post-operatoria. Deve essere dotato di morbidezza per facilitare l'inserimento e la rimozione.

Presentano offerta le seguenti Ditte: Medtronic e Olympus.

I DM campionati dalla Ditta Medtronic (1527010, 1527015, 1527000, 1527005) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico per la composizione degli stessi che risulta essere in fluoroplastica anziché silicone.

Il DM campionato dalla Ditta Olympus (89-0916, 89-0917, 8909-18, 8909-19, 8909-20, 8909-21) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico per la composizione dello degli stessi che risulta essere in fluoroplastica anziché silicone.

Per il lotto 25 nessun DM risulta essere rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

#### LOTTO 26 Presidio per tamponamento nasale antero-posteriore tipo epistaxys nasal Ballon

Deve essere in silicone con due cuffie anteriore e posteriore riempiabili con soluzione fisiologica separatamente con due vie, monouso.

Presenta offerta la Ditta Medtronic

I DM campionati dalla Ditta Medtronic (1527031) risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

Il punteggio attribuito alla Ditta Medtronic

| Parametri di valutazione   | Punteggio max | Ditta Medtronic  |
|--|---------------|--|
| Finitura dei materiali   | 25 punti      | (1x25)=25<br>Eccellente la finitura dei materiali  |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                        | 20 punti      | (1x20)=20<br>Eccellente la qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente |
| maneggevolezza   | 20 punti      | (1x20)=20<br>Eccellente la maneggevolezza  |
| Confezionamento(qualità dei materiali, garanzia di sterilità nell'apertura della confezione) | 5 punti       | (1x5)=5<br>Eccellente la qualità dei materiali   |

|        |          |                    |
|--------|----------|--------------------|
| TOTALE | 70 punti | Medtronic 70 punti |
|--------|----------|--------------------|

**LOTTO 27 CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA TIPO ULTRA TRACHEOFLEX senza rilascio di ftalati**

Cannula per tracheostomia di forma arcuata estremamente flessibile con cuffia a bassa pressione e parete sottile, palloncino di controllo e valvola. Fascia di fissaggio, mandrino di introduzione, flangia di fissaggio, regolabile con sistema di chiusura girevole, raccordo da 15 mm, monouso, Misure richieste: Diametro interno mm 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

Per il lotto 27 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

**LOTTO 27 bis CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA TIPO ULTRA TRACHEOFLEX**

Cannula per tracheostomia di forma arcuata estremamente flessibile con cuffia a bassa pressione e parete sottile, palloncino di controllo e valvola.

Fascia di fissaggio, mandrino di introduzione, flangia di fissaggio, regolabile con sistema di chiusura girevole, raccordo da 15 mm, monouso, sterile, latex free, in confezione singola.

Misure richieste: Diametro interno mm 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

**NOTA BENE:** Il presente lotto verrà aggiudicato in caso di mancata aggiudicazione del lotto 27 per offerte con rispondenti a quanto richiesto, ossia cannule senza rilascio di ftalati.

Per il lotto 27 bis non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

**LOTTO 28-CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA TIPO CRYSTALCLEAR PEDIATRICA**

Con cuffia a bassa pressione, fascia di fissaggio e mandrino di introduzione. Misure richieste: Diametro interno mm 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,

Per il lotto 28 non risultano pervenute offerte e quindi non è possibile procedere alla valutazione

**LOTTO 29- CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALUNGA TIPO BIVONA**

Presenta offerta la Ditta Siths Medical Italia.

Il DM campionato dalla Ditta Siths Medical Italia ref (67HA60, 67HA70, 67HA80, 67HA90) risultano idonei.

La Commissione

Handwritten signature and initials, possibly 'EF' and 'SR', in black ink.






Dott. Marco Casaccia: Presidente

Dott.ssa Di Valerio Susanna : Componente

Dott. Giovanni Alessandrini : Componente


Dott.ssa Fuschi Fioretta : Componente

Dott.ssa Maria Pia Musa : Componente

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_


Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. ABS  
Dott.ssa Tiziana Petrella



Il Direttore della U.O. proponente attesta che l'adozione del presente atto risulta imputata sulle pertinenti voci di conto dei bilanci di competenza.

Il Direttore U.O.C. ABS  
Dott.ssa Tiziana Petrella



Ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

---

---

---

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Paolo Zappalà



favorevole

---

---

---

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonio Caponetti



IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dr. Antonio Caponetti



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara **15 OTT, 2019** in data  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line  
dell'Ausl di Pescara

Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- 
- 

**UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI**

per conoscenza a:

- 
- 
- 

alla Giunta Regionale in data                      con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data              con nota prot.

al Collegio Sindacale in data                      con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

**U.O.C. Affari Generali e Legali**  
Il Responsabile Affari Generali  
(dott. Fabrizio Veri)

