


Pinza da biopsia monouso con morso a cucchiaino fenestrata lunga da 160cm a 240cm circa in acciaio rivestita in teflon colorato con codice colore per identificare le differenti lunghezze. Vari tipi di morsi tipo: Standard, Jumbo.- con ago		1		2		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
102.1						
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	NON SPECIFICATO IL LOTTO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00		
		70		52,50		
			tot.			


IL PRESIDENTE

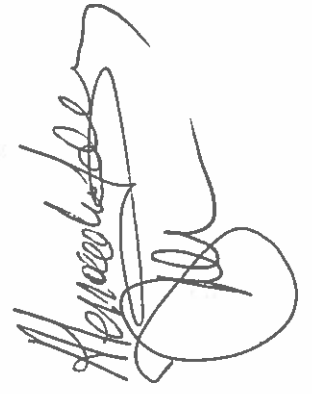

I COMPONENTI

Lotto 102.2: Pinza da biopsia monouso con morso a cucchiaino fenestrata lunga da 160cm a 240cm circa in acciaio rivestita in teflon colorato con codice colore per identificare le differenti lunghezze. Vari tipi di morsi tipo: Standard, Jumbo. - SENZA AGO		1		2		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
102.2	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	INNOVA	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	NON SPECIFICATO IL SUB LOTTO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00		
			TOT.	52,50		

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI




Lotto 103.1: Pinza biotrica monouso basculante, per canali operativi 2.0 mm, 2.8 mm e 3.2 mm (grande capacità). Valve fenestrate ovali lisce o a bocca di coccodrillo. Valve dotate di scanalatura interna per presa pulita senza strappo. Lunghezza operativa non inferiore a 1500 mm. Manico integrato.- con ago		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	OLYMPUS	Coeff.	Punt.
103.1					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE

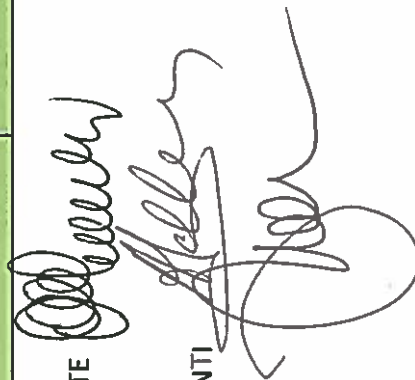


I COMPONENTI




Lotto 103.2: Pinza biottica monouso basculante, per canali operativi 2.0 mm, 2.8 mm e 3.2 mm (grande capacità). Valve fenestrate ovali lisce o a bocca di coccodrillo. Valve dotate di scanalatura interna per presa pulita senza strappo. Lunghezza operativa non inferiore a 1500 mm. Manico integrato. - senza ago		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.
103.2				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
		70	tot.	52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

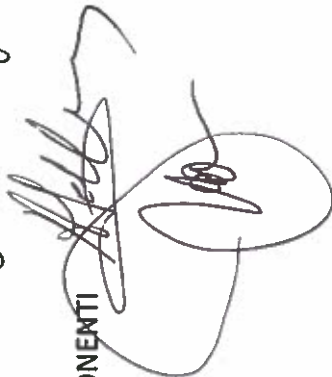

Pinza biottica monouso basculante, per canale operativo 3.7 mm (Jumbo). Valve fenestrate ovali lisce o a bocca di coccodrillo. Valve dotate di scanalatura interna per presa pulita senza strappo. Lunghezza operativa non inferiore a 2200 mm. Manico integrato.con ago		1		Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL		
104.1					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON BASCULA		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI





LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
Lotto 104.2: Pinza biptica monouso basculante, per canale operativo 3.7 mm (jumbo). Valve fenestrate ovali lisce o a bocca di cocodrillo. Valve dotate di scanalatura interna per presa pulita senza strappo. Lunghezza operativa non inferiore a 2200 mm. Manico integrato. - senza ago						
104.2		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	EUROMEDICAL		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON BASCULA		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
			70			

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 105.1: Pinza da biopsia pediatrica ricoperta con morso a cucchiaino, fenestrata, lunghezza 1,60 cm. circa, Diam. 1,8 mm monouso-GON ago		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	INNOVA	
105.1			Coeff.	Punt.	Coeff.
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00	0,75
			TOT.	52,50	TOT.
					52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




Lotto 105.2: Pinza da biopsia pediatrica ricoperta con morso a cucchiolo, fenestrata, lunghezza 160 cm. circa, Diam. 1,8 mm monouso- senza ago		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	INNOVA	
105.2					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA 180 ANZICHE 160
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00	
		70	TOT.	52,50	

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

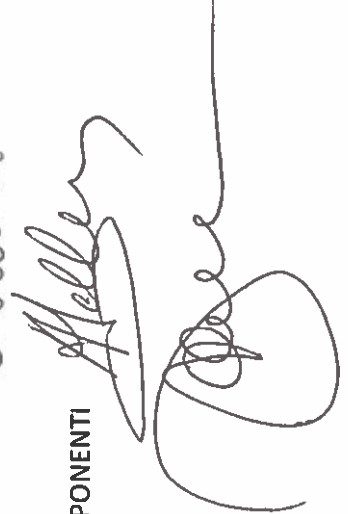


Lotto 106: Pinze per biopsia a caldo pluriuso per canale da biopsia da 2,8 mm., lunghezza 230 cm circa		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	LORENZATTO	MEDICOM	
			Coef.	Punt.	Coef.
106					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,85	21,25	0,70
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,85	21,25	0,70
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,85	17,00	0,70
		70	TOT.	59,50	TOT.
					49,00

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

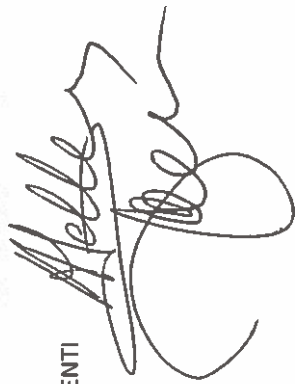

LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
107	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,75	18,75	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,85	21,25	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMIA E MANEGGEVITA'	25	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	17,50	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,75	18,75	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,85	21,25	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,70	14,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	14,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	14,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,70	14,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,75	15,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO	0,85	17,00	RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE E RICHIESTE. BUONO
			TOT.	49,00	TOT.	49,00	TOT.	49,00	TOT.	49,00	TOT.	59,50	TOT.	49,00	TOT.	52,50	TOT.	59,50	TOT.	59,50

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coef.	Punt.	2	Coef.	Punt.
<p>Lotto 108.1: Pinze per biopsia. E corpi estranei, pluriuso, autoclavabile interamente in acciaio (maniglia-guaine-valve) con guaina senza punti di giuntura e saldature, o applicazioni di materiali plastici con sistema a scorrimento rastremato ad effetto anti-kinking, con possibilità di operare in retrovisione senza perdita di forza di presa; azionamento meccanico libero senza scatti e molle, con ago di puntamento rigido, trasverso, anti-inocchiamento; piccolo diametro con valve che consentono prelievi abbondanti; Ø 1,8 mm - L 230 cm ca con ago e senza ago</p>									
108.1				INNOVA			RIAB MEDICAL		
		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	NON AGGIUDICATO: PIU' LOTTI CON UN SOLO CAMPIONE		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75			
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00			
			70	TOT.		52,50			

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

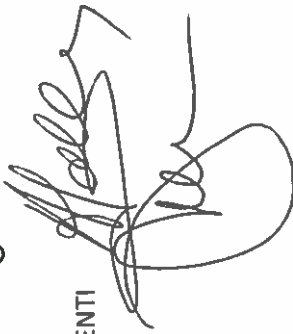


Lotto 108.2: Pinze per biopsia E corpi estranei, pluriuso, autoclavabile interamente in acciaio (maniglia-guaina-valve) con guaina senza punti di giuntura e saldature, o applicazioni di materiali plastici con sistema a scorrimento rastremato ad effetto antinking, con possibilità di operare in retrovisione senza perdita di forza di presa; azionamento meccanico libero senza scatti e molle, con ago di puntamento rigido; transverso, antingocchiamento; piccolo diametro con valve che consentono prelievi abbondanti Ø 2,5 mm - L 230cm ca con ago e senza ago		1		2		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
108.2			INNOVA		RIAB MEDICAL	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: DIAM 2.3		ESCLUSO PIU' LOTTI CON UN SOLO CAMPIONE	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA	25				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20				
		70				

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

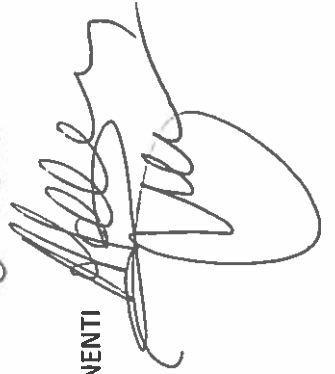

<p>Lotto 108.4: Pinze per biopsia corpi estranei, pluriuso, autoclavabile interamente in acciaio (maniglia-guaine-valve) con guaina senza punti di giuntura e saldature, o applicazioni di materiali plastici con sistema a scorrimento rastremato ad effetto antinking, con possibilità di operare in retrovisione senza perdita di forza di presa; azionamento meccanico libero senza scatti e molle, con ago di puntamento rigido, trasverso, antingocchiamento; piccolo diametro con valve che consentono prelievi abbondanti DIAM 2,5 mm - L. 230 cm ca con valve a coccodrillo</p>		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	INNOVA	RIAB MEDICAL	Punt. Coeff. Punt. Coeff. Punt.
108.4					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE CAMPIONE:DIAM. 2.3	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: manca ago di puntamento	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI




<p>Lotto 108.5: Pinze per biopsia corpi estranei, pluriuso, autoclavabile interamente in acciaio (maniglia-guaine-valve) con guaina senza punti di giuntura e saldature, o applicazioni di materiali plastici con sistema a scorrimento rastremato ad effetto antinking, con possibilità di operare in retrovisione senza perdita di forza di presa; azionamento meccanico libero senza scatti e molle, con ago di puntamento rigido, trasverso, antingocchiamento; piccolo diametro con valve che consentono prelievi abbondanti ;ø 2,5 mm - L 230cm.ca con bracci lunghi multifunzione</p>		<p>1</p>		<p>2</p>		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
108.5			INNOVA		RIAB MEDICAL	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE CAMPIONE:DIAM. 2.3		NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON TRATTASI DI PINZA PER BIOPSIA	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20				
		70				

IL PRESIDENTE

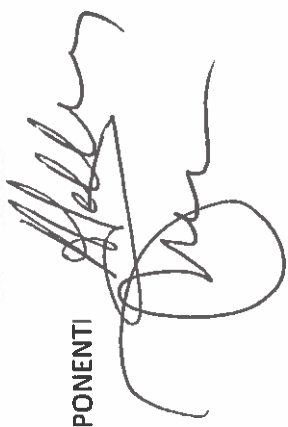

I COMPONENTI



LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coef.	Punt.	2	Coef.	Punt.
<p>lotto 108.6: Pinze per biopsia corpi estranei, pluriuso, autoclavabile interamente in acciaio (maniglia-gua (ne-valve) con guaina senza punti di giuntura e saldature, o applicazioni di materiali plastici con sistema a scorrimento rastremato ad effetto antinking, con possibilità di operare in retrovisione senza perdita di forza di presa; azionamento meccanico libero senza scatti e molle, con ago di puntamento rigido, trasverso, antingocchiamento; piccolo diametro con valve che consentono prelievi abbondanti; ϕ 2,5 mm - L 230 cm ca con valve a denti di topo</p>									
108.6		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE CAMPIONE: DIAM. 2.3			RIAB MEDICAL		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25						
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20						
<p style="text-align: center;">  IL PRESIDENTE  I COMPONENTI  </p>									

Lotto109.1: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo, pluriuso- diametro minimo canale operativo 2,0 mm., lunghezza operativa 1900 mm. circa, apertura valve 3,0 mm.ca		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	INNOVA	MEDICOM	
109.1			Coef.	Punt.	Coef.
					Punt.
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE CAMPIONE:DIAM. 1.8 LUNGH 180 SUB LOTTO NON SPECIFICATO	CAMPIONE NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			


IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		1		2	
109.2		MAX PG PER ITEM		Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
Lotto 109.2: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo, pluriuso- diametro minimo canale operativo 2,8 mm., lunghezza operativa 1650 mm. circa, apertura valve 4,7 mm. ca				INNOVA		MEDICOM	
				NON RISPONDENTE CAMPIONE:		CAMPIONE NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:	
		25					
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA		25					
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA		20					
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE		70					

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

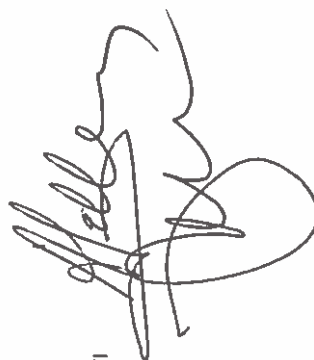Lotto 110.1: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo ricoperte, pluriuso		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	INNOVA	MEDICOM	
110.1			Coef.	Punt.	Coef.
			Punt.		Punt.
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE CAMPIONE:	CAMPIONE NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			


IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

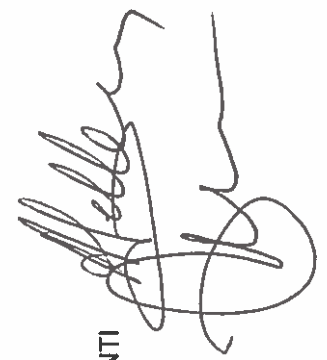



Lotto 110.3: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo ricoperte, pluriuso- diametro minimo canale operativo 2,8 mm., lunghezza operativa 1650 mm ca, apertura valve 19,5 mm ca				
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Punt.
110.3			OLYMPUS	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

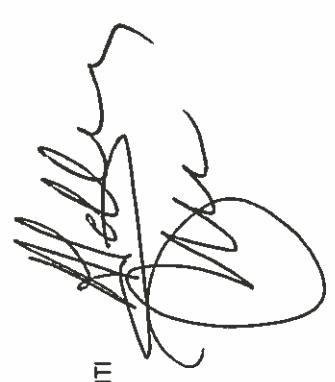


Lotto 110.2: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo ricoperte, pluriuso- lunghezza operativa 2300 mm ca.apertura valve 4,7 mm ca		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
110.2				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
Lotto 110.4: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo ricoperte, pluriuso- diametro minimo canale operativo 2,8 mm., lunghezza operativa 1650 mm ca, apertura valve 15,5 mm ca							
110.4	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA		25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA		25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE		20		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
				70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




Lotto 111.1: Pinze da recupero corpi estranei ad alligatore ricoperte, pluriuso- diametro minimo canale operativo 2,8 mm., lunghezza operativa 1650 mm. ca, apertura valve 7,5 mm ca		1	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	OLYMPUS
111.1			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	ESCLUSO UN SOLO CAMPIONE PER DUE LOTTI
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	
		70	

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 111.2: Pinze da recupero corpi estranei ad alligatore ricoperte, pluriuso - diametro minimo canale operativo 2,8 mm., lunghezza operativa 2900 mm ca, apertura valve 7,5 mm ca		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
111.2				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		


IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

Lotto 112.1: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo e bocca da alligatore ricoperte, lunghezza 165 cm. ca, canale operativo minimo 2,8 mm, pluriuso- apertura delle valve 11,3 mm ca		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		OLYMPUS		
112.1					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

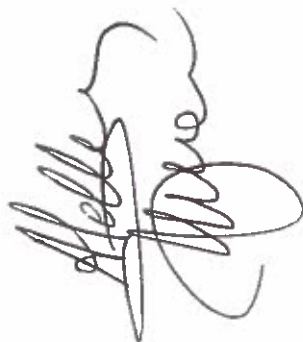

Lotto 112.2: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo e bocca da alligatore ricoperte, lunghezza 165 cm. ca, canale operativo minimo 2,8 mm, pluriuso- apertura delle valve 14,9 mm ca		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
112.2				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
Lotto 112.3: Pinze da recupero corpi estranei con denti di topo e bocca da alligatore ricoperte, lunghezza 165 cm. ca, canale operativo minimo 2,8 mm, pluriuso- apertura delle valve 19,5 mm ca							
112.3					OLYMPUS		
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA			25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA			25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE			20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
				70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

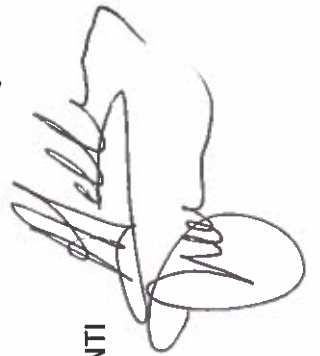


Lotto 115.1: Pinza da recupero corpi estranei e polipi, canale operativo minimo 2,8 mm., lunghezza 230 ca., apertura 20 mm ca. pluriuso- a tripode		1		2		3		4		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MAX PG PER ITEM	MEGCOM	OLYMPUS	SOFAR	INNOVA	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
115.1	CANALE MINIMO 2.8 PERTANTO NON AGGIUDICATO									
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: CANALE DA 2.6	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: CANALE DA 2.3	NON SPECIFICATO IL SUB LOTTO				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25								
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20								
		70								

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI



Lotto 117: Pinza da recupero rotante, denti di topo e bocca di alligatore, canale operativo minimo 2,8 mm, lunghezza 180 cm, circa apertura 6,9 mm, circa, per rimozione stent biliari, pluriuso.		1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		
117			OLYMPUS	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




Lotto 120.1: Sfinterotomo monouso per Rx Biliary System, lunghezza punta 5 mm. - lunghezza del filo di taglio 20 mm, diam. esterno 3,9 fr.		1	Coeff.	Punt.
Lotto	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		
120.1				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON PRESENTATO CMPIONE	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

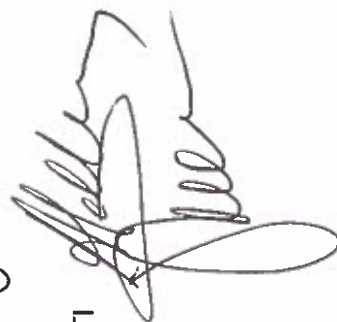

Lotto 120.2: Sfinterotomo monouso per Rx Biliary System, lunghezza punta 5 mm. -- lunghezza del filo di taglio 20 mm, diam. esterno 4,4 fr.		1		
Lotto	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	Coeff. Punt.
120.2				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON PRESENTATO CMPIONE	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		




IL PRESIDENTE

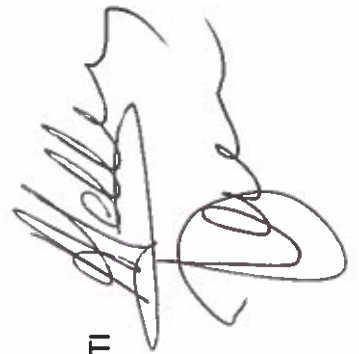


I COMPONENTI

Lotto 120.3: Sfinterotomo monouso per Rx Biliary System, lunghezza punta 5 mm. → lunghezza del filo di taglio 20 mm, diam. esterno 4,4 fr.		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		Punt.
120.3			BOSTON	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
		70	TOT.	52,50



IL PRESIDENTE

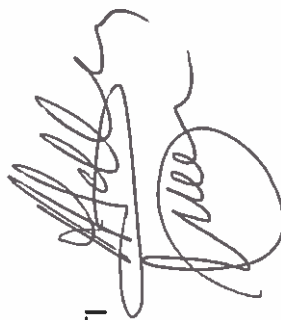

I COMPONENTI

Lotto 120.4-5-6: Sfinterotomo monouso per Rx Biliary System, lunghezza punta 5 mm. -- lunghezza del filo di taglio 20 mm, diam. esterno 4,4 fr.				1		
Lotto	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		BOSTON	Coeff.	Punt.
120.4-5-6						
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		NON PRESENTATO CMPIONE		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20				
			70			



IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

Lotto 122: Sfinerotomo monouso bilume, lunghezza filo di taglio 20,25,30, naso 5 e 15, lunghezza catetere circa 200cm, catetere rastremato. Compatibile con guida da 0.025/0.035		1		2		3		4		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK	EUROMEDICAL	MEDICOM	OLYMPUS	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
122	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE POICHE' "SVIRGOLA"	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER LA MA CHE NON RIENTRA IN SEDE E IMPOSSIBILITA' DI FLESSIONE/ESTENSIONE COMPLETA	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NASO 7 LUNGHEZZA	0,90	22,50	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE		0,90	22,50	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE		0,90	18,00	0,25	5,00
		70	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.		63,00		17,50
								49,00		

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.	2	Coeff.	Punt.
Lotto 123: sfinterotomo monouso ultrasottile a doppio lume, 5fr rastremato a 4 fr, filo di taglio mono e multi filamento da 20mm a 30mm, accetta filo guida da 0,021num.										
123		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA		25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	0,90	22,50	INNOVA		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA		25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	0,90	22,50			
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE		20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	0,90	18,00			
					TOT.		63,00			

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

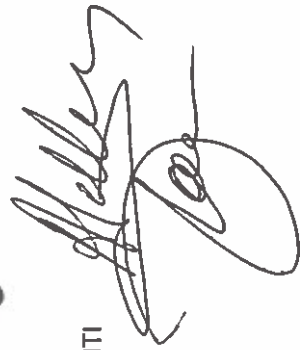


Lotto 124: sfinterotomo monouso doppio lume precaricato con filo guida in nitinol ad alta portanza. Punta atraumatica DomeTip, possibilità di iniezione liquido con guida inserita. filo guida da 0,021, 0,025 e 0,035.		1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MAX PG PER ITEM		
124	PUNTEGGIO			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,90	22,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,90	22,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,90	18,00
		70		
		tot.		63,00


IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

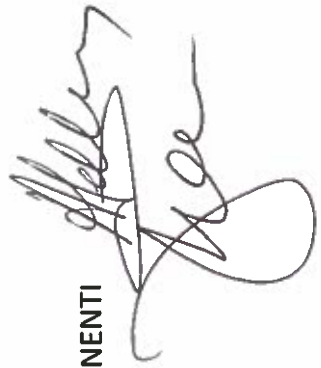

Lotto 125.1: Sfinterotomo a triplo lume, misura 7 fr. con punta rastremata 5 fr. lunghezza del filo di taglio da 20 mm, 25mm, 30mm, monouso- filo di taglio monofilamento		1		2		3	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	AORTA	COOK	LORENZATTO	Coef.	Punt.
125.1	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO	NON PRESENTE CAMPIONE SUB LOTTO 125.1 E NON RILEVATE LE DESCRIZIONI RICHIESTE SULLA SCHEDA TECNICA	0,90	22,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO		0,90	22,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: OTTIMO		0,90	18,00
							63,00
						TOT.	




IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

Lotto 126: Sfinterotomo a triplo lume, misura 7 fr. con punta rastremata 5 fr. lunghezza del filo di taglio: 25 mm. monofilamento, con filo guida precaricato, monouso		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		Punt.
126	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	AORTA	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: PLURIFILAMENTO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 127: Sfinterotomo monouso trilume, lunghezza filo di taglio 20,25,30, naso 5 e 15, lunghezza catetere 200cm circa, catetere rastremato.		1		2		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
127					MEDICOM	
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,70	17,50	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,70	17,50	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,70	14,00	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
		70		49,00	TOT.	52,50



IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

Lotto 128: Sfinterotomo Monouso Rotante. Diametro della punta da 4.4 Fr a 4.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume. Anche nella versione compatibile con sistema a scambio rapido, triplo lume con canale aperto a C		1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	BOSTON		
128	MAX PG PER ITEM			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		TOT.		52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI




LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coef.	Punt.
129.1	<p>Lotto 129.1: Papillotomo monouso a tre lumi, filo di taglio monofilamento 20 - 30 mm con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, lunghezza naso 3 - 7 mm. Punta dotata di marker radiopaco distale in Tungsteno, rastremata e precurvata, compatibile canale 2.8 mm e lunghezza operativa 1700 mm circa. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.- compatibile con filo guida da 0,025" - 0,035"</p>		OLYMPUS		
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50


IL PRESIDENTE




I COMPONENTI



<p>Lotto 129.2: Papillotomo monouso a tre lumi, filo di taglio monofilamento 20 - 30 mm con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, lunghezza naso 3 - 7 mm. Punta dotata di marker radiopaco distale in Tungsteno, rastremata e precurvata, compatibile canale 2.8 mm e lunghezza operativa 1700 mm circa. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.- precaricato con filo guida</p>		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		OLYMPUS		
129.2					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50



IL PRESIDENTE

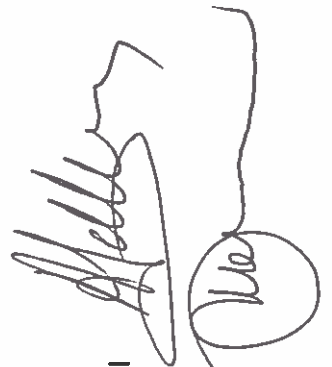

I COMPONENTI

<p>Lotto 130: Papillotomo in teflon a tre vie, con canali separati, a punta rastremata da 4.5F, compatibile con guida da 0.035. Impugnatura ad anelli ergonomica con attacco monopolare standard. Filo di taglio monofilamento da 20mm a 30mm con marker radiopachi fino a 15cm per individuazione area di taglio. Naso corto, lunghezza 190cm. Innesto filo di taglio asimmetrico che consente di mantenere la punta sempre in posizione, con possibilità di controllo dell'orientamento tra ore 11 e 1.</p>		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
130					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA		25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA		25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE		20		
			70		

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 131: Papillotomo monouso per precut, 3 lumi, ago retrattile 5 mm. Disponibile ago anche versione con rivestimento isolante nei 3 mm prossimi. Compatibile canale 2.8 mm e lunghezza operativa 1700 mm circa. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	LORENZATTO	OLYMPUS	
131			Coeff.	Coeff.	Punt.
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMIcITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
		70		tot.	52,50


IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

Lotto 132: Sfinterotomo precut da 5 fr. - lunghezza 200 cm - esposizione ago fino a 4 mm. per guida da 0,035 inch. monouso		1		2		3		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
132	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA AGO	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA AGO		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00				
			TOT.	52,50				
		70						

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

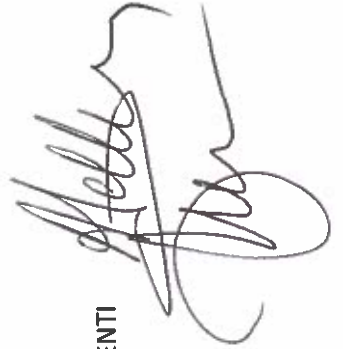


LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1			2			3				
			Coeff.	Punt.	COOK	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.		
134													
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON RASTREMATO E DIAMETRO		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00			
		70		52,50	tot.		52,50	tot.		52,50			


IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

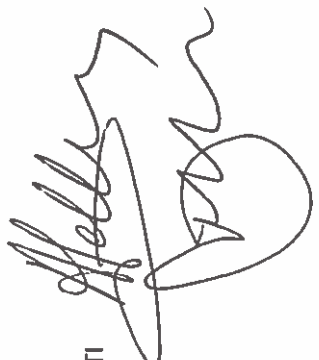

Lotto 135: Sfinterotomo per gastroresecato seco. Bll tipo Soehendra, mis. 5,5 fr. lungh. variabile del filo di taglio, monouso				1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		LORENZATTO	Coef.	Punt.
135						
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20				
			70			



IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

Lotto 136: Bisturi ad ago Monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Estensione ago da 4 mm a 6 mm.		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	AORTA	BOSTON	
			Coeff.	Punt.	Coeff.
136					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: RAPID E CANALE APERTO A C	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

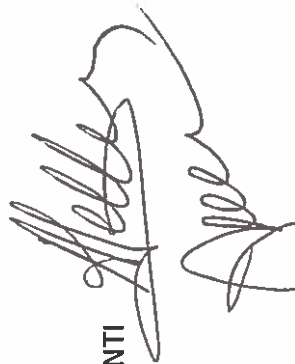

Lotto 137: Sistema premontato per il posizionamento di protesi biliari in plastica da 8,5 a 11,5 fr. monouso		1		2		3	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	MEDICOM	COOK	Coeff.	Punt.
137							
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON E' UN SET PREMONTATO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO			0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO			0,75	15,00
		70	TOT.				52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



LOTTO 140: set stent biliare monouso, protesi tipo Amsterdam in polietilene con 5 fori drenaggio, rastrematura traumatica parte distale, diametro da 7 fr a 11,5 fr, lunghezza da 5 cm a 18 cm. Set composto da catetere guida (no 7fr), spingitore, protesi con flap distale e proximale.		1		2		3	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK	INNOVA	MEDICOM	Coef.	Punt.
140	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: KRUSE - 6 FORI	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: 12 FORI - PE-GALLENGANGS		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO				
		70	TOT.				52,50

IL PRESIDENTE


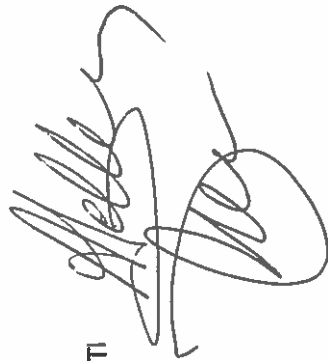


I COMPONENTI



LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1			2			3		
			COOK	LORENZATTO	MEDICOM	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.	Coeff.	Punt.
141	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: - NO INTRODUTTORE TIPO OASIS			NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON PREMONTATO - NO INTRODUTTORE TIPO OASIS		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75						
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00						
			tot.		52,50						


IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Stent biliare monouso tipo Tannenbaum, da 8.5 a 11.5 fr, lunghezze da 5 a 15cm						
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM		COEFF.	PUNT.	
143						
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00	
		70	tot.		52,50	

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 144: set stent pancreatico monouso con spingitore. Protesi in polietilene con tre flap di ancoraggio e fori di drenaggio lungo il corpo, diametro da 3 -5-7 fr, lunghezza da 3 cm a 15 cm.		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coeff.	Punt.
144				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
		70	tot.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




Lotto 145: stent pancreatico monouso , pigtail prossimale, flap distale, fori di drenaggio lungo il corpo, diametro 5 fr e 7 fr, lunghezza da cm 2 a cm 12		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
145				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
			TOT.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 149: Stent biliare precaricato monouso, riposizionabile. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido. Piegatura duodenale 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 18		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	Coef.	Punt.
149					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI




Lotto 150: set stent monouso doppio pigtail in Sof-flex, diametro 10 fr, lunghezza tra i pigtail da 1 cm a 15 cm, bande radiopache. Il set con protesi, catetere guida e spingitore		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coeff.	Punt.
150				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

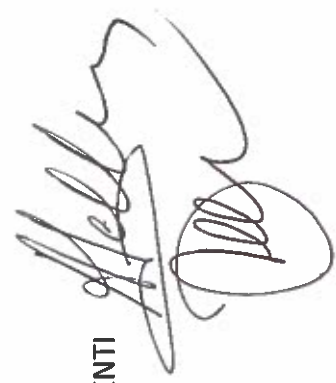


Lotto 151: sistema prementato monouso per il posizionamento di stent plastici. Possibilità di utilizzo con guida corta e guida standard. Permette di separare il device dal filo guida all'interno del coledoco. Compatibile con protesi da 8.5 fr a 10 fr		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK	Punt.
151				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

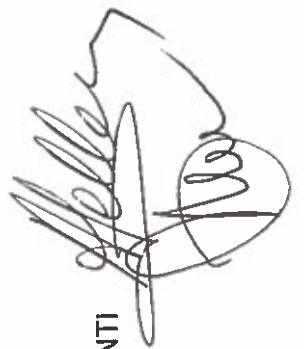

Lotto 152: Protesi biliare plastica pre-montata su kit di inserimento monouso consistente in un catetere guida con connessione luer-lock, tubo spingitore e manico abbassa-alette. Protesi di varie forme, da 7 - 8,5 - 10 - 12 Fr. Lunghezza protesi da 5 a 15 cm. Foro laterale distale ed alette di ancoraggio sulle estremità. Manicotto di introduzione per abbassare l'aletta prossimale.		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.
152				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
		70	tot.	52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 153: catetere spingitore monouso, compatibile con stent biliari e pancreatici, da 3fr a 11.5 fr.		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK	Punt.
153				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI





Lotto 154: catetere: guida monouso, compatibile con stent biliari e pancreatici, 5 fr e 6 fr.		1		2			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.	COEFF.	PUNT.	
154							
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER ECCESSIVA FLESSIBILITA'	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER ECCESSIVA FLESSIBILITA'	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER ECCESSIVA FLESSIBILITA'	0,25	5,00
			TOT.	52,50	TOT.		17,50


IL PRESIDENTE




I COMPONENTI



Lotto 155: Dilatatori biliari di Soehendra 6 fr., 7fr., 8,5fr, 9fr, 10fr, 11,5fr monouso		1		2		3	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.	INNOVA	COEFF.	PUNT.
155							
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON CI SONO TUTTI I fr.		NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON CI SONO TUTTI I fr.
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00			
			tot.	52,50			



IL PRESIDENTE

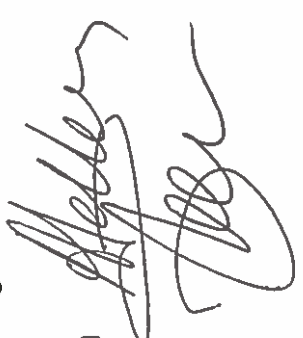

I COMPONENTI

Lotto 156: compatibili con guide da 0,021 e 0,035, per protesi da 5 a 11,5 fr			1	Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK		
156					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
			tot.		52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 157: Telino organizzatore monouso a tre tasche per il raccoglimento di accessori trans endoscopici durante le procedure endoscopiche/ERCP		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	AORTA	LORENZATTO	
			Coeff.	Punt.	Coeff.
157					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
		70	TOT.	52,50	TOT.
					52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 158:Protesi biliari metalliche autoespandibili monouso Rx parzialmente coperte con sistema di rilascio da 8 fr. Diametri 8mm e 10mm, lunghezze 40, 60, 80mm con parte coperta rispettivamente 30, 50, 70mm. per filo guida 0,035 inch.		1		Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON		
158					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 159: Protesi biliari metalliche autoespandibili monouso Rx con sistema di rilascio da 8 fr. , diametro con protesi espansa 8 mm. lunghezza con protesi espansa 40 mm, 60mm, 80mm, 100mm, per filo guida da Ø,035 inch		1		2		3		
LOTTO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	EUROMEDICAL	LORENZATTO	Coef.	Punt.	Coef.	Punt.
159								
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: DIAMETRO	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA E DIAMETRO	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	0,75	18,75
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75	0,75	18,75
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00	0,75	15,00
				TOT.				52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 161: Protesi biliare metallica: parzialmente coperta , con corpo da 8 mm o da 10 mm, lunga da 4.cm a 12 cm. Sistema di rilascio monorail da 8 Fr, estremità svasate, quattro punti di reperi fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza. Compatibile con sistema a scambio rapido, monouso		1		Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON		
161					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SISTEMA DI RILASCIO 8.5 NON RILEVATO A SCAMBIO RAPIDO		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

<p>Lotto 162: Protesi biliare metallica: totalmente coperta, con corpo da 8 mm o da 10 mm, lunga da 4 cm a 12 cm. Sistema di rilascio monorail da 8 Fr, estremità svasate, quattro punti di reperi fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza. Compatibile con sistema a scambio rapido, monouso</p>		<p>1</p>			
<p>LOTTO</p>	<p>ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO</p>	<p>MAX PG PER ITEM</p>	<p>BOSTON</p>	<p>Coeff.</p>	<p>Punt.</p>
<p>162</p>	<p>QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA</p>	<p>25</p>	<p>NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SISTEMA DI RILASCIO 8.5 NON RILEVATO A SCAMBIO RAPIDO</p>		
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA</p>	<p>25</p>			
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE</p>	<p>20</p>			
		<p>70</p>			

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 163: Protesi biliari autoespandibili, autoconformanti con forza lineare pari a zero non ricoperta in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, filoguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri .		1	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL
			Coeff.
			Punt.
163			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO
		70	TOT.
			52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 164: Protesi biliari autoespandibili, autoconformanti con forza lineare pari a zero parzialmente ricoperta in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, fileguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri .		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coef.	Punt.
164				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
		70		52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI





Lotto 165: Protesi biliari autoespandibili, autoconformanti con forza lineare pari a zero completamente ricoperta in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, filoguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	Coef.	Punt.
165					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70		TOT.	52,50



IL PRESIDENTE

I COMPONENTI


Lotto 166: Protesi biliari autoespandibili, autoconformanti con forza lineare pari a zero completamente ricoperta in monofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, filoguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	LORENZATTO	
166			Coeff.	Punt.	Coeff.
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	0,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00	0,75
		70	TOT.	52,50	TOT.
				52,50	52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

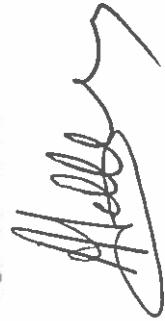
Lotto 167: Protesi biliari e pancreatiche autoespandibili, doppia copertura in PTFE e silicone, rimovibili. Maglia autoconformante in morofilamento di nitinol, o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, con teste svasate e forza radiale differenziata per prevenire la migrazione. Sistema di rilascio filoguidato:pull-back, con markers radiopachi sul delivery e sulla protesi, varie lunghezze e calibri.		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	Coeff.	Punt.
167					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50



IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



<p>Lotto 168: Protesi biliari costituite da unico filamento in nitinol con dodici marcatori in oro, non ricoperte, dotate di due lacci per il riposizionamento o la rimozione e di flaps per evitare la dislocazione. Precaucate su introduttore intra-canalare dotato di marcatori metallici altamente radiopachi, di marcatore colorato visibile ed anello radiopaco per il controllo dell'espansione. lunghezze variabili da 4 a 12 cm. e diametri da 8 a 10 mm.</p>		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	Coeff.	Punt.
168				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		
		70		

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



<p>Lotto 169: Protesi biliari costituite da unico filamento in nitalol con dodici marcatori in oro. Totalmente ricoperte in silicone, dotate di due lacci per il riposizionamento o la rimozione e di flaps per evitare la dislocazione. Precaricate su introduttore intra-canalare dotato di marcatori metallici altamente radiopachi, di marcatore colorato visibile ed anello radiopaco per il controllo dell'espansione. lunghezze variabili da 4 a 12 cm. e diametri da 8 a 10 mm.</p>		<p>1</p>			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	LORENZATTO	Coeff.	Punt.
169					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
			TOT.		52,50


IL PRESIDENTE

1 COMPONENTI

<p>Lotto 170: Protesi per drenaggio ecoguidato di pseudocisti, totalmente ricoperte con teste ampiamente svasate, diametri fino 16mm, rimovibili, indicata per il drenaggio transgastrico, varie lunghezze e diametri. Premondate su sistema di rilascio pull-back</p>		<p>1</p>		<p>2</p>	
<p>LOTTO</p>	<p>ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO</p>	<p>MAX PG PER ITEM</p>	<p>EUROMEDICAL</p>	<p>INNOVA</p>	<p>Punt.</p>
<p>170</p>	<p>QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA</p>	<p>25</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO PER MANIFATTURA</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE</p>	<p>17,50</p>
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA</p>	<p>25</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO PER CINEMATISMO</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE</p>	<p>17,50</p>
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE</p>	<p>20</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO PER QUALITA' COSTRUTTIVA</p>	<p>RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE</p>	<p>14,00</p>
			<p>TOT.</p>	<p>TOT.</p>	<p>49,00</p>
			<p>52,50</p>	<p>TOT.</p>	<p>52,50</p>

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI






Lotto 172: Stent biliare metallico monouso in Nitinol autoespandibile, a rilascio controllato, non ricoperto, con 5 markers radiopachi nella parte prossimale e 5 markers nella parte distale, premontato su sistema di introduzione, design delle maglie flessibile. Catetere introduttore dotato di marker endoscopico, filoguida compatibile 0,035". Diametro protesi 8 - 10 mm, lunghezza protesi 40 - 100 mm. Lunghezza operativa 1900 mm circa.		1		2		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	MEdicOMM	OLYMPUS		
			Coeff.	Punt.	Coeff.	
					Punt.	
172	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:LUNGHEZZA OPERATIVA 2100 ANZICHE 1900, + MARKERS RADIOPACHI	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO PER MANIFATTURA	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO PER MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMICITA'	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO PER QUALITA' COSTRUTTIVA	0,75	15,00
		70		TOT.		52,50

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

<p>Lotto 173: Stent biliare metallico monouse in Nitinol autoespandibile, a rilascio controllato, completamente ricoperto, con 5 markers radiopachi nella parte prossimale e 5 markers nella parte distale, premontato su sistema di introduzione, design delle maglie flessibile. Rivestimento interno in silicone ed esterno in poliuretano. Catetere introduttore da 7,5 Fr dotato di marker endoscopico, filloguida compatibile Ø035". Diametro protesi 8 - 10 mm, lunghezza protesi 40 - 80 mm, lunghezza operativa 1900 mm circa.</p>		<p>FATTORI PONDERALI</p>		<p>1</p>		<p>Punt.</p>	
<p>LOTTO</p>	<p>ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO</p>	<p>MAX PG PER ITEM</p>	<p>PG.</p>	<p>OLYMPUS</p>	<p>Coeff.</p>	<p>Punt.</p>	
<p>173</p>			<p>70</p>				
	<p>QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA</p>	<p>25</p>		<p>RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO</p>	<p>0,75</p>	<p>18,75</p>	
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA</p>	<p>25</p>		<p>RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO</p>	<p>0,75</p>	<p>18,75</p>	
	<p>QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE</p>	<p>20</p>		<p>RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO</p>	<p>0,75</p>	<p>15,00</p>	
			<p>70</p>	<p>TOT.</p>		<p>52,50</p>	

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

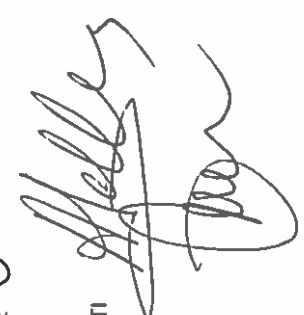


LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
Lotto 174: Stent biliare monouso autoespandibile in nitinol, diametro corpo 8 e 10 mm. diametro flange 9 e 11 mm., lunghezza da 4 a 10 cm., precaricato su sistema di rilascio a pistola, con possibilità di recupero e riposizionamento fino al 70% del rilascio. Catetere armato flessibile. Stent in configurazione non ricoperta Accetta filo guida da 0,035 inch.						
174	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA		25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA		25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE		20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	15,00
			70	tot.		52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

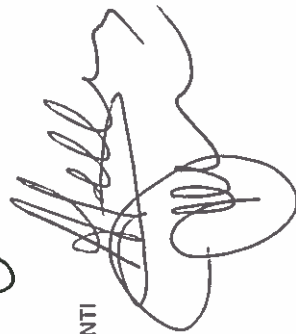

<p>LOTTO 175: Stent biliare monouso autoespandibile in nitinol, diametro corpo 8 e 10 mm. diametro flange 9 e 11 mm., lunghezza da 4 a 10 cm., precaricato su sistema di rilascio a pistola, con possibilità di recupero e riposizionamento fino al 70% del rilascio. Catetere armato flessibile. Stent in configurazione parzialmente rivestita. Accetta filo guida da 0,035 Inch.</p>						
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MAX PG PER ITEM	COOK	Coef.	Punt.	
175	PUNTEGGIO					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA DA 4 A 8 CM ANZICHE' 4-10 CM			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25				
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20				
		70				




IL PRESIDENTE



I COMPONENTI


<p>Lotto 176: Stent biliare monouso autoespandibile in nifinol, diametro corpo 8 e 10 mm. diametro flange 9 e 11 mm., lunghezza da 4 a 10 cm., precaricato su sistema di rilascio a pistola, con possibilità di recupero e riposizionamento fino al 70% del rilascio. Catetere armato flessibile. Stent in configurazione totalmente rivestita. Accetta filo guida da 0,035 inch</p>		<p>1</p>			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COOK	Coeff.	Punt.
176	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: LUNGHEZZA DA 4 A 8 CM ANZICHE' 4 -8 CM INOLTRE IN FASE DI VISIONE SI E' BLOCCATO NELLA FASE DI RILASCIO		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
		70			

IL PRESIDENTE 


I COMPONENTI 

Lotto 178: Protesi esofagee metalliche autoespandibili non rivestite Diametri 18/23 e 23/28. Lunghezze da 7 a 15 cm. A rilascio distale e prossimale		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	INNOVA	
			Coeff.	Punt.	Coeff.
178					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: DIAM 18-24 E 20-26
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00	
			TOT.	52,50	

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

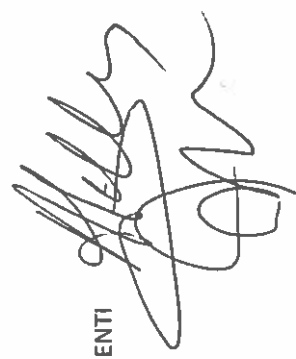

Lotto 179: Protasi esofagee metalliche autoespandibili parzialmente rivestite in poliuretano. Diametri 18/23 e 29/28mm. Lunghezze 10, 12, 15cm con parte ricoperta rispettivamente 7, 9 e 12cm. A rilascio distale e prossimale		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	MEDICOM	
			Coeff.	Coeff.	Punt.
179					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: RIVESTITE IN SILICONE
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00	
			tot.	52,50	


IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 180: Protesi esofagee TTS autoespandibili non ricoperte, in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svasatura. Sistema di rilascio distale di tipo pull-back, filoguidato, con markers radiopacchi. Vari diametri e varie lunghezze		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	Punt.
180				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	15,00
		70	TOT.	52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI





Lotto 181: Protesi esofagee TTS autoespandibili parzialmente coperte in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svatura. Sistema di rilascio distale di tipo pull-back, filoguidato, con markers radiopacchi. Vari diametri e varie lunghezze		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL		
			Coeff.		
			Punt.		
181	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 182: Protesi esofagee TTS autoespandibili totalmente coperte e rimovibili in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svatura. Sistema di rilascio distale di tipo pull-back, filoguidato, con markers radiopachi. Vari diametri e varie lunghezze		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	Coef.	Punt.
182	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER CINETICA DI RILASCIO	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER CINETICA DI RILASCIO	0,25	6,25
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER CINETICA DI RILASCIO	0,25	5,00
		70	TOT.		17,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
Lotto 183: Protesi esofagee OTW autoespandibili non ricoperte in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, a rilascio prossimale e distale, recuperabili, con sistema pull back filoguidato, con markers radiopachi, vari diametri e varie lunghezze						
183				INNOVA		
		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: INSUFFICIENTE PER CINETICA DI RILASCIO		
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25			
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20			
			70			

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 184: Protesi esofagee OTW autoespandibili, parzialmente ricoperte in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, a rilascio prossimale e distale, recuperabili, con sistema pulli back filoguidato, con markers radiopacchi, vari diametri e varie lunghezze		FATTORI PONDERALI	1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	PG.	INNOVA	Coeff.	Punt.
184			70			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	0,70	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	0,70	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20		RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	0,70	14,00
			70	TOT.		49,00

IL PRESIDENTE

1 COMPONENTI

Lotto 185: Protesi esofagee ØFW autoespandibili totalmente ricoperte in silicone e rimovibili, in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, a rilascio prossimale e distale, recuperabili, con sistema pull back filoguidato, con markers radiopachi, vari diametri e varie lunghezze		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	INNOVA	Punt.
185				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	14,00
		70	tot.	49,00

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 186: Protesi esofagea OTW con sistema ANTI-MIGRAZIONE autoespandibili, autoconformanti, completamente ricoperte e rimovibili, doppia copertura in PTFE (tronco) e silicone (testa e bumper) , in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, con svasatura prossimale e due bumper antimigrazione. A rilascio distale, con markers radiopachi, vari diametri e varie lunghezze.		FATTORI PONDERALI		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	PG.	EUROMEDICAL	Coef.	Punt.	
186			70				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25		NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: NON RIPORTA E NON MANTIENE (MEMORIA DI FORMA)			
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25					
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20					
			70				

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

LOTTO		ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.	2	Coeff.
<p>Lotto 187: Protesi esofagea OTW per il trattamento delle complicanze da chirurgia bariatrica a grosso diametro con sistema ANTIMIGRAZIONE, autoespandibile, completamente ricoperte con doppia copertura in silicone e PTFE e irrimovibili. In monofilamento di nitinolo o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, a rilascio elastico, a svasatura prossimale e con due bumper antimigrazione. Presenza di markers radiopachi sulla protesi e sul delivery. Diametro corpo 24mm, lunghezze 18-20cm</p>								
187		QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	EUROMEDICAL	0,70	17,50	LORENZATTO	
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	0,70	17,50	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: MANCA BUMPER ANTIMIGRAZIONE-LUNGHEZZA	
		QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: SUFFICIENTE	0,70	14,00		
				TOT.		49,00		

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

Lotto 188; Protesi esofagee cervicali anche con sistema anti migrazione autoespandibili totalmente ricoperte in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, con estremità atraumatiche, rimovibili e riposizionabili. A rilascio distale e prossimale		1	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL
188			
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: buono
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: buono
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: buono
		70	TOT.
			52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

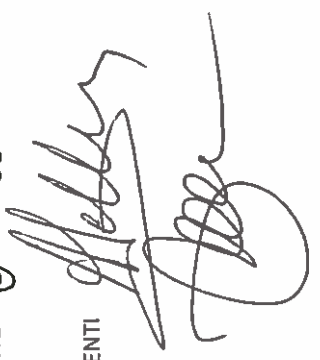

Lotto 189: Protesi esofagea metallica cardiale autoespandibile, filoguidata, con sistema antimigrazione, varie misure, varie lunghezze. A Rilascio distale e prossimale		1		2	
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	INNOVA	
			Coeff.	Punt.	Coeff.
189	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,70	17,50	NON RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: MANUALE SCRITTO IN INGLESE NELLA PARTE ITALIANA. IL SISTEMA DI RECUPERO POSIZIONAMENTO E' PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSO CAUSA RIGIDITA' DELLE MAGLIE NELLA FASE DI RIMOZIONE
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,70	17,50	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,70	14,00	
			TOT.	49,00	

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI


<p>Lotto 191: Protesi autoespandibili in nitinol totalmente ricoperte in silicone, dotate di laccio di riposizionamento e rimozione; preassemblate su posizionatore filoguidato dotato di marcatori radiopachi e tacche centimetriche, sistema di rilascio distale. Dotate di estremità atraumatiche e 12 marcatori in filo d'oro. Richieste nelle tipologie asimmetriche, standard, con valvola antireflusso e per stenosi benigne. Range di lunghezze variabili da 8 a 17 cm. e diametri da 18 a 22 mm</p>					
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	LORENZATTO	Coef.	Punt.
191					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

<p>Lotto 192: Protesi autoespandibili nitinol parzialmente ricoperte in silicone, dotate di laccio di riposizionamento e rimozione; preassemblate su posizionatore filoguidato dotato di marcatori radiopachi e tacche centimetriche, sistema di rilascio distale. Dotate di estremità atraumatiche e 12 marcatori in filo d'oro. Richieste nelle tipologie asimmetriche, standard, con valvola antireflusso e per stenosi benigne. Range di lunghezze variabili da 8 a 17 cm. e diametri da 18 a 22 mm</p>		<p>1</p>		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	LORENZATTO	Punt.
192				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO per qualità e resistenza	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO per ergonomia e maneggevolezza	17,50
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO per qualità correlata alla sicurezza per il paziente	14,00
		70	tot.	49,00

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

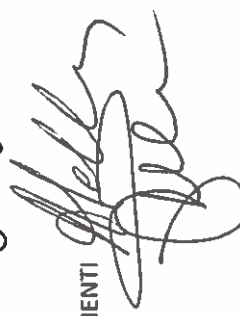


LOTTO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO		MAX PG PER ITEM	1	Coeff.	Punt.
193	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE: BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE


I COMPONENTI

Lotto 194: Stent esofageo in nitinol parzialmente ricoperto, catetere 24Fr, sistema di rilascio controllato a pistola con possibilità di recupero e riposizionamento. Corsore di stato. Accetta filoguida da 0.35. monouso		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	COEFF.	PUNT.
194				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	0,75	15,00
			tot.	52,50

IL PRESIDENTE




I COMPONENTI

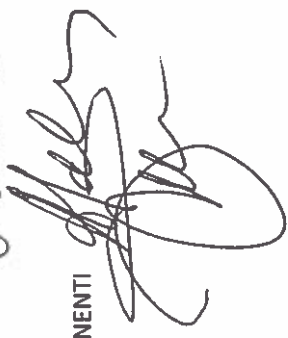

Lotto 197: Protesi esofagee metalliche autoespandibili coperte in permalume, monofilamento di nitinol. Sistema di rilascio a basso profilo. Lunghezze 10-12-15cm, vari calibri		1			
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON	Coeff.	Punt.
197					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	ISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	ISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	ISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Lotto 198: Protesi esofagee metalliche autoespandibili coperte in permalume, monofilamento di nitinol. Sistema di rilascio a basso profilo. Lunghezze 10-12-15cm, vari calibri		1		Coeff.	Punt.
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	BOSTON		
198					
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	ISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	ISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	ISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	0,75	15,00
		70	TOT.		52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Lotto 200: Protesi pilorico duodenali TTS autoespandibili, autocoformanti, cilindriche, non ricoperte in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico dotato di memoria di forma, filoguidate, con markers radiopachi, vari diametri e lunghezze. Rilascio controllato, possibilità di recupero dello stent parzialmente aperto		1		
LOTTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO	MAX PG PER ITEM	EUROMEDICAL	Punt.
200				
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE ALLA MANIFATTURA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	18,75
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	20	RISPONDEnte ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:BUONO	15,00
		70	TOT.	52,50

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI