

Oggetto : PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DI UN DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE IN CHEMILUMINISCENZA DI ANTICORPI DIRETTI VERSO NUMEROSI MICROORGANISMI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA.

In riferimento all'oggetto la commissione tecnica nominata dalla Asl composta da :

Dott. Luigi Clerico Presidente di Commissione

Dott. Claudio Palmerini

Dott. Andrea Balbinot

si è riunita il giorno 05/05/2023 presso l'ambulatorio di Microbiologia dell'U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica, del P.O. di Pescara, per la valutazione tecnica relativa alla fornitura in service di un sistema per la rilevazione in chemiluminiscenza di anticorpi diretti verso numerosi microorganismi .

Alla richiesta di fornitura in service di un sistema come in oggetto specificato ha risposto una sola Ditta:

DiaSorin con sede legale in Via Crescentino, snc, 13040 Saluggia VC.

La disamina dell'offerta tecnica è stata effettuata con accuratezza , riscontrando voce per voce il possesso dei requisiti minimi richiesti nella " **TABELLA A REQUISITI INDISPENSABILI**" pena esclusione ,di seguito riportata.




N	TABELLA A -REQUISITI INDISPENSABILI	DIASORIN
1	N.1 sistema, composto da un numero di strumenti tale da consentire l'esecuzione di almeno n. 50 test diversi contemporaneamente (anche su più strumenti), più uno strumento con funzioni di back up, per l'UOC di Microbiologia e Virologia Clinica del P.O. di Pescara, in chemiluminescenza e completamente automatici	SI
2	Il sistema offerto deve essere nuovo di fabbrica e di ultima generazione	SI
3	Garantire un reale backup analitico e strumentale per ogni test richiesto attraverso l'utilizzo di reattivi identici	SI
4	Cadenza analitica del sistema non inferiore a 350 test/ora.	SI
5	N.2 pc e n. 2 software in grado di consentire la gestione integrata di tutti gli strumenti offerti, completi di gruppo di continuità	SI
5	Interfacciamento al sistema gestionale LIS, in dotazione nel laboratorio	SI
7	Identificazione del campione tramite lettore di codice a barre in ogni singolo strumento	SI
8	Utilizzo di provetta primaria	SI
9	Caricamento random dei campioni	SI
10	Sensore di verifica per la corretta aspirazione del siero	SI
11	Identificazione reagenti tramite codice a barre o sistema alternativo in ogni singolo strumento	SI
12	Almeno n. 15 reagenti on-line a bordo per singolo strumento	SI
13	Funzione STAT, da qualsiasi posizione dell'area campioni	SI
14	Possibilità di ospitare almeno (non inferiore) fino a 100 campioni in una sola volta a caricamento continuo per singolo strumento	SI
15	Il sistema offerto deve poter effettuare almeno (non meno di) l'80% della tipologia degli analiti richiesti (pari a n. 42 dei n. 52 tipi di analiti) con l'obbligatorietà dei n.24 analiti evidenziati con l'asterisco nella Tabella B (Elenco analiti)	SI
16	Ogni singolo strumento offerto deve essere completo di stampante e gruppo di continuità	SI
17	Software operativo e manuale applicativo in lingua italiana, ovvero con traduzione in lingua italiana	SI
18	Principi non accettati RIA, EIA, ELISA in micropiastre	SI
19	Marchio CE-IVD	SI
20	Intervento assistenza tecnica entro 24 ore dalla chiamata escluso i festivi	SI

Verificati i singoli requisiti , l'offerta della ditta DiaSorin risulta pienamente rispondente alle caratteristiche di minima richieste nel Capitolato Tecnico .

La commissione alla luce di quanto sopra verbalizzato, continua i lavori di valutazione secondo i criteri previsti nella "TABELLA B REQUISITI A PUNTEGGIO" di seguito riportata con l'attribuzione del punteggio dei singoli parametri.

TABELLA B- REQUISITI A PUNTEGGIO				DITTA
N.	Caratteristiche strumento -reagenti	Criterio valutazione	Massimo punteggio assegnabile	DIASORIN
1	Scarico dei liquidi reflui direttamente nelle taniche utilizzate dal laboratorio analisi in ogni strumento del sistema offerto	Si: punti 5 No:punti 0	5	5
2	Identificazione dei reagenti tramite tecnologia in radio frequenza RFID in ogni strumento del sistema offerto	Si: punti 4 No:punti 0	4	4
3	Area reagenti a temperatura controllata ,in ogni strumento del sistema offerto	Si: punti 4 No:punti 0	4	4
4	Possibilità di eseguire automaticamente le curve di calibrazione su master curve memorizzate	Si: punti 3 No:punti 0	3	3
5	Possibilità , su richiesta ,di connessione remota dello strumento via Modem e/o VPM col servizio tecnico dell'Azienda fornitrice a scopo di monitoraggio quotidiano , prevenzione del fermo strumentale e tele aggiornamento in ogni strumento del sistema offerto	Si: punti 5 No:punti 0	5	5
6	Produttività media strumentale (dato dal totale cadenza analitica del sistema proposto diviso il numero strumenti offerti)	PROPORZIONALE (saranno attribuiti 5 punti all'offerta con la maggiore produttività media strumentale. Il punteggio attribuito alle altre offerte) sarà determinato proporzionalmente)	5	5
7	Dispensazione campione con puntali monouso in ogni strumento del sistema offerto	Si: punti 7 No:punti 0	7	7
8	Numero di strumenti offerti	minore o uguale a 3: 8 punti uguale a 4: 5 punti maggiore di 4: 2 punti	8	8
9	Caricamento in continuo dei puntali,delle cuvette,delle soluzioni di lavaggio e degli induttori di segnale, senza fermare routine	Si: punti 5 No:punti 0	5	5
10	Rilevazione qualitativa degli anticorpi contro il virus dell'epatite C (anti HCV) tramite l'utilizzo di proteine virali costituite da antigeni ricombinanti delle regioni virali CORE, NS3, NS4	Si: punti 5 No: punti 0	5	5
11	Determinazione quantitativa del pannello analiti EBV (EBV VCA IgG,EBV IgM, EBNA IgG,EA IgG)	Si: punti 5 No: punti 0	5	5
12	Numero di analiti offerti	PROPORZIONALE (saranno attribuiti 7 punti all'offerta con il maggiore numero di analiti. Il punteggio attribuito alle altre offerte sarà determinato proporzionalmente)	7	7

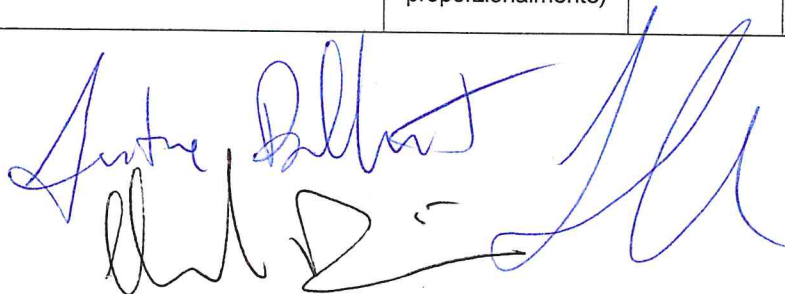

3

3	Ag e Ab dell'HIV determinazioni separate	Si: punti 5 No: punti 0	5	5
4	Espressione quantitativa dei dosaggi di IgG e IgM per i test Toxo, Rosolia, Citomegalovirus Assegnazione proporzionale al numero degli analiti espressi quantitativamente.	PROPORZIONALE (saranno attribuiti 6 punti all'offerta con il maggiore numero di analiti espressi quantitativamente. Il punteggio attribuito alle altre offerte sarà determinato proporzionalmente)	6	6
15	Servizio di assistenza tecnica: relazionare. Saranno valutate le caratteristiche migliorative del servizio di assistenza tecnica offerto, rispetto ai requisiti minimi indicati nel presente capitolato	discrezionale	3	3
16	Piano di formazione: relazionare. Saranno valutate le caratteristiche migliorative del servizio di formazione offerto, rispetto ai requisiti minimi indicati nel presente capitolato	discrezionale	3	3
TOTALE			80	80

Dott. Luigi Clerico Presidente di Commissione

Dott. Claudio Palmerini

Dott. Andrea Balbinot

Pescara 05/05/2023